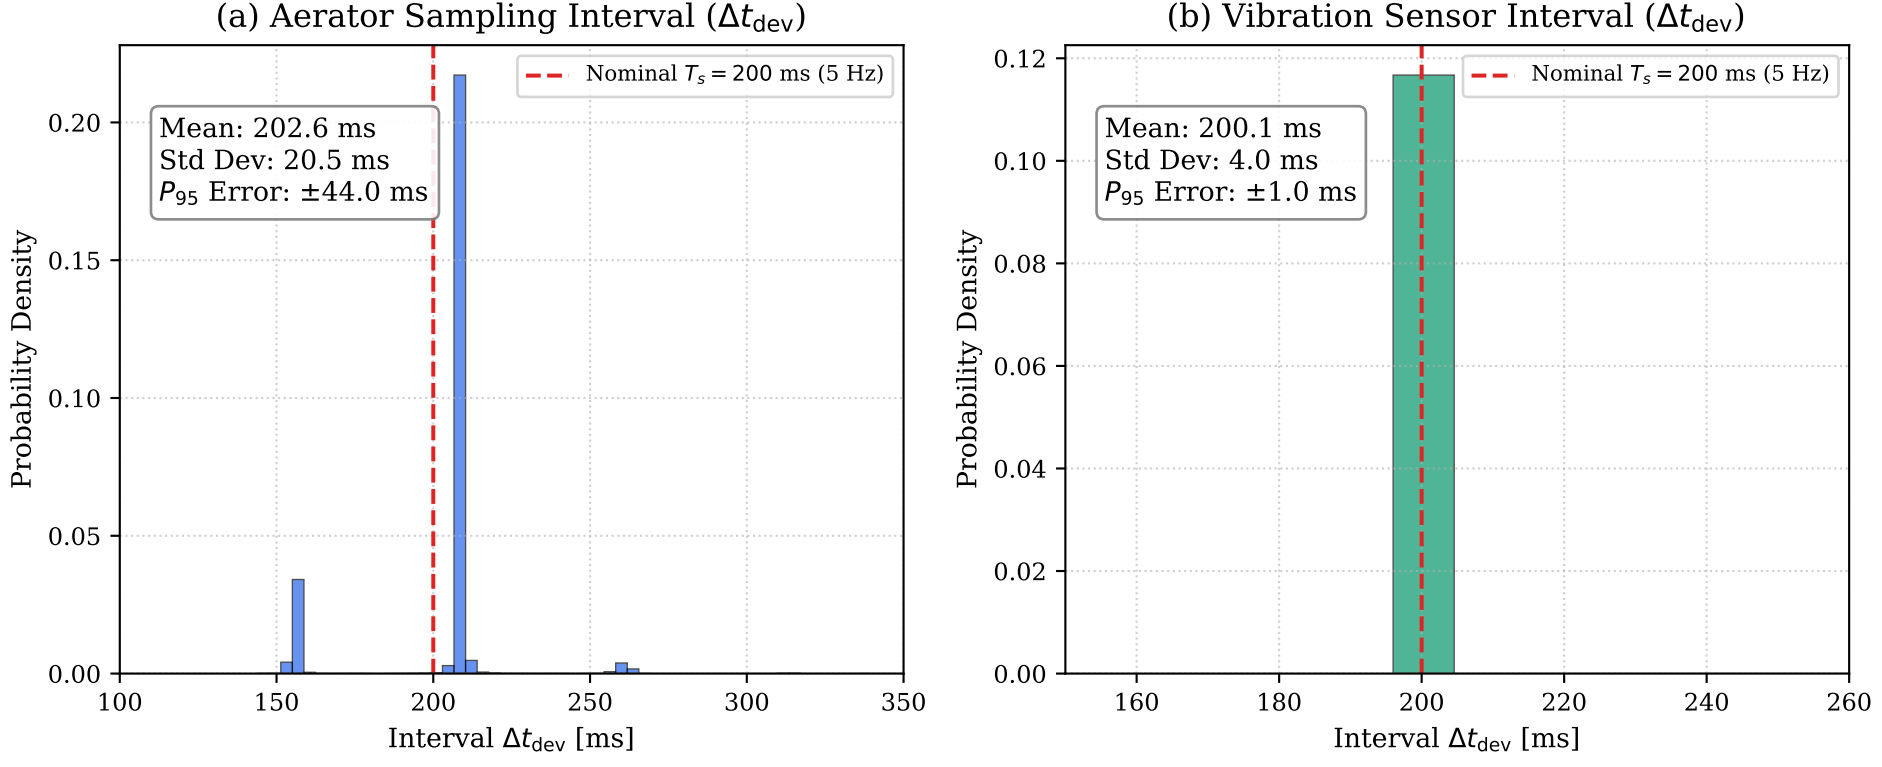
(a) Aerator Sampling Interval (Δt_{dev})
Nominal $T_s = 200$ ms (5 Hz)
Mean: 202.6 ms
Std Dev: 20.5 ms
P_{95} Error: ±44.0 ms
Probability Density
Interval Δt_{dev} [ms]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
100
150
200
250
300
350
(b) Vibration Sensor Interval (Δt_{dev})
Nominal $T_s = 200$ ms (5 Hz)
Mean: 200.1 ms
Std Dev: 4.0 ms
P_{95} Error: ±1.0 ms
Probability Density
Interval Δt_{dev} [ms]
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
160
180
200
220
240
260