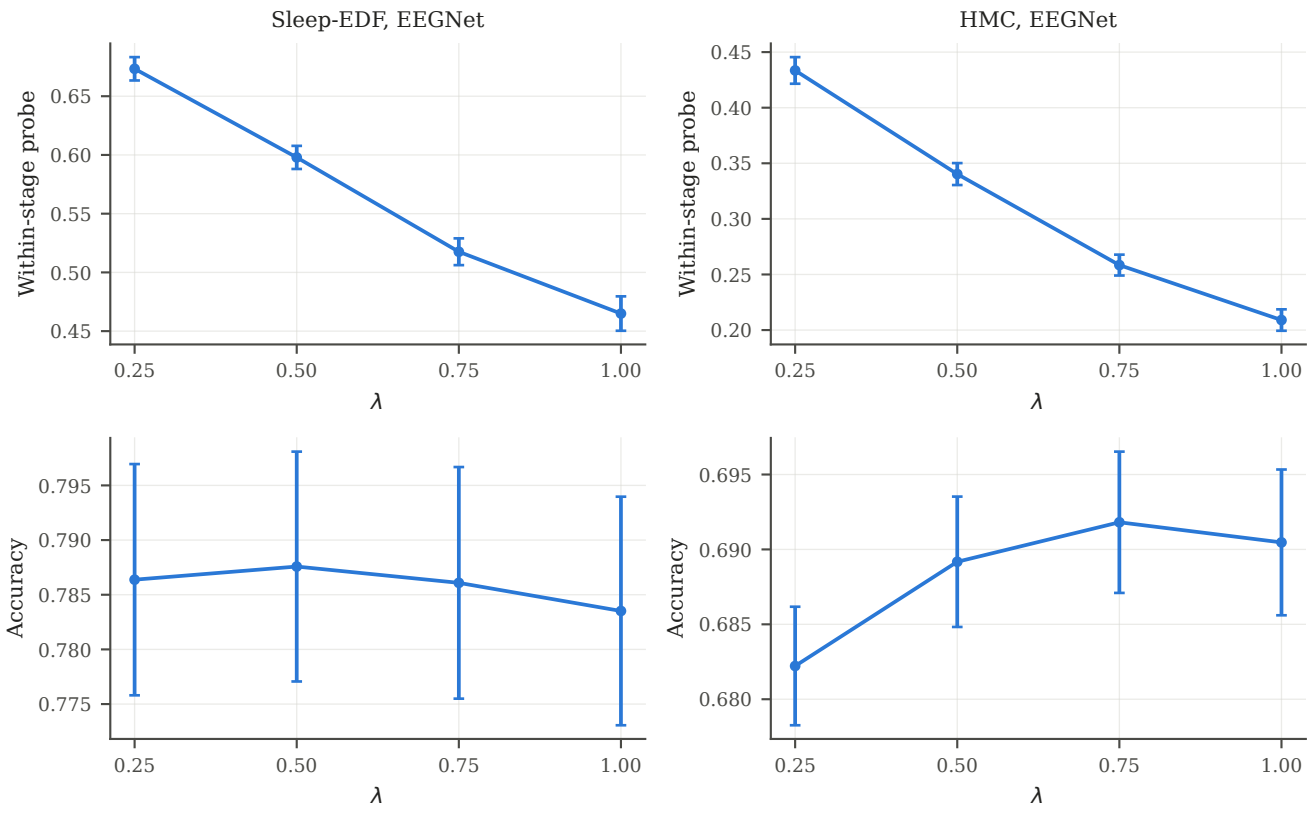
Sleep-EDF, EEGNet
HMC, EEGNet
Within-stage probe
Accuracy
λ
0.25
0.50
0.75
1.00
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.775
0.780
0.785
0.790
0.795
0.680
0.685
0.690
0.695