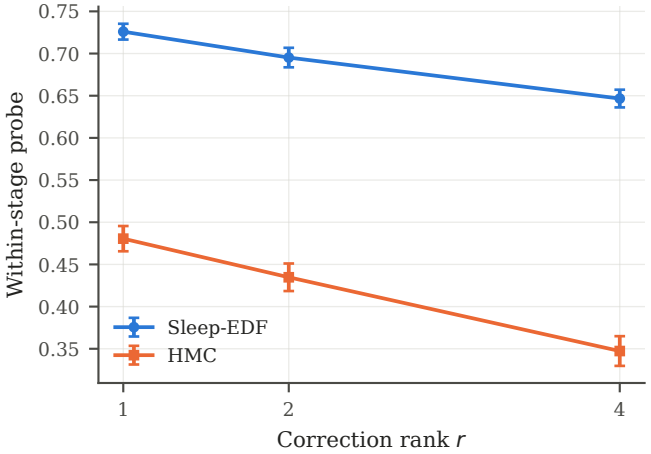
Within-stage probe
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
Sleep-EDF
HMC
1
2
4
Correction rank r

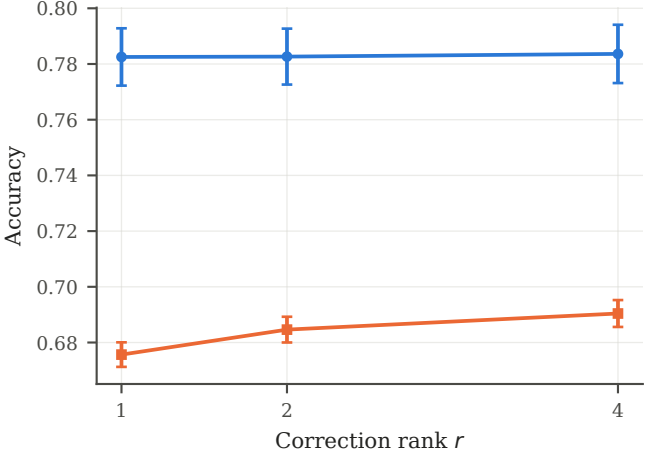
Accuracy
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
1
2
4
Correction rank r