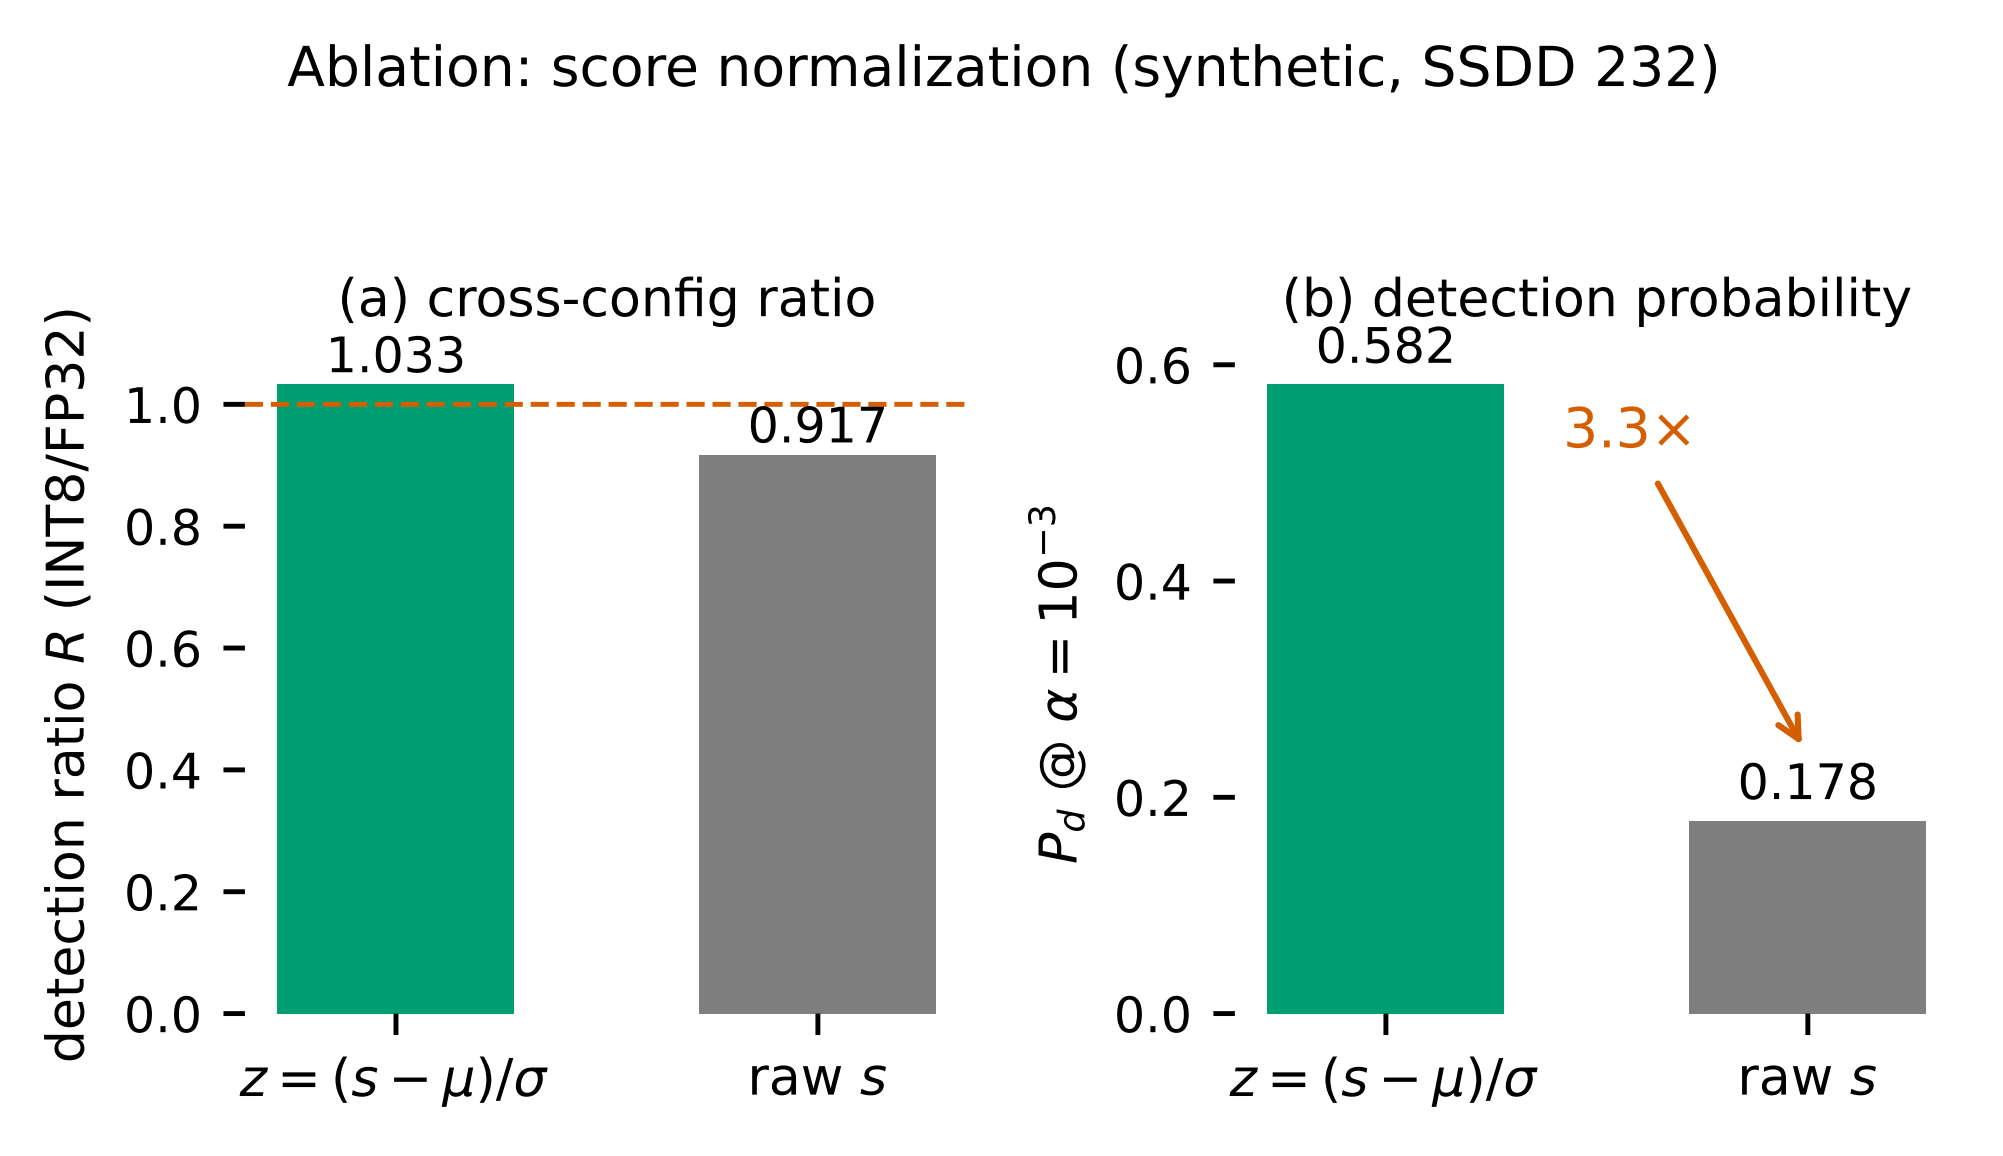
Ablation: score normalization (synthetic, SSDD 232)
(a) cross-config ratio
detection ratio R (INT8/FP32)
1.033
0.917
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$z = (s - \mu)/\sigma$
raw s
(b) detection probability
P_d @ $\alpha = 10^{-3}$
0.582
0.178
3.3×
0.6
0.4
0.2
0.0
$z = (s - \mu)/\sigma$
raw s