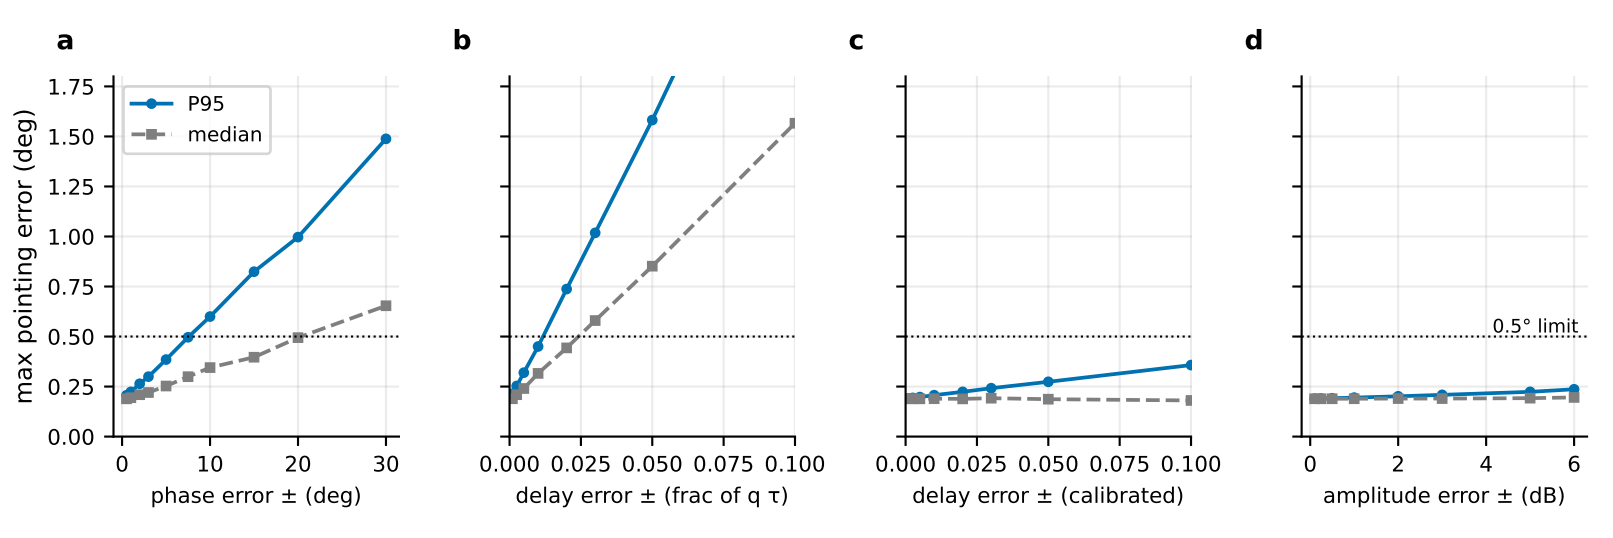
a
b
c
d
max pointing error (deg)
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
P95
median
0
10
20
30
phase error ± (deg)
0.000 0.025 0.050 0.075 0.100
delay error ± (frac of q τ)
0.000 0.025 0.050 0.075 0.100
delay error ± (calibrated)
0.5° limit
0
2
4
6
amplitude error ± (dB)