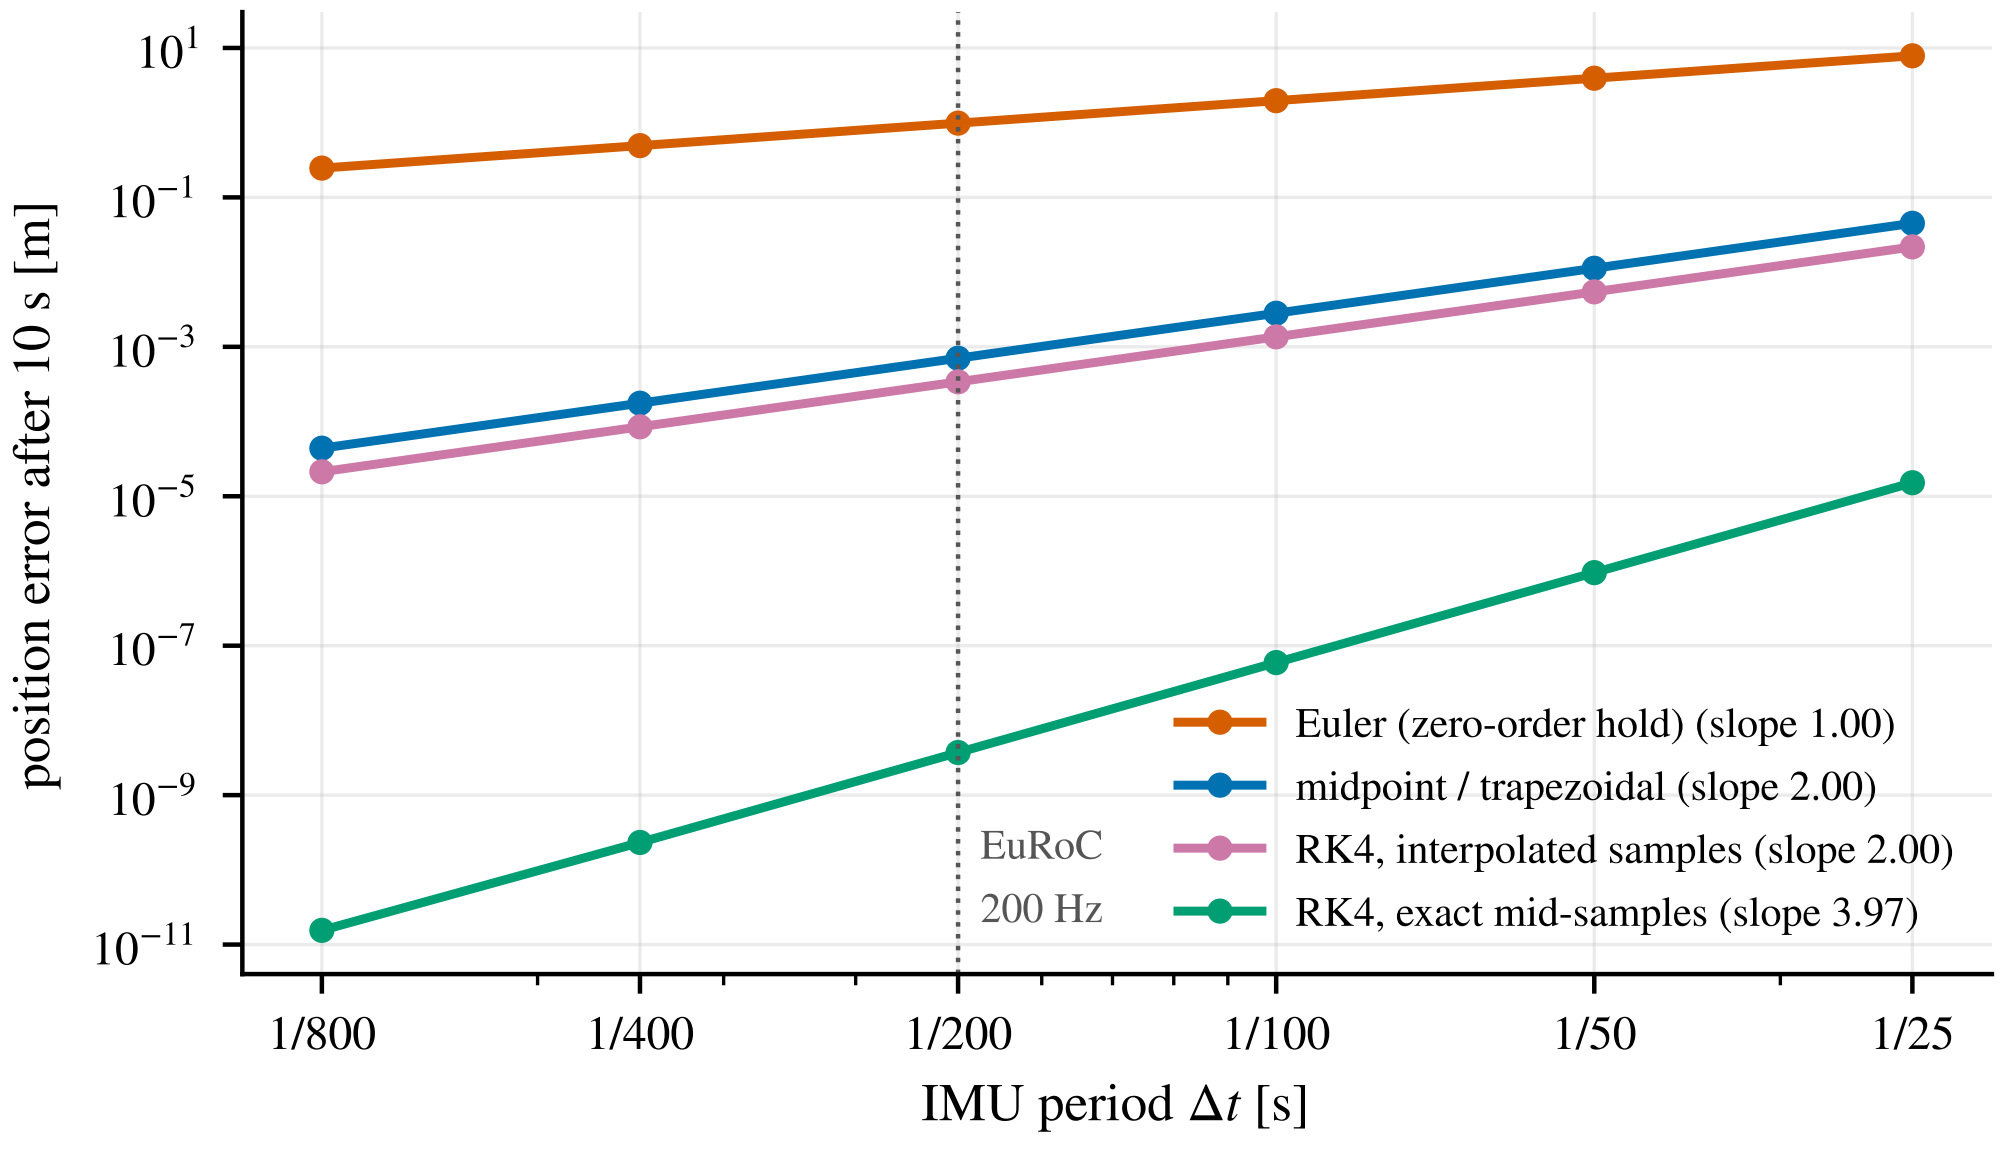
position error after 10 s [m]
10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
1/800
1/400
1/200
1/100
1/50
1/25
IMU period Δt [s]
EuRoC
200 Hz
Euler (zero-order hold) (slope 1.00)
midpoint / trapezoidal (slope 2.00)
RK4, interpolated samples (slope 2.00)
RK4, exact mid-samples (slope 3.97)