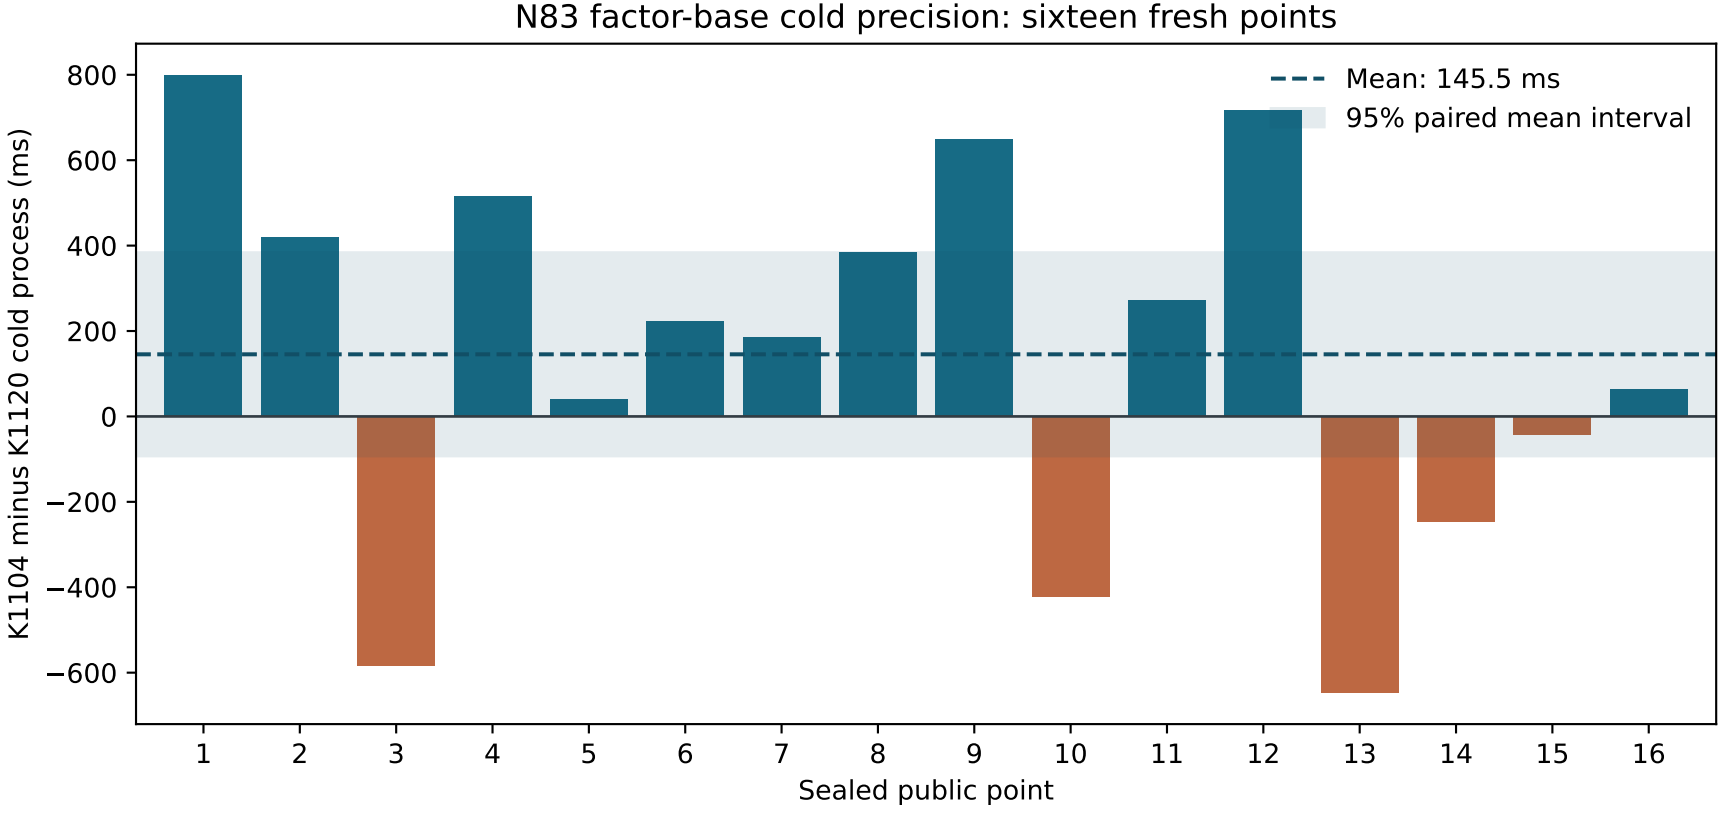
N83 factor-base cold precision: sixteen fresh points
K1104 minus K1120 cold process (ms)
800
600
400
200
0
−200
−400
−600
Mean: 145.5 ms
95% paired mean interval
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sealed public point