



Universidade de Brasília - UnB

Faculdade UnB Gama - FGA

Engenharia Eletrônica, Engenharia Automotiva, Engenharia de
Software, Engenharia de Energia, Engenharia Aeroespacial

Sistema automatizado de transporte de órgãos

Autor: Karla Ribeiro, Adrianny Viana, Igor Silva, Arilson
Junior, Daniel de Souza, Anne Caselato, Lucas Couto, Anna
Larissa, Cristiano Costa, Marcos Christian, Jarbas Costa, Paulo
Augusto, João Paulo

Brasília, DF

2017



Karla Ribeiro, Adrianny Viana, Igor Silva, Arilson Junior, Daniel de Souza,
Anne Caselato, Lucas Couto, Anna Larissa, Cristiano Costa, Marcos
Christian, Jarbas Costa, Paulo Augusto, João Paulo

Sistema automatizado de transporte de órgãos

Universidade de Brasília - UnB

Faculdade UnB Gama - FGA

Brasília, DF

2017

Lista de ilustrações

| | |
|--|----|
| Figura 1 – EAP - estrutura analítica do projeto | 18 |
| Figura 2 – Cronograma do projeto | 19 |
| Figura 3 – Cronograma do projeto | 20 |
| Figura 4 – Mecanismos de transferência de calor | 22 |
| Figura 5 – Modelo de um CMV | 24 |
| Figura 6 – Modelo de um compressor | 24 |
| Figura 7 – Modelo de um condensador | 25 |
| Figura 8 – Modelo de um filtro secador | 25 |
| Figura 9 – Modelo de um evaporador | 26 |
| Figura 10 – Modelo cliente-servidor. | 26 |
| Figura 11 – Mensagens trocadas entre um processo cliente e um processo servidor . | 27 |
| Figura 12 – TERMOVIDA - Caixa térmica para transporte de órgãos para trans- plantes | 28 |
| Figura 13 – Diagrama Elétrico Preliminar | 33 |
| Figura 14 – Diagrama Elétrico Preliminar | 35 |
| Figura 15 – Estrutura básica da transportadora de órgãos | 37 |
| Figura 16 – Dimensões da estrutura principal do carrinho | 37 |
| Figura 17 – Dimensões da base de apoio da estrutura | 38 |
| Figura 18 – Dimensões dos elementos estruturais internos | 38 |
| Figura 19 – Perfis de Metalon | 39 |
| Figura 20 – Chapa de Aço Inox 304 | 39 |
| Figura 21 – Chapas de Policloreto de Vinila | 40 |
| Figura 22 – Vista superior da Raspberry | 41 |
| Figura 23 – Circuito de proteção | 42 |
| Figura 24 – Circuito responsável pelo controle PWN | 43 |
| Figura 25 – Tabela de custos | 44 |

Lista de tabelas

| | |
|---|----|
| Tabela 1 – Tempo máximo de preservação extracorpórea (ABTO, 2011) | 8 |
| Tabela 2 – Tempo de isquemia por órgão(ABTO, 2009) | 9 |
| Tabela 3 – Plano de comunicações | 13 |
| Tabela 4 – Tecnologias de comunicação | 14 |
| Tabela 5 – Riscos para todos os subsistemas | 14 |
| Tabela 6 – Condutividade térmica dos materiais a 300K. Fonte: BENNETT, 2008 | 21 |
| Tabela 7 – Sistema interno - requisito funcional 001 | 29 |
| Tabela 8 – Sistema interno - requisito funcional 002 | 29 |
| Tabela 9 – Sistema interno - requisito funcional 003 | 29 |
| Tabela 10 – Sistema interno - requisito funcional 004 | 30 |
| Tabela 11 – Sistema interno - requisito funcional 005 | 30 |
| Tabela 12 – Sistema interno - requisito funcional 006 | 30 |
| Tabela 13 – Sistema interno - requisito funcional 007 | 30 |
| Tabela 14 – Sistema Web - requisito funcional 008 | 31 |
| Tabela 15 – Sistema Web - requisito funcional 009 | 31 |
| Tabela 16 – Sistema Web - requisito funcional 010 | 31 |
| Tabela 17 – Sistema Web - requisito funcional 011 | 31 |
| Tabela 18 – Sistema Web - requisito funcional 012 | 32 |
| Tabela 19 – Sistema Web - requisito funcional 013 | 32 |
| Tabela 20 – Sistema Web - requisito funcional 014 | 32 |
| Tabela 21 – Sistema Web - requisito funcional 015 | 32 |
| Tabela 22 – Consumo energético dos componentes | 34 |

Sumário

| | | |
|------------|---|-----------|
| 1 | INTRODUÇÃO | 7 |
| 1.1 | Contexto | 7 |
| 1.2 | Justificativa | 9 |
| 1.3 | Escopo do projeto | 10 |
| 1.3.1 | Premissas | 10 |
| 1.3.2 | Restrições | 10 |
| 1.4 | Detalhamento do escopo | 10 |
| 1.4.1 | Projeto | 10 |
| 1.4.2 | Produto | 11 |
| 1.5 | Objetivos | 11 |
| 1.5.1 | Objetivo Geral | 11 |
| 1.5.2 | Objetivos Específicos | 11 |
| 1.6 | Metodologia de gerenciamento | 12 |
| 1.6.1 | Plano de gerenciamento de comunicação | 13 |
| 1.6.1.1 | Agenda semanal/Reuniões | 13 |
| 1.6.1.2 | Tecnologia de comunicação | 14 |
| 1.6.1.3 | Monitoramento e Controle | 14 |
| 1.6.2 | Plano de gerenciamento de riscos | 14 |
| 1.6.3 | EAP | 18 |
| 1.6.4 | Cronograma | 18 |
| 2 | REFERENCIAL TEÓRICO | 21 |
| 2.1 | Fenômenos de Transporte de Calor | 21 |
| 2.1.1 | Condução | 21 |
| 2.1.2 | Convecção | 21 |
| 2.1.3 | Radiação | 22 |
| 2.2 | Calorimetria | 22 |
| 2.2.1 | Calor Sensível e Latente | 22 |
| 2.3 | Sistemas de Refrigeração | 23 |
| 2.3.1 | Sistema de Compressão Mecânica de Vapor (CMV) | 23 |
| 2.4 | Modelo cliente-servidor/sistema web | 26 |
| 2.5 | Framework Django | 27 |
| 2.6 | Sistema interno | 27 |
| 2.7 | Ergonomia de carregamento de peso | 27 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 2.8 | TERMOVIDA – Caixa térmica para transporte de órgãos para trans- | 28 |
| | plantes | |
| 3 | SOLUÇÃO PROPOSTA | 29 |
| 3.1 | Arquitetura de Software | 29 |
| 3.1.1 | Sistema Interno | 29 |
| 3.1.1.1 | Requisitos funcionais | 29 |
| 3.1.2 | Sistema Web | 30 |
| 3.1.2.1 | Requisitos funcionais | 31 |
| 3.2 | Sistema de Refrigeração | 32 |
| 3.3 | Sistema de Alimentação | 32 |
| 3.3.1 | Diagrama do Sistema | 33 |
| 3.3.2 | Dimensionamento das Baterias | 34 |
| 3.3.3 | Dimensionamento do Inversor | 35 |
| 3.3.4 | Requisitos | 36 |
| 3.3.4.1 | Requisitos Funcionais | 36 |
| 3.3.4.2 | Requisitos Não Funcionais | 36 |
| 3.4 | Estrutura | 36 |
| 3.4.1 | Arquitetura da estrutura | 36 |
| 3.4.2 | Materiais principais | 38 |
| 3.4.3 | Requisitos | 40 |
| 3.4.3.1 | Requisitos Funcionais | 40 |
| 3.4.3.2 | Requisitos não-funcionais | 40 |
| 3.4.4 | Desafios Técnicos | 40 |
| 3.4.4.1 | Isolamento térmico da câmara | 40 |
| 3.4.4.2 | Esterilização do sistema | 41 |
| 3.4.4.3 | Mobilidade do sistema | 41 |
| 3.5 | Sistemas Eletrônicos | 41 |
| 3.5.1 | Servidor | 41 |
| 3.5.2 | Circuito Preventivo | 42 |
| 3.5.3 | Controle PWM | 42 |
| 3.5.3.1 | Subsistema de Controle | 43 |
| 3.5.3.2 | Subsistema de Proteção | 43 |
| 3.5.3.3 | Subsistema de Comunicação e Análise | 43 |
| 3.6 | Tabela de custos | 44 |
| | REFERÊNCIAS | 45 |

1 Introdução

De acordo com o SNT (Sistema Nacional de Transplante), o Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplante de órgãos e tecidos do mundo. Apesar deste importante avanço, a estrutura de processos administrativos e operacionais ainda é deficiente e causa grande impacto na viabilidade e ocorrência do transplante. Em 2005 existiam cerca de 60 mil brasileiros na fila de espera por um transplante de órgãos, sendo que destes apenas 20% seriam atendidos, sendo o maior fator contribuinte para a não realização do procedimento, a estrutura deficiente de captação e distribuição de órgãos (Bergamo, 2005), e não a falta de doadores. Desta forma, sabe-se que a melhoria no processo logístico causará impactos positivos no cenário brasileiro de transplante de órgãos, beneficiando os milhares de brasileiros que se encontram na fila de espera por um órgão.

1.1 Contexto

A história da transplantação de órgãos é recente, iniciada na década de 1960 no Brasil e marcada por grandes avanços no enfoque da medicina e da tecnologia desde então, o que atualmente permite melhores perspectivas sobre saúde e longevidade. A regulamentação dos transplantes de órgãos aconteceu no Brasil no ano de 1997 pela Lei nº 9.434, e adicionalmente a ela o Decreto nº 2.268/1997 criou o Sistema Nacional de Transplantes responsável pela captação e distribuição de órgãos e tecidos. O Registro Brasileiro de Transplantes (RBT) mostra o crescimento dos casos de transplantação no ano de 2016, com destaque para o transplante hepático, com aumento nacional de 3,9%, e para o transplante de pâncreas, com aumento nacional de 11,7%, se comparados ao ano de 2015.

Para melhor compreensão deste estudo, define-se transplante como uma substituição cirúrgica de um órgão ou tecido afetado por lesão progressiva e irreversível por um outro sadio, de doador falecido ou vivo (NETO; AFONSO; THOMÉ, 2017). O êxito nas atividades de transplantação está atrelado não só ao procedimento cirúrgico, mas anteriormente, e também, ao bom manejo do órgão que envolve a excelência no procedimento de acondicionamento para transporte. Uma falha na logística de transporte e/ou em seu armazenamento podem apresentar riscos ao futuro transplantado, além da falência do órgão.

Neste contexto, aprimorar os recursos tecnológicos, a fim de tornar as condições de armazenamento tão excelentes quanto o necessário para garantir o funcionamento e integridade ao recurso vindo de um doador é fundamental. Os riscos que podem vir a tornar inviável a transplantação devem ser drasticamente minimizados, pois os dados

mostram que a proporção é de um doador para cada 8 potenciais doadores de órgão (ABTO, 2009), ou seja, os recursos têm de ser manejados da melhor forma possível para eliminar as possibilidades de inutilização do órgão.

Para o desenvolvimento de um equipamento de acondicionamento de órgãos adequado, torna-se imprescindível o conhecimento de todas as normas e requisitos que garantem as melhores condições de armazenamento durante o transporte. A Associação Brasileira de Transporte de Órgãos traz informações sobre os máximos tempos de permanência extracorpórea dos recursos, como mostra a tab. 1:

| Órgão/Tecido | Tempo máximo para retirada | Tempo máximo de preservação extracorpórea |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| Córneas | 6 horas após PC* | 7 dias |
| Coração | Antes da PC* | 4 a 6 horas |
| Pulmão | Antes da PC* | 4 a 6 horas |
| Rins | Até 30 min. pós PC* | Até 48 horas |
| Fígado | Antes da PC* | 12 a 24 horas |
| Pâncreas | Antes da PC* | 12 a 24 horas |
| Ossos | 6 horas pós PC* | Até 5 anos |

Tabela 1 – Tempo máximo de preservação extracorpórea (ABTO, 2011)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu, pela Resolução RDC nº 66/2009, as condições sanitárias de transporte de órgãos humanos, e regulamenta o funcionamento da acomodação e transporte destes recursos. Os principais requisitos desta norma quanto ao sistema de armazenagem são:

Art. 31. A embalagem primária deve conter o órgão e a solução de preservação, e ter capacidade proporcional ao volume do órgão a ser embalado.

Art. 32. A embalagem primária deve ser acondicionada em duas embalagens secundárias.

Art. 36. As embalagens secundárias devem ser acondicionadas na embalagem terciária.

Art. 37. A embalagem terciária será constituída de caixa isotérmica confeccionada de material rígido, resistente e impermeável, deverá promover isolamento térmico, ser revestida internamente com material liso, durável, impermeável, lavável e resistente a soluções desinfetantes e conter um dispositivo de segurança que impeça sua abertura acidental.

Art. 38. A embalagem terciária deve ser preenchida com gelo (ponto de fusão a 0°C) em quantidade suficiente para envolver a embalagem secundária e garantir a manutenção da temperatura pelo tempo necessário do processo de transporte.

Art. 39. O gelo com ponto de fusão a 0°C utilizado não deve entrar em contato direto com os órgãos.

Art. 40. É vedado o emprego de solução salina congelada como material refrigerante no acondicionamento, para prevenir congelamento do órgão.

Ademais, cada órgão possui suas próprias especificações que devem ser respeitadas. O armazenamento do fígado e pâncreas, por exemplo, são realizados sob as mesmas condições, entretanto, separadamente. O órgão é colocado separadamente no interior de um saco plástico estéril contendo 1 litro de solução Viaspan (solução para conservação de órgãos) a 4°C e lacrado com fita cardíaca. Após, o saco é posto no interior de outro saco plástico estéril com gelo moído e novamente lacrado com fita cardíaca. Identifica-se com um cartão que contém o horário de clampeamento, e este conjunto deve permanecer em geladeira térmica, coberto com gelo não estéril até a utilização dos enxertos (NETO; AFONSO; THOMÉ, 2010).

Alternativamente ao emprego de um sistema de refrigeração manual, este projeto visa a concretização de uma caixa, em concordância com a embalagem terciária do artigo 37 da Resolução RDC nº 66/2009, com um sistema de resfriamento que não se utiliza de gelo não estéril e com a possibilidade de controle e verificações de suas condições de atuação, visando propiciar melhores condições de armazenamento e transporte de órgãos.

1.2 Justificativa

Atualmente no transporte de órgãos, utilizam-se caixas térmicas, onde o órgão é depositado em soro e coberto por embalagens com gelo. Observaram-se casos de perda e deterioração prematura do órgão, devido à queima do tecido pelo contato não homogêneo com as embalagens de gelo. De acordo com o Dr. Fernando A. G. Guimarães, em sua tese de mestrado “Câmara Hiperbárica refrigerada para a preservação de órgãos e tecidos”, é notável uma melhor preservação do órgão em sistemas pressurizados com oxigênio puro e temperatura controlada.

Além dos processos de acondicionamento, armazenagem e transporte, é necessário levar em consideração o tempo de isquemia de cada órgão, que consiste no intervalo entre a retirada e acondicionamento em solução própria e a inserção do órgão no corpo do receptor, e as distâncias entre os doadores e os receptores. Este tempo será monitorado pelo sistema de acompanhamento de órgão, para que não haja atraso e a consequente deterioração do tecido antes da chegada ao destino.

| Órgão | Tempo de Isquemia Fria |
|----------|------------------------|
| Coração | 4 horas |
| Pulmão | 4-6 horas |
| Fígado | 12 horas |
| Rim | Até 24 horas |
| Pâncreas | Até 20 horas |

Tabela 2 – Tempo de isquemia por órgão (ABTO, 2009)

1.3 Escopo do projeto

1.3.1 Premissas

- Os órgão devem ser condicionados em uma câmara selada hermeticamente.
- A câmara deverá ser resfriada e manter-se entre 2 e 4 graus Celsius.
- O transportador só poderá ser aberto no seu destino.
- Haverá comunicação com a internet para que o hospital que receberá o órgão possa acompanhar o andamento da entrega.

1.3.2 Restrições

- O órgão não poderá ser necrosado por falta de refrigeração nem queimado por excesso dela.
- A caixa transportadora deverá ser dimensionada de forma que duas pessoas adultas possam carregá-la.
- O sistema de fechamento não será aberto até a chegada no destino do órgão.
- O sistema de transporte deverá estar de acordo com a legislação vigente, se for aplicável.

1.4 Detalhamento do escopo

1.4.1 Projeto

O grupo do Transportador de Órgãos da disciplina de Projeto Integrador 2, visa suprir a necessidade de um controle maior na importantíssima atividade de transportar órgãos humanos para transplante, buscando o maior controle das características do transporte para que a chance real do órgão chegar a tempo e de forma útil para quem irá recebê-lo. O órgão será acondicionado dentro de três camadas de materiais que tratarão de isolar termicamente e hermeticamente de forma que o órgão chegue saudável a seu destino.

O público alvo do projeto são as equipes de transplante que agem para salvar vidas levando essa importante carga por todo o país, seja de avião, helicóptero, ambulância ou qualquer outro meio de locomoção. O objetivo é facilitar o controle e a entrega dos órgãos para seus recebedores.

1.4.2 Produto

O sistema de automatização do recipiente do transporte facilitará o controle de temperatura, que ocorrerá automaticamente, terá sistema energético próprio aumentando sua autonomia e se conectará com a internet para que o seu destino saiba onde o órgão está e quais suas características em tempo real. Se o lugar for remoto e não houver conexão, assim que a conexão for estabelecida os dados serão atualizados.

O sistema funcionará da seguinte forma: O órgão será introduzido dentro da câmara de resfriamento que por sua vez será selada hermeticamente. O resfriamento da câmara já deve ter ocorrido para que o órgão seja resfriado o mais rápido possível. O segundo invólucro que terá o isolamento térmico será fechado e trancado para que só possa ser aberto em seu destino. No trajeto o órgão será observado por sensores de temperatura e pressão enquanto a localização do sistema e esses dados são transmitidos pela internet para um servidor que pode ser acessado via um aplicativo na internet. Chegado em seu destino o órgão poderá ser retirado para o transplante.

O sistema completo poderá ficar pesado para uma pessoa levar, por isso a estrutura poderá ter rodas que facilitam sua locomoção, mas será dimensionado, o projeto, de forma que duas pessoas possam levá-lo sem problemas para colocá-lo em qualquer veículo.

Para que o projeto seja considerado um sucesso este deverá atender aos seguintes quesitos: manter a temperatura o isolamento e a pressão do órgão até sua chegada no destino, não podendo ser aberto até então e que passe todas essas informações para que os interessados saibam as características do órgão e onde está o transporte.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo Geral

Tendo em vista os obstáculos e desafios enfrentados no transporte de órgãos hodiernamente, sem deixar de levar em consideração a sua relevância social, o presente trabalho propõe a concepção de um sistema automatizado de transporte de órgãos, levando em conta as condições específicas de contorno necessárias para a preservação de cada órgão durante o tempo de traslado. O grupo, então, orientará seus esforços no sentido de conceber um sistema que preserva órgãos específicos, contando com o trabalho harmônico e sinérgico de cada uma das áreas do conhecimento de seus membros.

1.5.2 Objetivos Específicos

Levando em consideração os objetivos gerais acima propostos, e utilizando-os como diretriz, citam-se os objetivos específicos logo abaixo:

- Projetar e construir a estrutura da câmara onde o órgão será acondicionado, seguindo todas as normas de assepsia e acondicionamento propostas pela ANVISA;
- Projetar e implementar o sistema de controle e coleta de dados em tempo real, utilizando o microcontrolador MSP430g2553;
- Projetar e implementar o sistema que analisará, processará e enviará os dados coletados para uma plataforma WEB através de uma plataforma GPRS, com auxílio da RaspBerry PI;
- Projetar o sistema que fará a tomada de decisões, que se dará através da comunicação entre o RaspBerry PI e MSP430g2553;
- Projeto e implementação da plataforma WEB;
- Análise de transferência de calor da câmara, de forma que tal transferência ocorra da forma correta, sem danificar o tecido do órgão.

1.6 Metodologia de gerenciamento

A metodologia ágil, mais especificamente o SCRUM, tem como princípio agregar valor ao cliente de maneira mais rápida possível a partir de uma gerência eficiente das pessoas envolvidas e suas respectivas funções. O PMBOK é referência em gerenciamento de projetos por conter artefatos e boas práticas que ajudam a desenvolver um projeto de maneira eficaz. Na realização do projeto do transporte de órgãos será utilizada uma combinação do SCRUM e do PMBOK.

O SCRUM será utilizado para organizar o esforço de trabalho dos participantes em sprints semanais, que terão planejamento e retrospectiva, além disso teremos reuniões diárias através da plataforma online SLACK tendo visibilidade do trabalho executado por cada membro e frente de trabalho.

Do PMBOK utilizaremos alguns artefatos para documentação do projeto como:

- Plano de gerenciamento de comunicação
- Plano de gerenciamento de requisitos
- Plano de gerenciamento de riscos
- Plano de gerenciamento de custos

1.6.1 Plano de gerenciamento de comunicação

O plano de gerenciamento das comunicações tem a finalidade de abordar os meios de comunicação utilizados no desenvolvimento do transportador de órgãos desenvolvido como projeto da disciplina de Projeto Integrador de Engenharia 2. A comunicação se faz importante para o sucesso ou falha de projeto e interfere diretamente no conhecimento compartilhado entre a equipe.

Nesta subseção será descrito aspectos relevantes para o gerenciamento de comunicação como a frequência de encontros e as ferramentas utilizadas para obter uma forte integração entre a equipe.

1.6.1.1 Agenda semanal/Reuniões

A equipe trabalha no contexto de reunião física durante as aulas e no contexto de comunicação externa fora das aulas, portanto as reuniões são estruturadas de forma a extrair a maior produtividade dos integrantes durante as aulas. As reuniões permitem trocas de informações entre a equipe, proporcionando melhorias no desenvolvimento geral do time.

| Motivo | Participantes | Método | Frequência | Dia |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Reunião fixa | Todos os membros | Presencial | Uma vez por semana. 16:00 às 18:00 | Quarta-feira |
| Reunião fixa | Todos os membros | Presencial | Uma vez por semana. 14:00 às 18:00 | Sexta-feira |
| Reuniões de frentes de trabalho | Frentes de trabalho | Reunião digital (hangout) | Quando forem necessárias | - |
| Reunião de gerência | Equipes de gerência | Reunião digital (hangout) | 2 vezes por semana | - |

Tabela 3 – Plano de comunicações

1.6.1.2 Tecnologia de comunicação

| Tecnologia | Urgência das informações | Objetivo | Métodos de comunicação |
|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Whatsapp | Alta | Comunicação rápida e informal | Comunicação interativa |
| Slack | Alta | Acompanhamento de desenvolvimento | Comunicação interativa |
| Google Drive | Baixa | Armazenamento, compartilhamento e produção de documentos | Comunicação passiva |
| Hangouts | Média | Reuniões online | Comunicação interativa |
| Git | Baixa | Versionar as informações dos relatórios do grupo | Comunicação passiva |
| Trello | Alta | Acompanhamento do processo de desenvolvimento e atividades | Comunicação passiva |

Tabela 4 – Tecnologias de comunicação

1.6.1.3 Monitoramento e Controle

Os integrantes devem ser pontuais e comunicativos nas reuniões, fazendo o uso das ferramentas e meios de comunicação definidos a priori. Será feito um Registro de Presença para monitorar a presença dos integrantes e está diretamente relacionada à participação dos membros no projeto. Para controle de trabalho e comunicação será utilizada como ferramenta principal o Trello, onde todo o trabalho terá responsável e tempo para ser terminado.

1.6.2 Plano de gerenciamento de riscos

Os riscos do projeto foram avaliados e estão descritos na Tabela 5. Foram analisados a probabilidade de acontecerem os eventos e quão impactante eles serão, caso ocorram.

Tabela 5 – Riscos para todos os subsistemas

| Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Ação/estratégia |
|----------------------|--|----------------------|---------------------------|--|
| Geral | | | | |
| Atraso no cronograma | Sobrecarregamento em certos períodos do projeto e/ou atraso na entrega do produto final. | Provável. | Razoavelmente impactante. | Ajuste ou remodelamento de atividades a serem desenvolvidas. |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---|
| Erro de planejamento | Replanejamento do projeto e/ou atraso na entrega do produto final. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Replanejar o subsistema e/ou o sistema inteiro. |
| Necessidade de uma carga de trabalho pesada | Sobrecarregamento de integrantes e/ou desistência de integrantes. | Pouco provável. | Razoavelmente impactante. | Rever a forma de gerenciamento e a possível necessidade de mais reuniões para redistribuir atividades. |
| Falta de experiência necessária | Sobrecarregamento de integrantes e/ou erro de planejamento e/ou desistência. | Pouco provável. | Pouco impactante. | Busca de pessoal capacitado a ajudar e ensinar. |
| Mudança no projeto | Atraso na entrega do produto final. | Provável. | Muito impactante. | Replanejamento de escopo. |
| Desistência de integrantes | Sobrecarregamento de integrantes e/ou atraso no cronograma. | Pouco provável. | Muito impactante. | Fazer nova distribuição de tarefas de acordo com a necessidade de trabalho. |
| Descumprimento de integrantes. | Sobrecarregamento de integrantes e/ou atraso no cronograma. | Pouco provável. | Razoavelmente impactante. | Verificar o problema com o integrante e oferecer a ajuda necessária. |
| Atraso na entrega de materiais (compra). | Atraso no cronograma do projeto e/ou atraso na entrega do produto final. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Tornar compra prioridade e pesquisar mais fornecedores que entregam de forma mais eficiente. |
| Danificação de componentes ou subsistemas do protótipo. | Atraso no cronograma do projeto e/ou mudança no projeto. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Rever o motivo da danificação e realizar uma nova compra, ou novo planejamento de projeto, caso necessário. |
| Falta de recursos para compra de materiais | Atraso no cronograma e/ou mudança no projeto. | Pouco provável. | Razoavelmente impactante. | Métodos alternativos de obtenção de recursos. |
| Dificuldade de integração eletrônica/energia. | Diferença da potência fornecida pra potência consumida. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Replanejamento de fontes de energia ou do sistema eletrônico. |
| Dificuldade de integração eletrônica/software. | Dificuldade de integração do software com microcontrolador. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Revisão do sistema e/ou substituição dos mesmos. |
| Dificuldade de integração estrutura/eletrônica ou energia. | Falta do espaço necessário. | Pouco provável. | Muito impactante. | Redimensionamento da estrutura ou alteração dos sistemas eletrônicos/energéticos. |
| Eletrônica | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|--|
| Queima de componente. | Perda de tempo e de dinheiro. | Provável. | Muito impactante. | Fazer medições de corrente e voltagem precisamente e verificar datasheet com valores nominais dos componentes. |
| Erro de layout da pci | Perda tempo com reprogramação | Provável. | Pouco impactante. | Necessidade de refazer layout e esquemático da placa pci e Verificação e validação anterior montagem do circuito. |
| Falha na comunicação GPRS/GSM ou WIFI(se for o caso) | Perda de tempo e comunicação. | Provável. | Pouco impactante. | Fazer conexão com internet móvel ou wifi local com redundância entre os métodos e sincronia quando for conectado, além dos testes anteriores ao uso. |
| Energia | | | | |
| Atrasos no cronograma da equipe. | Não cumprimento do projeto no tempo esperado. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Ter um gerenciamento de projeto eficiente e planejar um cronograma facilmente executável. |
| Risco de curtos no sistema elétrico/eletrônico. | Queima de equipamentos. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Dimensionar um sistema de proteção com fusíveis. |
| Falta de recursos para compra de materiais. | Atrasos no projeto. | Pouco provável. | Razoavelmente impactante. | Realizar gerenciamento de arrecadação dos membros do grupo para custear o projeto. |
| Falta de experiência necessária. | Erro de planejamento ou desistência integrantes. | Pouco provável. | Pouco impactante. | Busca de pessoal capacitado e disposto a ajudar o grupo. |
| Baixa eficiência de refrigeração da câmara. | O sistema não ser capaz de alimentar a refrigeração ocasionando perda do órgão. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Procurar não adquirir equipamentos usados ou com origem duvidosa. |
| Estrutura | | | | |
| Design preliminar não atende aos requisitos do projeto. | Não aceitação do design preliminar pelos clientes. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Elaboração de um design que atenda que atenda à todos os requisitos do projeto. |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------|---|
| Mecanismo de transporte não aguenta os esforços aplicados. | Deformação plástica do mecanismo, perda de recursos. | Pouco provável. | Razoavelmente impactante. | Calcular esforços gerados na estrutura de transporte;simular numericamente as deformações na estrutura;considerar um coeficiente de segurança de, no mínimo 2,5 na construção do mecanismo de transporte. |
| Atrasos no cronograma. | Não cumprimento do projeto no tempo esperado. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Ter um gerenciamento de projeto eficiente e planejar um cronograma facilmente executável. |
| Falha no mecanismo de selamento da câmara de transporte de órgãos. | Possibilita a perda do órgão transportado | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Planejar um mecanismo de fácil construção e grande eficiência, além de realizar testes com antecedência. |
| Material de isolamento não apropriado para o intervalo de temperaturas recomendado. | Impossibilita a refrigeração adequado da câmara de resfriamento. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Fazer uma pesquisa acurada por possíveis materiais a serem utilizados no sistema de refrigeração, além de testar o sistema com antecedência para ser possível a mudança do material à tempo. |
| Abertura da câmara de transporte antes da hora. | Perdas em energia para refrigeração adequada. | Muito provável. | Pouco impactante. | Alertar o transportador caso haja falha no sistema de selamento. |
| Órgãos não permanecerem em suas posições durante o transporte ou devido às vibrações. | Órgãos são danificados e podem prejudicar funcionamento da máquina. | Razoavelmente provável. | Muito impactante. | Planejar disposição dos órgãos de forma a prevenir graus de liberdade que possam vir a causar o deslocamento deles durante o transporte ou vibrações da máquina. |
| Software | | | | |
| Não terminar o software de controle dos sensores | Não conseguir entregar o produto | Pouquíssimo provável | Muitíssimo impactante | Rever o escopo do projeto |
| Não terminar o <i>webapp</i> | Não conseguir entregar o produto | Pouquíssimo provável | Muitíssimo impactante | Rever o escopo do projeto |
| Perder um integrante do grupo | Sobrecarregar o resto do grupo | Pouco provável | Muito impactante | Rever o escopo e redistribuir as responsabilidades |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Perder uma máquina | Impossibilidade de trabalhar sozinho | Razoavelmente provável | Razoavelmente impactante | Pareamento |
| Não conseguir integração com os sensores do transportador de órgãos | O webapp não mostrará as informações | Pouco provável | Muitíssimo impactante | Ter uma opções de conexão e revisar a solução |

1.6.3 EAP

A estrutura analítica do projeto foi definida baseada nos marcos principais e quais atividades deverão ser entregues. Conforme citado na metodologia Top/Down, as atividades foram divididas em módulos de entrega conforme a fig. 1.

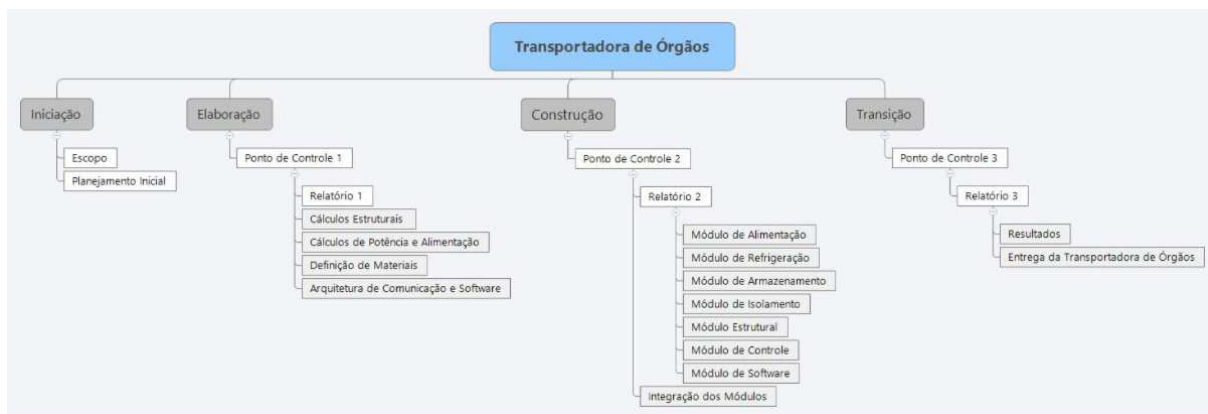


Figura 1 – EAP - estrutura analítica do projeto

1.6.4 Cronograma

Abaixo segue o cronograma proposto para elaboração do projeto, dividido pelas fases de iniciação, elaboração, construção e transição, seus respectivos marcos e datas limites.















| |  | Nome | Duração | Início | Fim |
|----|---|---|---------|------------|------------|
| 1 | | ☐ Iniciação | 5d? | 18/08/2017 | 24/08/2017 |
| 2 |  | Definição Tema e Grupo | 5d | 18/08/2017 | 24/08/2017 |
| 3 |  | Definição do Escopo do Sistema | 4d | 21/08/2017 | 24/08/2017 |
| 4 |  | Levantamento de Requisitos | 4d | 21/08/2017 | 24/08/2017 |
| 5 |  | Planejamento de Custos | 1d? | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 6 |  | Cronograma | 1d? | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
| 7 |  | Relação de Subsistemas | 2d | 23/08/2017 | 24/08/2017 |
| 8 | | ☐ Elaboração | 17d? | 25/08/2017 | 18/09/2017 |
| 9 |  | Elaboração do Relatório PC1 | 2d | 25/08/2017 | 28/08/2017 |
| 10 |  | Apresentação PC1 | 3d? | 30/08/2017 | 01/09/2017 |
| 11 | | ☐ Estrutura | 17d | 25/08/2017 | 18/09/2017 |
| 12 |  | Definição de Material | 11d | 04/09/2017 | 18/09/2017 |
| 13 |  | Cálculo de Volume Interno | 5d | 06/09/2017 | 12/09/2017 |
| 14 |  | Prototipação | 10d | 04/09/2017 | 15/09/2017 |
| 15 | | Definição de Layout | 6.88d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 16 |  | Simulação | 4d | 12/09/2017 | 15/09/2017 |
| 17 | | ☐ Resfriamento | 16d | 25/08/2017 | 15/09/2017 |
| 18 | | Definição dos componentes para resfriamento | 7d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 19 |  | Cálculo numérico de potência | 10d | 04/09/2017 | 15/09/2017 |
| 20 | | Simulação computacional | 5d | 25/08/2017 | 31/08/2017 |
| 21 | | ☐ Isolamento | 10d | 25/08/2017 | 07/09/2017 |
| 22 | | Definição de tipo de material de isolamento | 10d | 25/08/2017 | 07/09/2017 |
| 23 | | Orçar Custos | 7d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 24 | | Simulação computacional | 10d | 25/08/2017 | 07/09/2017 |

Figura 2 – Cronograma do projeto

| | | | | | |
|----|---|--|------|------------|------------|
| 25 | | ☐ Alimentação e Armazenamento Energético | 14d | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 26 | | Definir fonte de alimentação | 5d | 25/08/2017 | 31/08/2017 |
| 27 | | Especificação dos componentes | 14d | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 28 | | Projeto do sistema de alimentação | 14d | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 29 | | Definição do sistema de armazenamento | 7d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 30 | | Definição das baterias | 14d | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 31 | | ☐ Sistema Eletrônico | 14d? | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 32 | | Definição do módulo de controle | 7d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 33 | | Definição do módulo de comunicação | 7d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 34 | | Definição dos componentes eletrônicos | 11d? | 25/08/2017 | 08/09/2017 |
| 35 | | Layout | 14d | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 36 | | Simulação | 14d | 25/08/2017 | 13/09/2017 |
| 37 | | ☐ Software | 10d | 25/08/2017 | 07/09/2017 |
| 38 | | Definição da arquitetura de software | 7d | 25/08/2017 | 04/09/2017 |
| 39 | | Levantamento de requisitos | 10d | 25/08/2017 | 07/09/2017 |
| 40 | | Definição de tecnologia | 1d | 25/08/2017 | 25/08/2017 |
| 41 | | ☐ Construção | 40d? | 19/09/2017 | 13/11/2017 |
| 42 |  | Estrutura | 39d? | 20/09/2017 | 13/11/2017 |
| 43 |  | Resfriamento | 39d? | 20/09/2017 | 13/11/2017 |
| 44 | | Isolamento | 39d | 19/09/2017 | 10/11/2017 |
| 45 | | Alimentação e Armazenamento Energético | 39d | 19/09/2017 | 10/11/2017 |
| 46 | | Sistema Eletrônico | 39d | 19/09/2017 | 10/11/2017 |
| 47 | | Software | 39d | 19/09/2017 | 10/11/2017 |
| 48 |  | Prova | 1d | 06/10/2017 | 06/10/2017 |
| 49 |  | Elaboração Relatório PC2 | 7d? | 26/10/2017 | 03/11/2017 |
| 50 |  | Apresentação Relatório PC2 | 3d? | 08/11/2017 | 10/11/2017 |
| 51 | | ☐ Transição | 17d? | 14/11/2017 | 06/12/2017 |
| 52 |  | Integração dos módulos | 14d? | 14/11/2017 | 01/12/2017 |
| 53 |  | Testes | 1d? | 30/11/2017 | 30/11/2017 |
| 54 |  | Elaboração Relatório PC3 | 9d? | 21/11/2017 | 01/12/2017 |
| 55 |  | Entrega e Apresentação do Projeto | 4d? | 01/12/2017 | 06/12/2017 |

Figura 3 – Cronograma do projeto

2 Referencial Teórico

2.1 Fenômenos de Transporte de Calor

A transferência de calor é um fenômeno em que, na física, dois corpos com temperaturas diferentes trocam suas energias térmicas quando estão em contato ou em um mesmo ambiente, para que atinjam o equilíbrio.

Alguns materiais são isolantes térmicos e tendem a evitar transferência. São importantes para prevenir gasto energético desnecessário e manter sistemas sem troca de calor se necessário.

Para o projeto proposto, é necessário uma temperatura interna entre 2 e 4 graus Celsius para preservar as características desejadas e não danificar o órgão colocado. Além disso, a caixa deve ser isolada termicamente para que minimize ao máximo as trocas de calor e não afete o órgão transportado.

Essa transferência de calor pode ser classificada de três formas diferentes: Condução, convecção e radiação.

2.1.1 Condução

Ocorre entre corpos que estão em contato físico e está relacionada com a energia cinética, a colisão entre os átomos realiza a transferência de energia cinética (calor) para as moléculas próximas. Com isso, o calor flui do local com temperaturas mais altas para o local com temperatura mais baixa.

A facilidade com que o calor transferido pode ser medido através da condutividade, normalmente, sólidos conduzem melhor que líquidos, e líquidos conduzem melhor do que sólidos.

| Material | Condutibilidade Térmica (k) |
|------------------------|-----------------------------|
| Cobre (puro) | 339 |
| Ouro (puro) | 317 |
| Alumínio (puro) | 237 |
| Ferro (puro) | 80,2 |
| Aço Carbono (1%) | 43 |
| Aço Inoxidável (18/18) | 15,1 |
| Vidro | 0,81 |
| Plásticos | 0,2 – 0,3 |
| Água (líquido) | 0,6 |

Tabela 6 – Condutividade térmica dos materiais a 300K. Fonte: BENNETT, 2008

2.1.2 Convecção

A convecção ocorre em líquidos ou gases somente. Ocorre pela diferença de densidades, o ar frio é mais denso e tom ao lugar do ar quente, o ar frio lentamente ganha calor e realiza o ciclo novamente.

Existem dois tipos de convecção: a natural (explicada acima) e a forçada, a qual utiliza aspiradores e bombas para fazer o deslocamento do fluido. (BENNETT, 2008; TIPLER, 2009).

2.1.3 Radiação

São ondas eletromagnéticas que se movem na velocidade da luz, por ser a única capaz de percorrer o espaço, é a principal maneira de transferência de calor do Sol com o planeta terra.

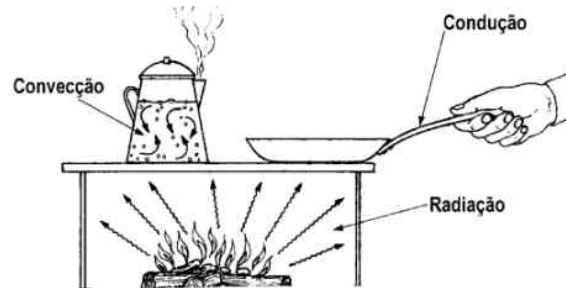


Figura 4 – Mecanismos de transferência de calor

2.2 Calorimetria

A calorimetria é o estudo do calor como energia térmica em trânsito. Com dois corpos em temperaturas diferentes, a transmissão ocorre do corpo mais quente para o mais frio até atingirem o equilíbrio térmico. Uma das medidas mais usadas é a quantidade de calor (Q), ao receber energia térmica, essa quantidade de calor é positiva, ao perder é negativa.

2.2.1 Calor Sensível e Latente

Um corpo pode receber dois tipos de calor, o latente e o sensível. O calor latente é obtido quando o corpo muda de estado físico por causa dessa transferência, já o calor sensível é apenas mudança na temperatura do corpo.

Podemos representar seus cálculos com a fórmula fundamental da calorimetria e a equação para calcular o calor latente. Que são:

$$Q_S = m \cdot c \cdot \Delta T \quad (2.1)$$

$$Q_L = m \cdot L \quad (2.2)$$

Onde:

- Q_S = Quantidade de calor sensível (em joules)
- m = Massa do corpo em gramas
- c = Calor sensível
- ΔT = Diferença de temperatura em $^{\circ}\text{C}$
- Q_L = Quantidade de calor Latente (em joules)
- L = Constante de calor latente

2.3 Sistemas de Refrigeração

A área de refrigeração se desenvolveu de uma maneira extraordinária no último século, o que ocasionou sua atuação nos mais diversos campos da indústria. Para fins de estudos, as aplicações da refrigeração podem ser classificadas da seguinte forma: doméstica, comercial, industrial, para transporte e para condicionamento de ar. A primeira, refrigeração doméstica, abrange principalmente a fabricação de refrigeradores de uso doméstico e de freezers. A capacidade destes refrigeradores varia muito, mas se encontram na faixa de temperaturas entre -8°C a -18°C (no compartimento dos congelados) e $+2^{\circ}\text{C}$ a $+7^{\circ}\text{C}$ (no compartimento dos produtos resfriados).

A refrigeração comercial envolve os refrigeradores especiais ou de grande porte utilizados principalmente em restaurantes, sorveterias, bares, açougues, laboratórios, entre outros. As suas temperaturas de congelamento e estocagem, são geralmente entre -5°C e -30°C .

Os equipamentos industriais, em sua maioria, são maiores que os comerciais (com relação ao tamanho) e possuem como característica principal a necessidade de um operador de serviço. São exemplos de aplicações industriais as fábricas de gelo, grandes instalações de empacotamento de gêneros alimentícios, como carnes, peixes e aves, cervejarias, fábricas de laticínios, de processamento de bebidas, dentre outras.

A refrigeração marítima é referente à refrigeração a bordo de embarcações e inclui, por exemplo, a refrigeração realizada em barcos de pesca e em embarcações de transporte de cargas perecíveis. A refrigeração de transporte, por outro lado, envolve equipamentos de refrigeração para caminhões e vagões ferroviários refrigerados.

Como se pode analisar, as aplicações na área da refrigeração são bem variadas, sendo difícil de uma certa maneira estabelecer de forma precisa as barreiras de cada uma dessas divisões.

2.3.1 Sistema de Compressão Mecânica de Vapor (CMV)

O sistema de compressão mecânica de vapor, utilizado na maioria dos sistemas de refrigeração atual, inclusive nos refrigeradores domésticos, funciona a partir da aplicação dos conceitos de calor e trabalho, utilizando um fluido refrigerante. Este fluido é uma substância que, circulando dentro de um circuito fechado, tem a capacidade de retirar o calor de um meio ao mesmo tempo em que se vaporiza em baixa pressão. O fluido entra no evaporador a baixa pressão, na forma de mistura de líquido-vapor, e retira energia do meio interno refrigerado (energia dos alimentos) enquanto passa para o seu estado de vapor. O vapor entra no compressor onde é comprimido e bombeado, transformando-se em vapor superaquecido e movimentando-se para o condensador, que possui a função de liberar a energia retirado dos alimentos e resultante do trabalho de compressão para o meio exterior. O fluido, ao liberar essa energia, passa do estado de vapor superaquecido para líquido, ou seja ocorre o processo de condensação, e finalmente entra no dispositivo de expansão, onde a sua pressão é reduzida, para novamente ingressar no evaporador e reiniciar o ciclo. Esse processo é ilustrado na figura a seguir (Fig. 5):

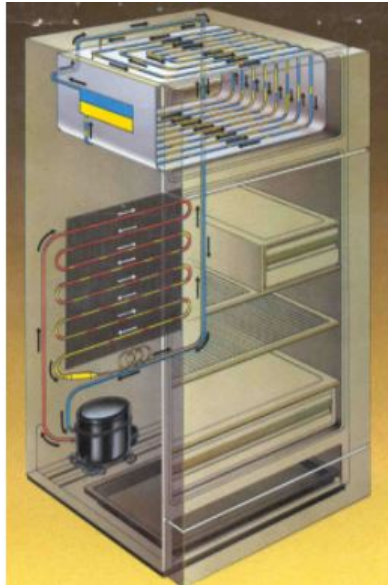


Figura 5 – Modelo de um CMV

Os principais componentes desse sistema e suas funções estão definidas a seguir:

- **COMPRESSOR:** Sua principal função é succionar o fluido refrigerante a baixa pressão da linha de sucção e comprimí-lo em direção ao condensador a alta pressão e temperatura na fase gasosa (vapor superaquecido).



Figura 6 – Modelo de um compressor

- **CONDENSADOR:** Por meio do condensador e suas aletas, o fluido refrigerante advindo do compressor a alta temperatura, efetua a troca de calor com o ambiente externo, liberando o calor que foi absorvido no evaporador e no processo de compressão. Nesta etapa, ocorre uma transformação de vapor superaquecido para líquido sub resfriado a alta pressão.




Figura 7 – Modelo de um condensador

- **FILTRO SECADOR:** Executa duas funções muito importantes: A primeira é reter as partículas sólidas que em circulação no circuito, podem provocar obstruções ou danos aos componentes mecânicos do compressor. A segunda é absorver totalmente a umidade residual do circuito que ocasionalmente não tenha sido retirada pelo processo de vácuo, poupando danos ao sistema, como por exemplo, a formação de ácidos, corrosão, aumento das pressões de trabalho e obstrução do tubo capilar por congelamento das gotículas de umidade.




Figura 8 – Modelo de um filtro secador

- **TUBO CAPILAR:** É um tubo de cobre com o diâmetro reduzido que tem como finalidade receber o fluido refrigerante do condensador e proporcionar a perda de carga do fluido refrigerante separando os lados de alta e baixa pressão.
- **EVAPORADOR:** Recepciona o fluido refrigerante proveniente do tubo capilar, em seu estado líquido a baixa pressão e temperatura. Desta forma, o fluido evapora absorvendo o calor da superfície da tubulação do evaporador, ocorrendo a transformação de líquido sub resfriado para vapor saturado a baixa pressão. Este efeito ocasiona a diminuição de temperatura do ambiente interno do refrigerador.




Figura 9 – Modelo de um evaporador

De forma parecida funcionam também os grandes sistemas de refrigeração, como as câmaras frigoríficas por exemplo. O que difere entre esses sistemas é o número de unidades compressoras, evaporadoras, de expansão e condensadoras compreendidas, que nestes últimos podem ser múltiplos, bem como o sistema de controle que pode se tornar altamente complexo.

2.4 Modelo cliente-servidor/sistema web

Em um modelo cliente-servidor, os dados de um sistema são armazenados em poderosos computadores chamados servidores. Os usuários utilizam máquinas mais simples, chamadas de clientes. As máquinas cliente e servidor são conectadas entre si por uma rede, conforme ilustrado pela Fig. 10.

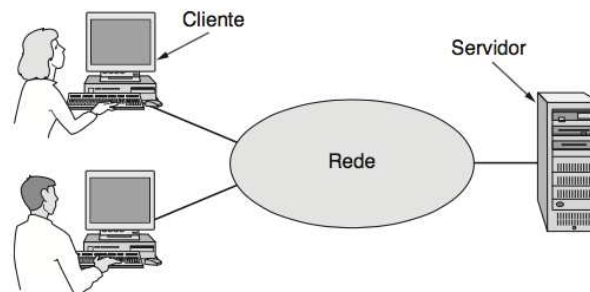


Figura 10 – Modelo cliente-servidor.

Em uma aplicação web, o servidor fornece páginas Web com base em seu banco de dados em resposta a solicitação do cliente. Sob a maioria das condições, um único servidor pode lidar com um grande número (centenas ou milhares) de clientes simultaneamente.

Examinando o modelo cliente-servidor em detalhes, é possível perceber que existem dois processos em execução, um na máquina cliente e outro na máquina servidor. A comunicação toma a forma do processo cliente enviando uma mensagem pela rede ao processo servidor. Então, o processo cliente espera por uma mensagem de resposta. Quando processo servidor recebe a solicitação, ele executa o trabalho solicitado ou procura pelos dados solicitados e envia uma resposta de volta (Fig.) (TENENBAUM, 2011).

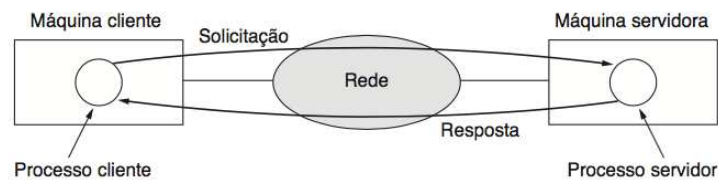


Figura 11 – Mensagens trocadas entre um processo cliente e um processo servidor

2.5 Framework Django

Django é um framework gratuito e de código aberto para a criação de aplicações web, escrito em Python, uma linguagem de programação multiparadigma. É um framework web, ou seja, é um conjunto de componentes que ajuda a desenvolver sites de forma mais rápida e mais fácil.

Quando se está construindo um site, o desenvolvedor sempre precisa de um conjunto similar de componentes: uma maneira de lidar com a autenticação do usuário (inscrever-se, realizar login, realizar logout), painel de gerenciamento para o seu site, formulários, upload de arquivos, etc. Há muito tempo, outras pessoas notaram várias semelhanças nos problemas enfrentados pelos desenvolvedores web quando estão criando um novo site, então eles uniram-se e criaram os frameworks (Django é um deles) que lhe dão componentes prontos, que você pode usar. O framework Django utiliza o padrão MTV (model-template-view), onde as views funcionam como controllers e templates funcionam como views.

2.6 Sistema interno

Sistema responsável por se comunicar com o aparato eletrônico, recebendo dados e interpretá-los. Para isso, será utilizado a linguagem de programação C++. C++ é uma linguagem de programação de alto nível com facilidades para o uso em baixo nível. Foi desenvolvida por Bjarne Stroustrup (foto) como uma melhoria da linguagem C, e desde os anos 1990 é uma das linguagens mais populares do mundo.

Alguns profissionais afirmam que C++ é a linguagem mais poderosa que existe, veja algumas características dela:

- É um superconjunto da linguagem C, e contém vários melhoramentos;
- É a porta para a programação orientada a objetos;
- C++ pode virtualmente ser efetivamente aplicado a qualquer tarefa de programação;
- Há vários compiladores para diversas plataformas tornando a linguagem uma opção para programas multiplataforma.

2.7 Ergonomia de carregamento de peso

Para uma pessoa de 18 a 35 anos, os limites de pesos que podem ser levantados sem causar problemas à sua saúde são 40 kg para homens e 20 kg para mulheres. Portanto em média 30 kg por pessoa. Deste modo, um objeto carregado por duas pessoas poderia pesar um máximo de 60 kg. Aplicando um fator de segurança de 30%, o peso máximo para um objeto carregado por duas pessoas é aproximadamente 40 kg.

2.8 TERMOVIDA – Caixa térmica para transporte de órgãos para transplantes

O projeto TERMOVIDA consiste em uma caixa térmica para transporte de órgãos para transplantes com um sistema de refrigeração autônoma.

A legislação da ANVISA regulamenta como deve se dar o transporte de órgãos para transplante, as informações que devem ser coletadas que constatarem o tempo de vida e a temperatura ideal a ser mantida para que os órgãos que sejam transportados em segurança por este dispositivo puderam indicar como deve ser o recipiente e quais são os equipamentos necessários para que o mesmo funcione corretamente.

Neste projeto, é utilizada uma pastilha de efeito Peltier para a refrigeração da caixa, controlada por histerese, via um micro-controlador. O equipamento, utilizado durante o transporte em veículos, utiliza alimentação elétrica do sistema de 12V do veículo.

A estrutura da caixa é feita de material isolante térmico. Esta possui uma porta de ventilação na lateral, onde está posicionada a pastilha Peltier, e um espaço no qual um painel LCD sensível ao toque está alocado. O painel é responsável por mostrar as condições monitoradas.



Figura 12 – TERMOVIDA - Caixa térmica para transporte de órgãos para transplantes

3 Solução Proposta

3.1 Arquitetura de Software

O projeto proposto irá dispor de sistemas de softwares distintos que se comunicam entre si, ao qual irão ser responsáveis pelo controle, recepção e apresentação dos dados aos usuários, oriundos do sensoramento da transportadora de órgãos.

3.1.1 Sistema Interno

Para o sistema implementado junto ao módulo eletrônico da transportadora será utilizado a linguagem de programação C++, que será responsável pela transmissão e recepção dos dados por meio dos sensores e circuitos. Este sistema será integrado junto ao sistema web por meio de arquitetura cliente-servidor ao qual será especificado posteriormente.

3.1.1.1 Requisitos funcionais

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF001 | | |
| Nome | Apresentar o nível de pressão da caixa transportadora | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O sistema deve ser capaz de apresentar o nível de pressão registrado pelo sensor de pressão integrado na caixa transportadora | | |

Tabela 7 – Sistema interno - requisito funcional 001

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF002 | | |
| Nome | Apresentar o nível de temperatura da caixa transportadora | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O sistema deve ser capaz de apresentar o nível de temperatura registrado pelo sensor de temperatura integrado na caixa transportadora | | |

Tabela 8 – Sistema interno - requisito funcional 002

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF003 | | |
| Nome | Controlar o nível de temperatura manualmente | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O usuário é capaz de controlar o nível de temperatura da caixa transportadora manualmente | | |

Tabela 9 – Sistema interno - requisito funcional 003

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF004 | | |
| Nome | Controlar o nível de pressão manualmente | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O usuário é capaz de controlar o nível de pressão da caixa transportadora manualmente | | |

Tabela 10 – Sistema interno - requisito funcional 004

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF005 | | |
| Nome | Controlar o nível da temperatura automaticamente | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O sistema deve ser capaz de sensoriar e controlar a o nível de temperatura da caixa transportadora automaticamente de acordo com o órgão a ser transportado | | |

Tabela 11 – Sistema interno - requisito funcional 005

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF006 | | |
| Nome | Controlar o nível da pressão automaticamente | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O sistema deve ser capaz de sensoriar e controlar a o nível de pressão da caixa transportadora automaticamente de acordo com o órgão a ser transportado | | |

Tabela 12 – Sistema interno - requisito funcional 006

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF007 | | |
| Nome | Selecionar parâmetros pré-definidos de acordo com o órgão | | |
| Módulo | Sistema interno | | |
| Versão | 1 | Prioridade | Desejável |
| Descrição | Quando o usuário escolher o tipo de órgão a ser transportado, o sistema deve ser capaz de selecionar automaticamente parâmetros de pressão e temperatura pré-definidos para aquele tipo de órgão. | | |

Tabela 13 – Sistema interno - requisito funcional 007

3.1.2 Sistema Web

Para a construção da aplicação proposta foi definido a implementação de um sistema web no qual ficarão dispostas as informações do sensoriamento da transportadora, além de informações de localização pelo GPS integrado. Este sistema terá como servidor a Raspberry Pi e os usuários poderão se conectar e visualizar o transporte do órgão.

Dessa forma, a implementação deste sistema utilizará das seguintes tecnologias:

- Linguagem de Programação Python - linguagem de programação de alto nível, multiparadigma, interpretada e de tipagem dinâmica e forte;
- Django Framework - framework para desenvolvimento web, escrito em Python, open source, que utiliza o padrão model-template-view. (MTV), utiliza por padrão banco de dados Sqlite3.

3.1.2.1 Requisitos funcionais

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF008 | | |
| Nome | Apresentar o nível de pressão da caixa transportadora | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O web app deve ser capaz de apresentar ao usuário a informação do nível de pressão advindo do sensor de pressão da caixa transportadora | | |

Tabela 14 – Sistema Web - requisito funcional 008

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF009 | | |
| Nome | Apresentar o nível de temperatura da caixa transportadora | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O web app deve ser capaz de apresentar ao usuário a informação do nível de temperatura advindo do sensor de temperatura da caixa transportadora | | |

Tabela 15 – Sistema Web - requisito funcional 009

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF010 | | |
| Nome | Apresentar a localização em tempo real da caixa transportadora | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O web app deve ser capaz de apresentar a localização em tempo real advindo do GPS integrado na caixa transportadora | | |

Tabela 16 – Sistema Web - requisito funcional 010

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|
| Identificador | RF011 | | |
| Nome | Cadastrar médicos | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O web app deve permitir o cadastro de médicos certificados com CRM | | |

Tabela 17 – Sistema Web - requisito funcional 011

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF012 | | |
| Nome | Possuir nível de acesso admin | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O web app deve possuir um nível de acesso de administrador com privilégios próprios | | |

Tabela 18 – Sistema Web - requisito funcional 012

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| Identificador | RF013 | | |
| Nome | Possuir nível de acesso médico | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 2 | Prioridade | Essencial |
| Descrição | O web app deverá possuir um nível de acesso para médicos, o qual é inferior o nível de acesso admin | | |

Tabela 19 – Sistema Web - requisito funcional 013

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|
| Identificador | RF014 | | |
| Nome | Apresentar informações do órgão a ser transportado | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 1 | Prioridade | Desejável |
| Descrição | O web app deve ser capaz de apresentar algumas informações do órgão que está sendo transportado no momento | | |

Tabela 20 – Sistema Web - requisito funcional 014

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------|
| Identificador | RF015 | | |
| Nome | Gerar relatório do processo de transporte do órgão | | |
| Módulo | Sistema Web | | |
| Versão | 1 | Prioridade | Desejável |
| Descrição | O web app deve ser capaz de gerar um relatório final com registros do processo de transporte de algum órgão específico. Como por exemplo: a variação de temperatura e pressão, o registro do deslocamento (origem, destino e percurso)... | | |

Tabela 21 – Sistema Web - requisito funcional 015

3.2 Sistema de Refrigeração

3.3 Sistema de Alimentação

As fontes de energia que serão utilizadas para alimentar o produto, incluindo o sistema de refrigeração e os componentes elétricos e eletrônicos, são a rede elétrica comum brasileira e um banco de baterias. O banco de baterias será dimensionada a fim de manter os subsistemas em perfeita operação durante o período solicitado de 48 horas.

3.3.1 Diagrama do Sistema

A Figura a seguir apresenta o diagrama elétrico simplificado do produto. Ele representa o circuito de alimentação utilizado, desde a fonte de energia — rede elétrica padrão — até o uso final em seus componentes elétricos e eletrônicos. É importante ressaltar que este diagrama será refinado ao longo dos pontos de controle, pois o sistema pode ser retificado para melhor atender às condições de contorno que forem encontradas durante a execução do projeto.

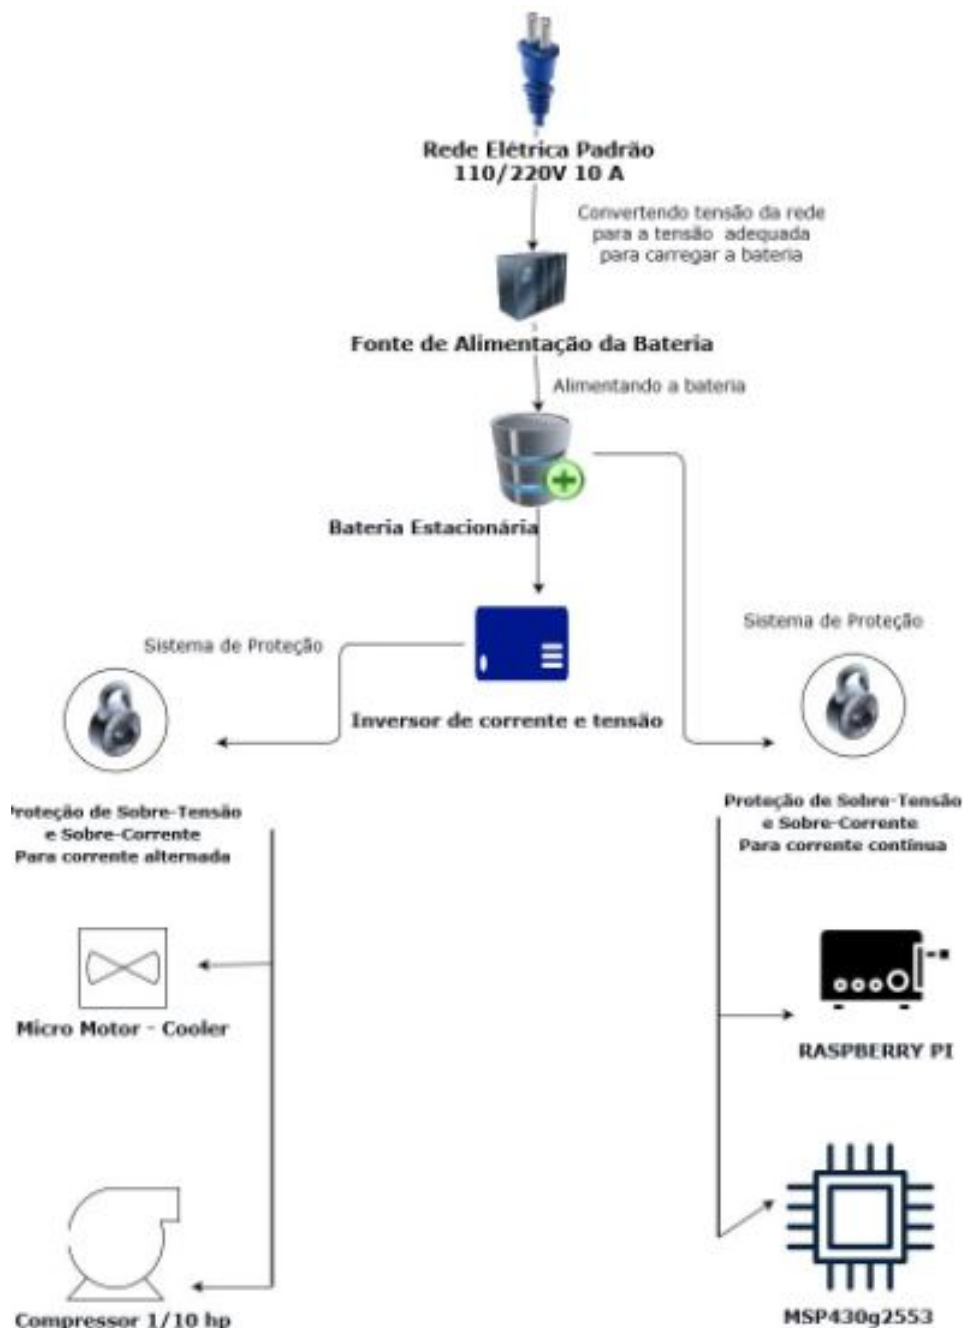


Figura 13 – Diagrama Elétrico Preliminar

O sistema foi dimensionado com um fator de segurança elevado, pois a proposta de projeto é de um sistema de acondicionamento de órgãos para transplante. Sendo assim, o nível de confiabilidade do produto deve ser extremamente alto, para isso todo o sistema de alimentação foi dimensionado relati-

onando o sistema ao tempo de operação necessário ao transporte e diretamente ao consumo de energia advinda da bateria.

3.3.2 Dimensionamento das Baterias

Baterias têm a finalidade de armazenar energia e liberá-la em determinada periodicidade, e de forma controlada. Sua escolha deve ser adequada às necessidades de consumo energético do projeto, e considera os dados de corrente elétrica e tensão. Para a seleção da bateria adequada deve-se estudar se ela é capaz de armazenar a energia total demandada às necessidades do projeto, e se ela consegue entregar toda a energia necessária ao funcionamento do equipamento. O processo de dimensionamento do banco de baterias deve ser realizado inicialmente e depois sucessivamente aperfeiçoado, em função dos demais dimensionamentos e ajustado em função dos custos, disponibilidade de mercado, entre outros.

O processo de dimensionamento deve seguir algumas etapas, a primeira delas é definir o tipo de bateria a ser utilizado. Dentre as opções de bateria disponíveis no mercado, optou-se pela bateria estacionária. Sua vida útil é de aproximadamente 5 anos, devido à sua composição com materiais internos mais sobres se comparada às baterias automotivas, por exemplo. Podem, também, suportar descargas de até 80% de sua capacidade, sem prejudicar sua vida útil, e resistem a ciclos de carga ou descarga mais profundos. Tais características proporcionam maior confiabilidade ao funcionamento do projeto pelo uso da bateria estacionária.

Após a escolha do tipo de bateria, deve ser analisada a profundidade de descarga com que se vai trabalhar. Quanto mais profundos os ciclos de descarga-carga, menor a vida útil da bateria. Ou seja, reduzir-se a capacidade da bateria, gasta-se menos no início, porém as baterias durarão menos e os gastos com reposição serão maiores. Um valor usado para essa profundidade de descarga para ciclos diários com baterias de chumbo-ácido é de 10% a 20%. Para ciclos esporádicos, podem ser utilizados ciclos mais profundos, da ordem de 60%.

A capacidade do banco de baterias em Ah pode ser calculada conforme a expressão abaixo:

$$Capacidade(Ah) = \frac{Consumo(\frac{Wh}{dia}) \times Autonomia(dias)}{V_{Baterias}(V) \times profundidade(pu)} \quad (3.1)$$

O dimensionamento da bateria requer inicialmente a relação de potência demandada para suprir as necessidades dos componentes elétricos do projeto, como mostra a tabela a seguir:

Tabela 22 – Consumo energético dos componentes

| COMPONENTE | ALIMENTAÇÃO (V) | CORRENTE (A) | POTÊNCIA (W) |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| MSP430g2553 | 5 | 330 μ | 1,65 mW |
| RASPBERRY PI | 5 | 2,5 | 12,5 |
| PROTETOR | 12 | 26,5m | 318m |
| COMPRESSOR $\frac{1}{10} HP$ | 12 | 2,4 | 28,33 |
| MICRO MOTOR | 12 | 260,9m | 3,6 |

Ao somar todas as cargas necessárias, o total foi de 229,819 Wh, já o consumo de corrente fica em 3,5365 A/h. O principal problema é o alto valor de partida do motor-compressor, o que é chamado de corrente de pico, no caso do motor-compressor utilizado, a corrente pode atingir um o valor entre 2-3 Ampères, o que requer atenção ao dimensionar a bateria para que ela suporte esse aumento inicial.

Com relação a profundidade da descarga no final da autonomia (pu) - utilizamos 0,6 (descargas mais profundas significam vida útil menor para a bateria e menos profundas um investimento inicial maior). Sendo que o consumo total é obtido a partir do levantamento das cargas, a autonomia de 5 horas.

Logo,

$$Capacidade \approx 33,2439Ah$$

3.3.3 Dimensionamento do Inversor

Inversores são conversores estáticos que, segundo Matakas Jr. E Komatsu (2011) transformam corrente ou tensão de forma contínua para a alternada. Muitos equipamentos operam em corrente/tensão contínua, sendo que a rede elétrica opera em corrente/tensão contínua. Portanto, a maneira mais simples de se trabalhar sem necessidade de mudanças drásticas em nenhum dos dois sistemas é se utilizar um inversor.

Este equipamento pode ser monofásico ou trifásico, sendo que o modelo utilizado no projeto será monofásico, e irá converter 12V da bateria que alimenta o sistema para 220V, valor de tensão que os outros componentes do sistema trabalham. Neste caso, com apenas duas chaves eletrônicas e uma fonte de tensão CC dividida é possível obter o inversor desejado.

Os inversores podem operar com duas tecnologias, senóide modificada ou senóide pura. No primeiro caso, formam uma onda quadrática, aproximando-se da senoidal AC, bom custo x benefício e pode ser aplicado na maioria dos casos, exceto para motores. O segundo caso pode ser usado como suprimento de energia AC em qualquer sistema, o que difere é o valor e o tamanho.

Um inversor bem dimensionado tem a potência maior que o consumo dos equipamentos para evitar que este trabalhe sempre em máxima potência, em suma um inversor é projetado em 3 estágios, oscilador, driver de corrente e transformador.



Figura 14 – Diagrama Elétrico Preliminar

Em primeiro lugar o oscilador transforma a corrente contínua em uma onda quadrada de 60Hz, que precisa ser adequada para uma onda senoidal, para isso é utilizado um filtro passa faixa centrado em 60Hz para eliminar as harmônicas indesejadas e obter uma onda senoidal mais eficaz possível. Entretanto, a saída do oscilador possui uma corrente muito baixa, por isso é necessário um ganho de corrente, para que seja entregue uma potência satisfatória na entrada do primário do transformador. Como a potência requerida é muito alta, se faz necessário que sejam inseridos vários transistores em paralelo para aumentar o ganho de corrente.

Na última fase o transformador faz a elevação da tensão para 220V que é a tensão necessária para ligar o compressor.

3.3.4 Requisitos

Com vistas à concepção e validação da solução, foram definidos os requisitos relativos ao sub-sistema de alimentação e refrigeração do produto:

3.3.4.1 Requisitos Funcionais

O sistema de alimentação deve ser capaz de:

- Armazenar energia elétrica;
- Fornecer energia para os componentes elétricos e eletrônicos de controle e monitoramento do produto;
- Fornecer energia para o sistema de refrigeração.

3.3.4.2 Requisitos Não Funcionais

O sistema de alimentação deve ser capaz de:

- Prover a energia necessária para o bom funcionamento do produto durante um período máximo de 48 horas, com armazenamento de energia em baterias;
- O sistema deve ser capaz de controlar a potência que será entregue as placas de peltier;
- Possuir eficiência energética aceitável, através de um controle de potência no sistema de refrigeração, escolha de componentes eletrônicos de baixa potência e sistemas de standby em determinados componentes não críticos do produto;
- Ser estável energeticamente, evitando picos de potência com componentes e segurança de circuitos.

3.4 Estrutura

3.4.1 Arquitetura da estrutura

A estrutura da transportadora de órgãos será feita considerando como principais fatores a mobilidade e a capacidade de comportar todos os sistemas cumprindo os requisitos de projeto. Além disso, desejou-se aproximar o centro de massa o mais no centro possível da estrutura geral para gerar estabilidade.

Os esquemáticos a seguir mostram de forma simplificada as dimensões, composição e disposição dos elementos estruturais.

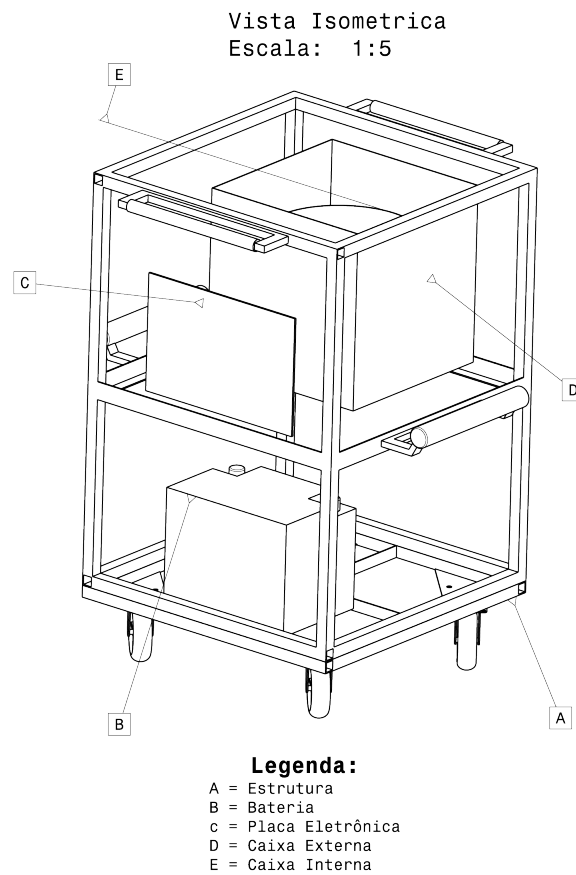


Figura 15 – Estrutura básica da transportadora de órgãos

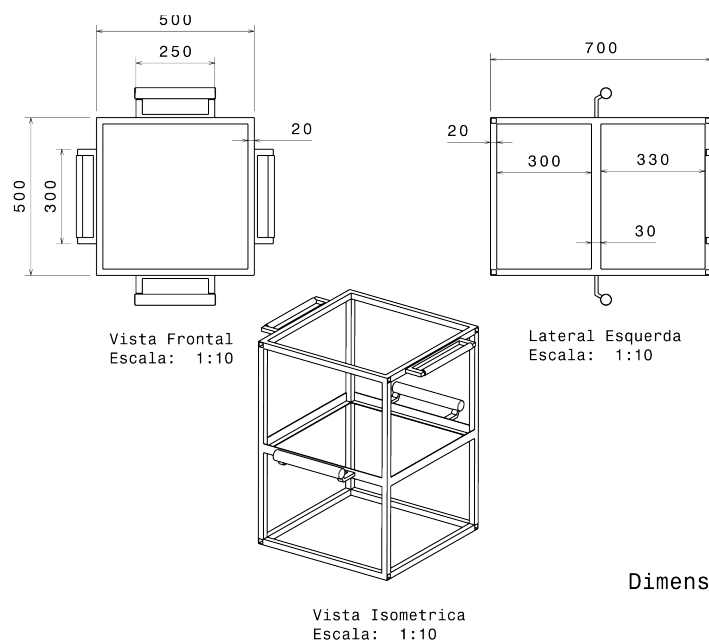


Figura 16 – Dimensões da estrutura principal do carrinho

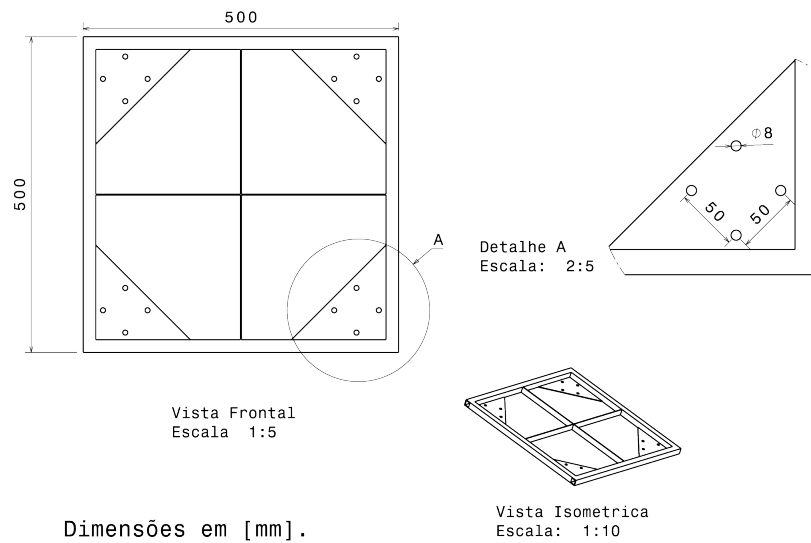


Figura 17 – Dimensões da base de apoio da estrutura

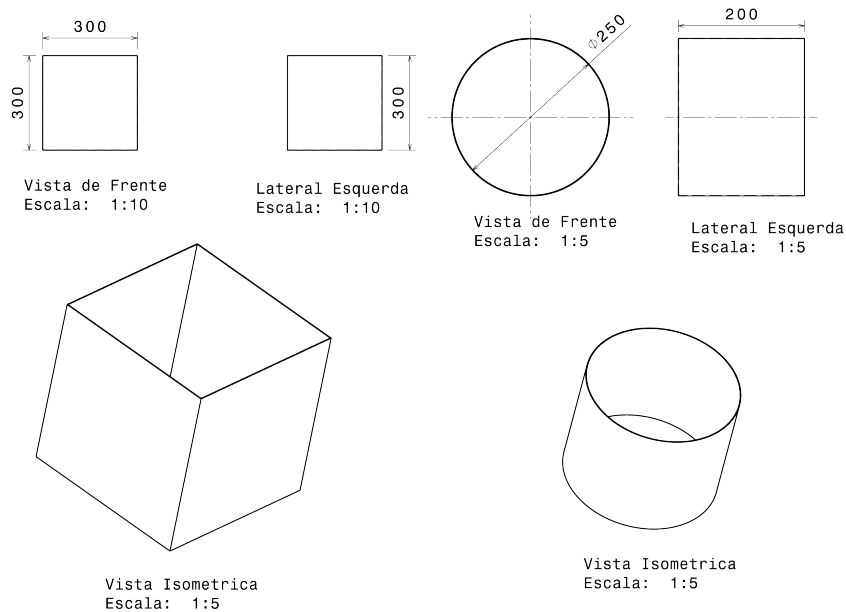


Figura 18 – Dimensões dos elementos estruturais internos

3.4.2 Materiais principais

O material estrutural tem como objetivo resistir aos esforços durante a utilização da transportadora de órgãos. As cargas de ocorrências durante sua utilização são puramente estáticas, além disso, o projeto deve conciliar baixo custo com baixo peso. Portanto, uma boa opção é o metalon, um aço carbono com costura de baixo custo comumente utilizado em estruturas mecânicas.

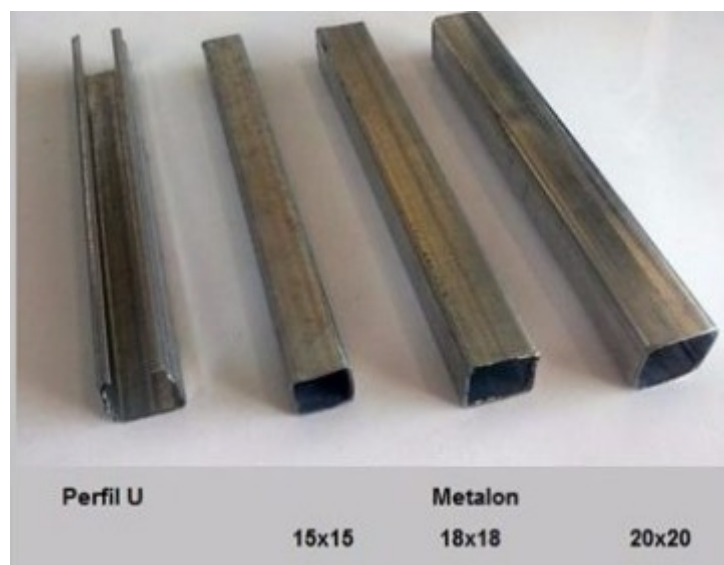


Figura 19 – Perfis de Metalon

Para a caixa de alocação de órgãos, foi escolhido o aço inox, devido suas propriedades anticorrosivas e térmicas, aliadas ao baixo custo e maior facilidade de aquisição quando comparado com o aço cirúrgico.

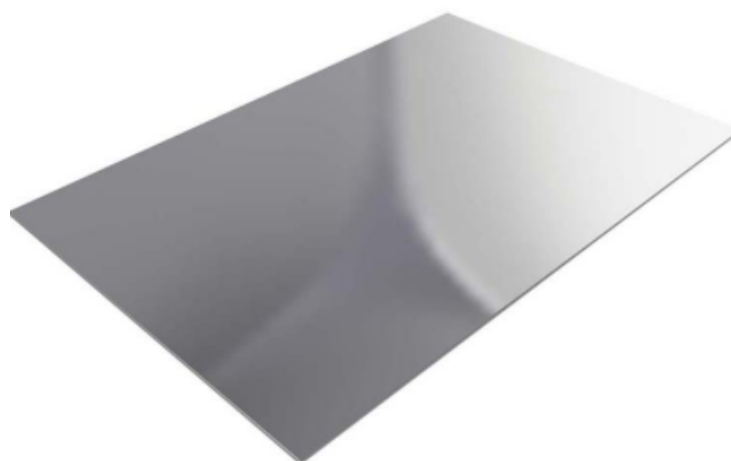


Figura 20 – Chapa de Aço Inox 304

A carenagem em volta da estrutura será feita de Policloreto de Vinila (PVC), por ser um material leve e de fácil maneabilidade.



Figura 21 – Chapas de Policloreto de Vinila

3.4.3 Requisitos

3.4.3.1 Requisitos Funcionais

- Ser capaz de armazenar o órgão hermeticamente
- Comportar todos os outros subsistemas
- Ser móvel e carregável
- Todas as partes internas do compartimento de carga devem ser capazes de passar por processo de esterilização

3.4.3.2 Requisitos não-funcionais

- Possuir compartimento que possa ser completamente vedado
- Possuir sistema de rodas para movimentação em solo e alças para carregamento manual
- Pesar um máximo de 40 kg
- As peças que serão refrigeradas devem ser resistentes a corrosão
- Os elementos responsáveis por suportar cargas devem ter resistência para isto
- O sistema de rodas deve ser capaz de fácil anexagem e desanexagem
- O compartimento de carga de órgãos deve ser facilmente anexado e desanexado em seu local

3.4.4 Desafios Técnicos

3.4.4.1 Isolamento térmico da câmara

Para ajudar a manter uma baixa temperatura estável na câmara fria, é necessário que haja um isolamento térmico em volta do compartimento resfriado. Para isto será feito um revestimento de poliestireno expandido (isopor) ou espuma de poliuretano ao redor da câmara fria.

3.4.4.2 Esterilização do sistema

De acordo com as normas o compartimento no qual o órgão estará contido deve ser esterilizado, portanto deve ser capaz de fácil montagem e desmontagem, o cria um desafio para a fabricação de um compartimento que seja facilmente retirado quando necessário, mas ao mesmo tempo deve estar fixo durante todo o transporte do órgão. Em vista disso, o compartimento estará anexado a estrutura através de peças centralizadoras de seção quadrada com as dimensões da câmara fria e um furo cujo diâmetro é o mesmo do compartimento de carga.

3.4.4.3 Mobilidade do sistema

A transportadora possui fácil mobilidade como requisito, o que traz como desafio técnico como será feito o sistema de mobilização de modo estável. A solução que será adotada consiste em módulo que pode ser anexado e desanexado da estrutura principal. Deste modo, quando necessário colocar a transportadora em cima de uma bancada ou algo semelhante, é possível desanexar o módulo de mobilização. O módulo possuirá rodas de baixa vibração e boa capacidade de carga com travas.

3.5 Sistemas Eletrônicos

Com vistas à concepção e validação da solução, foram definidos os requisitos relativos ao subsistema de alimentação e refrigeração do produto:

3.5.1 Servidor

O servidor será construído com auxílio do Raspberry Pi, que é um computador que praticamente o tamanho de um cartão de crédito. Ele foi desenvolvido primeiramente com o intuito de se aprender programação. Pode ser usado como um substituto para grandes computadores, pois ele permite a instalação de um sistema operacional, baseado em Linux, como o Raspbian. Com a sua boa capacidade de processamento ele permite inclusive que se possa jogar certos jogos e ver vídeos em alta definição. Os pinos de propósito geral de entrada/saída (GPIO, general purpose input/output) permitem que ela seja usada para uma grande variedade de várias aplicações. Esses pinos são pinos de entrada e saída digitais.



Figura 22 – Vista superior da Raspberry

A Raspberry Pi 3 possui um processador quad core de 1.2GHz, 64 bits, uma placa de rede wireless, módulo Bluetooth, 4 portas USB, 40 pinos de entrada e saídas digitais, GPIOs, porta HDMI, por Ethernet, conector de áudio 3.5mm, P2, um slot para cartão micro SD. Para a sua alimentação, é necessário uma

fonte de 5V e de 2A, totalizando um gasto de energia de 10W. Se a fonte não consegue fornecer uma tensão e essa corrente especificada, a placa de desenvolvimento pode funcionar de uma maneira inadequada e não conseguindo tomar todas as ações necessárias comprometendo o funcionamento do sistema que depende dela como um todo.

A sua utilização, será feita conjunto com outros microcontroladores, pois mesmo havendo uma alta capacidade de processamento, ela não é muito adequada para situações em que se necessite processamento quase em tempo real. Isso ocorre pois ela está em amplo funcionamento com um sistema operacional, o que consome muitos recursos do processamento.

Para a sua utilização em conjunto, será necessária o uso de um protocolo de comunicações, como o I2C, SPI ou UART, essa escolha será feita para que se tenha um melhor aproveitamento da velocidade de comunicação. I2C e SPI, levam uma vantagem, pois ela permite que seja feito uma rede de comunicação com vários dispositivos. Isso é permitido, pois se pode haver um mestre, que determina a velocidade de transmissão, e vários escravos que vão se comunicando com o mestre.

3.5.2 Circuito Preventivo

O circuito preventivo visa proteger o sistema como um todo da ocorrência de sobretensão, evitando assim que se danifique o produto. Ele é feito tendo como base um relé e um diodo Zener. Sua função é interromper a passagem de corrente no momento em que a tensão de entrada ultrapassa um valor limiar. O circuito está ilustrado logo abaixo:

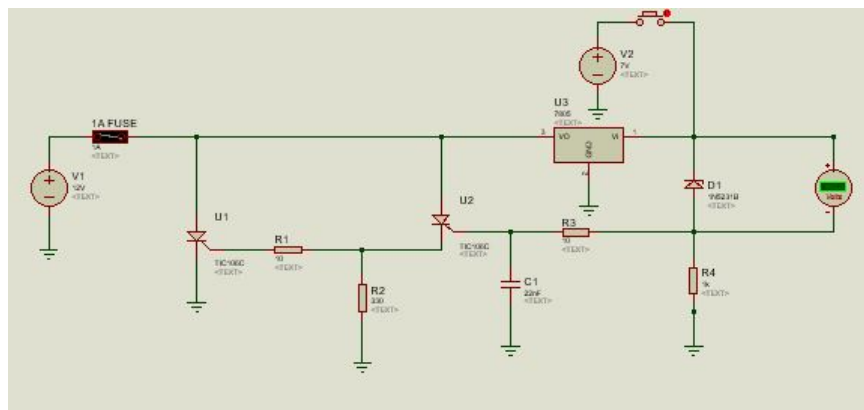


Figura 23 – Circuito de proteção

3.5.3 Controle PWM

O controle PWM — tanto o que agirá sobre o cooler quanto o que agirá sobre a célula peltier — está ilustrado na figura logo abaixo:

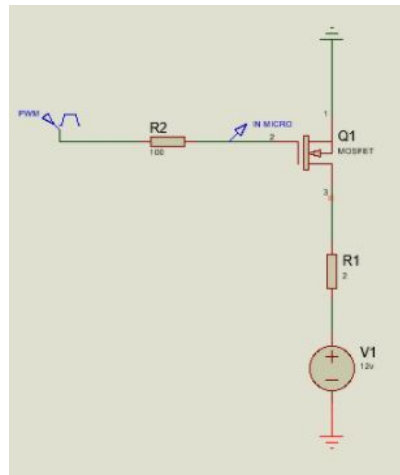


Figura 24 – Circuito responsável pelo controle PWN

Ligado a esse circuito, está o controlador MSP430, responsável por utilizar um dos seus pinos como saída PWM para que o circuito acima o amplifique com auxílio do MOSFET. Conforme o datasheet, o pino PWM do MSP430 é o P1.6

3.5.3.1 Subsistema de Controle

O sistema de controle deve ser capaz de:

- Realizar a aquisição de dados através de sensores;
- Realizar o controle de potência fornecida para os coolers e placa peltier;
- Transmitir os dados dados recebidos para outra placa;
- Tomada de decisão de acordo com os dados.

3.5.3.2 Subsistema de Proteção

O sistema de proteção deve ser capaz de:

- Proteger o circuito de sobretensão;
- Proteger o circuito de sobrecorrente.

3.5.3.3 Subsistema de Comunicação e Análise

O sistema de proteção deve ser capaz de:

- Analisar todos os dados advindos de sensores e outros componentes;
- Transmitir dados para um servidor WEB;
- Transmitir dados usando algum tipo de rede sem fio.

| ESTIMATIVA DE CUSTOS DO PROJETO | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Custos Alimentação e Refrigeração | | | | | | | |
| MATERIAL UTILIZADO | QUANT | Unitário | Fornecedor | Total | FRETE | Desconto (%) | V. Final |
| Bateria estacionária Freedom Df 1000 70 Ah | 3 | R\$ 303,90 | Americanas | R\$ 911,70 | COMBINAR | | R\$ 911,70 |
| Fonte | 1 | R\$ 80,00 | Contato | R\$ 80,00 | COMBINAR | | R\$ 80,00 |
| Dissipadores de Calor | 2 | R\$ 10,00 | Contato | R\$ 20,00 | COMBINAR | | R\$ 20,00 |
| Cooler | 2 | R\$ 10,00 | Contato | R\$ 20,00 | COMBINAR | | R\$ 20,00 |
| Pasta Térmica CDA 15g | 2 | R\$ 5,00 | Mercado Livre | R\$ 10,00 | COMBINAR | | R\$ 10,00 |
| Cabos e conectores em geral | | | Contato | R\$ 60,00 | COMBINAR | | R\$ 60,00 |
| SOMA | | | | R\$ 1.101,70 | | | R\$ 1.101,70 |
| CUSTOS DE ELETRÔNICA | | | | | | | |
| MATERIAL UTILIZADO | QUANT | Unitário | Fornecedor | Total | FRETE | Desconto (%) | V. Final |
| Im7805 | 2 | R\$ 3,00 | Contato | R\$ 6,00 | COMBINAR | | R\$ 6,00 |
| Im7812 | 2 | R\$ 3,00 | Contato | R\$ 6,00 | COMBINAR | | R\$ 6,00 |
| TIC106C | 4 | R\$ 7,50 | Contato | R\$ 30,00 | COMBINAR | | R\$ 30,00 |
| Fusíveis | 10 | R\$ 1,00 | Contato | R\$ 10,00 | COMBINAR | | R\$ 10,00 |
| Resistores variados | 10 | R\$ 1,50 | Contato | R\$ 15,00 | COMBINAR | | R\$ 15,00 |
| apacitores variados | 10 | R\$ 1,00 | Contato | R\$ 10,00 | COMBINAR | | R\$ 10,00 |
| módulo PWM | 3 | R\$ 30,00 | Contato | R\$ 90,00 | COMBINAR | | R\$ 90,00 |
| DIODO ZENER 1N4733 (5,1V/1W) | 2 | R\$ 0,40 | Contato | R\$ 0,80 | COMBINAR | | R\$ 0,80 |
| DIODO ZENER 1N4742 (12V/1W) | 2 | R\$ 0,40 | Contato | R\$ 0,80 | COMBINAR | | R\$ 0,80 |
| SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | R\$ 22,00 | Mercado Livre | R\$ 22,00 | COMBINAR | | R\$ 22,00 |
| Display Touchscreen Raspberry | 1 | R\$ 54,00 | Mercado Livre | R\$ 54,00 | COMBINAR | | R\$ 54,00 |
| MSP430 | 1 | R\$ 60,00 | Mercado Livre | R\$ 60,00 | COMBINAR | | R\$ 60,00 |
| | | | | | | | |
| Raspberry Pi 3 | 1 | R\$ 200,00 | Mercado Livre | R\$ 200,00 | COMBINAR | | R\$ 200,00 |
| Módulo Gsm Gprs Sim 800i C/ Antena Raspberry Pi | 1 | R\$ 46,00 | Mercado Livre | R\$ 46,00 | COMBINAR | | R\$ 46,00 |
| kit refrigeração | 1 | R\$ 85,90 | Mercado Livre | R\$ 85,90 | COMBINAR | | R\$ 85,90 |
| SOMA | | | | R\$ 636,50 | | | R\$ 636,50 |
| CUSTOS DE ESTRUTURA | | | | | | | |
| MATERIAL UTILIZADO | QUANT | Unitário | Fornecedor | Total | FRETE | Desconto (%) | V. Final |
| METALON BARRA DE 6m | 2 | R\$ 14,00 | Mercado Livre | R\$ 28,00 | COMBINAR | | R\$ 28,00 |
| CHAPA DE PVC 2m X 1m X 1mm | 4 | R\$ 36,00 | Mercado Livre | R\$ 144,00 | COMBINAR | | R\$ 144,00 |
| RODINHA COM FREIO | 4 | R\$ 18,00 | Mercado Livre | R\$ 72,00 | COMBINAR | | R\$ 72,00 |
| METRO QUADRADO DE ACO INOX 1mm | 1 | R\$ 600,00 | Mercado Livre | R\$ 600,00 | COMBINAR | | R\$ 600,00 |
| CHAPA DE ALUMINIO 170mm X 53mm X 2mm | 2 | R\$ 15,00 | Mercado Livre | R\$ 30,00 | COMBINAR | | R\$ 30,00 |
| ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO | 2 | R\$ 20,00 | AMERICANAS | R\$ 40,00 | COMBINAR | | R\$ 40,00 |
| SOMA | | | | R\$ 914,00 | | | R\$ 914,00 |
| CUSTOS DE SOFTWARE | | | | | | | |
| CATEGORIA | PREÇO | MOEDA | TEMPO (ANOS) | Total | | | V. Final |
| HOSPEDAGEM DE SERVIDOR | \$100,00 | DOLAR | 1 ANO | R\$ 316,75 | | | R\$ 316,75 |
| SOMA | | | | | | | R\$ 316,75 |
| ESTIMATIVA TOTAL DO PROJETO | | | | R\$ 2.968,95 | | | |

Figura 25 – Tabela de custos

Referências

NETO, B.-h. F.; AFONSO, R. C.; THOMÉ, T. *Curso prático de extração, perfusão e acondicionamento de múltiplos órgãos para transplante*. 2017. Disponível em: <<http://docplayer.com.br/7523519-Curso-pratico-de-extracao-perfusao-e-acondicionamento-de-multiplos-orgaos-para-transplante.html>>. Acesso em: 24 out. 2017. Citado na página 7.