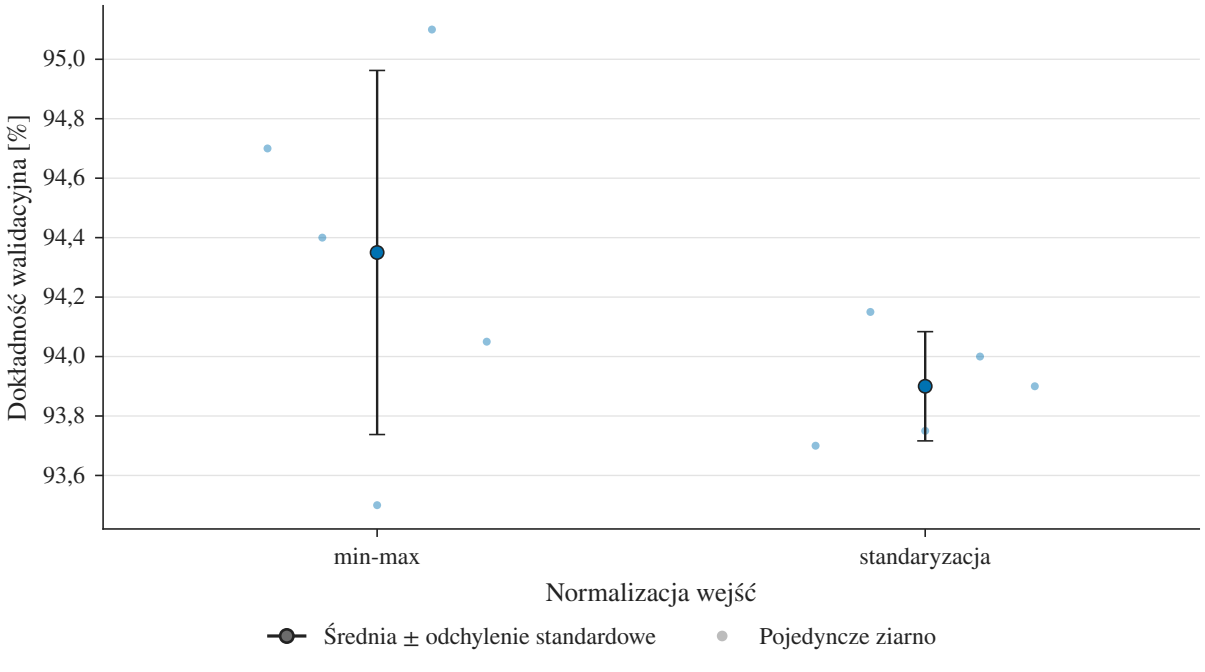
Dokładność walidacyjna [%]
95,0
94,8
94,6
94,4
94,2
94,0
93,8
93,6
min-max
standaryzacja
Normalizacja wejść
Średnia ± odchylenie standardowe
Pojedyncze ziarno