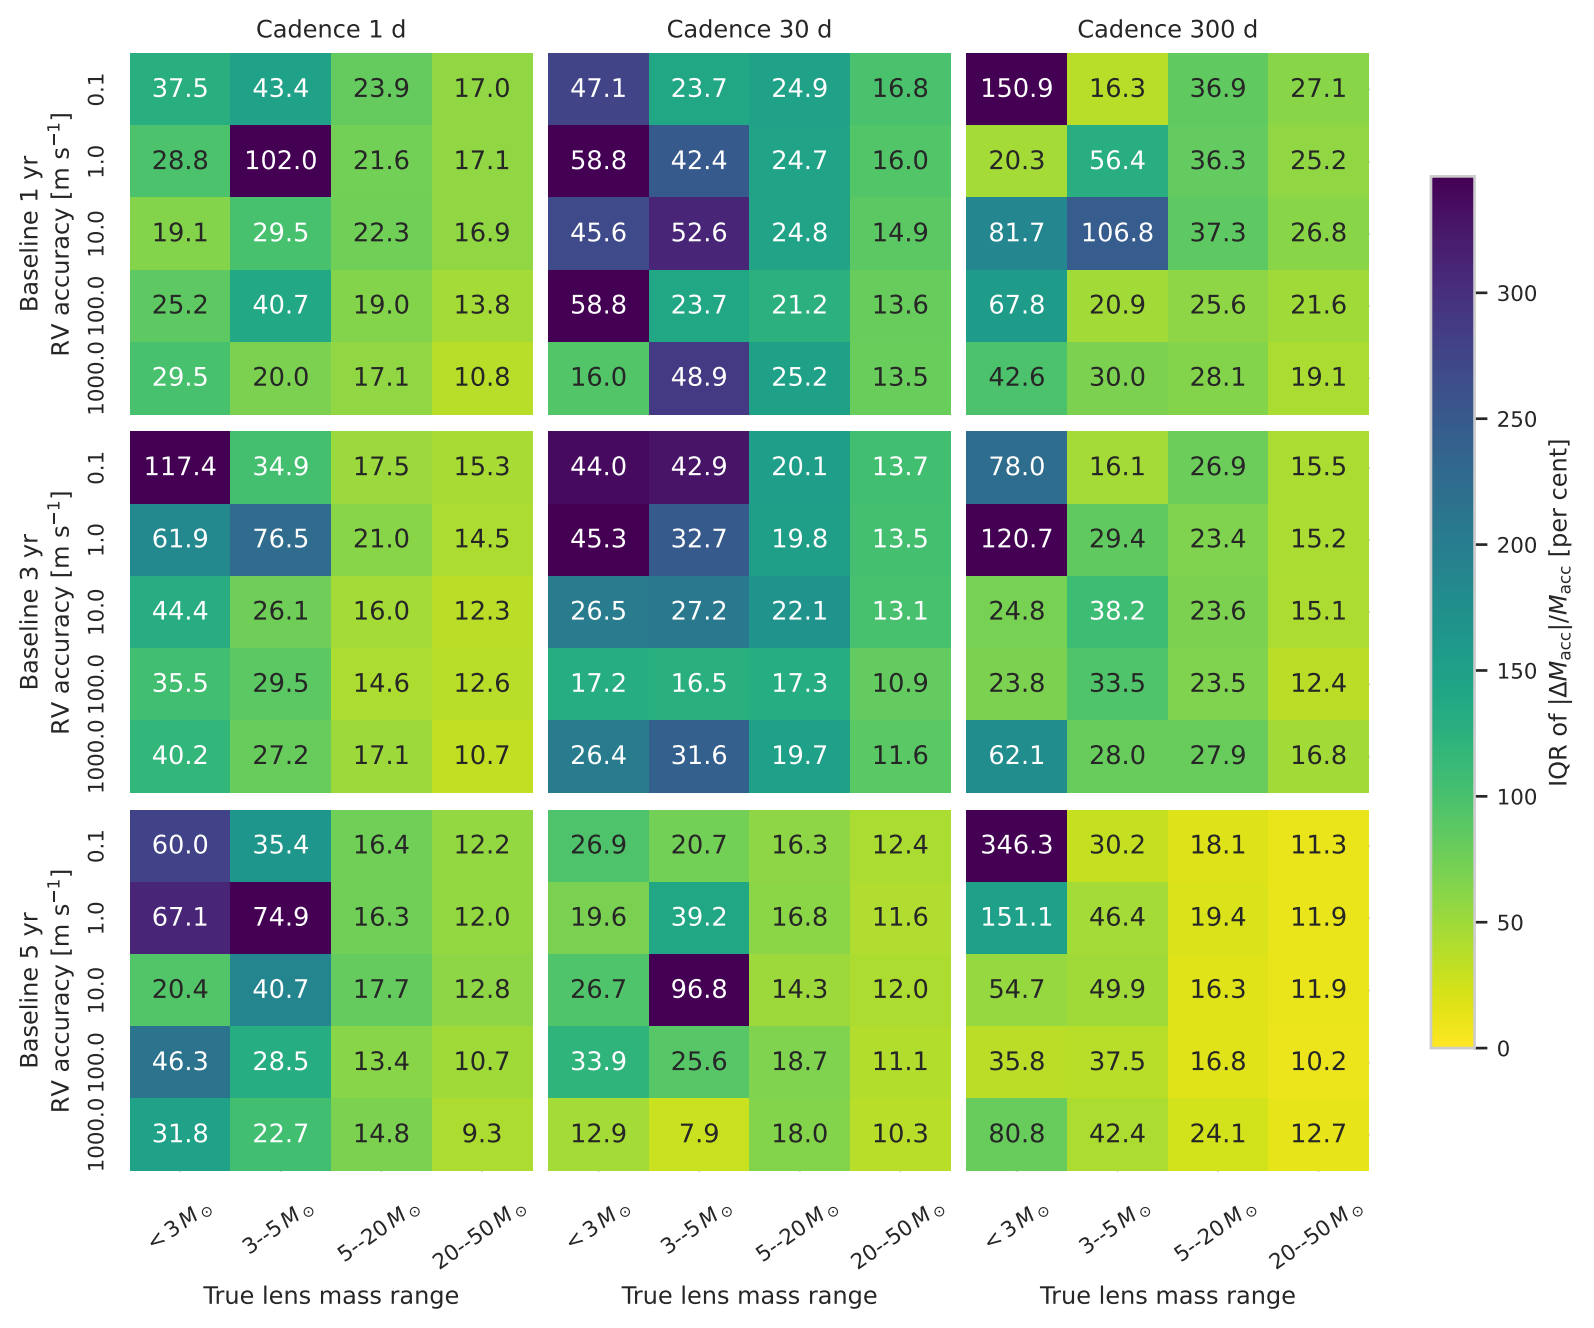
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
37.5 43.4 23.9 17.0
28.8 102.0 21.6 17.1
19.1 29.5 22.3 16.9
25.2 40.7 19.0 13.8
29.5 20.0 17.1 10.8
47.1 23.7 24.9 16.8
58.8 42.4 24.7 16.0
45.6 52.6 24.8 14.9
58.8 23.7 21.2 13.6
16.0 48.9 25.2 13.5
150.9 16.3 36.9 27.1
20.3 56.4 36.3 25.2
81.7 106.8 37.3 26.8
67.8 20.9 25.6 21.6
42.6 30.0 28.1 19.1
117.4 34.9 17.5 15.3
61.9 76.5 21.0 14.5
44.4 26.1 16.0 12.3
35.5 29.5 14.6 12.6
40.2 27.2 17.1 10.7
44.0 42.9 20.1 13.7
45.3 32.7 19.8 13.5
26.5 27.2 22.1 13.1
17.2 16.5 17.3 10.9
26.4 31.6 19.7 11.6
78.0 16.1 26.9 15.5
120.7 29.4 23.4 15.2
24.8 38.2 23.6 15.1
23.8 33.5 23.5 12.4
62.1 28.0 27.9 16.8
60.0 35.4 16.4 12.2
67.1 74.9 16.3 12.0
20.4 40.7 17.7 12.8
46.3 28.5 13.4 10.7
31.8 22.7 14.8 9.3
26.9 20.7 16.3 12.4
19.6 39.2 16.8 11.6
26.7 96.8 14.3 12.0
33.9 25.6 18.7 11.1
12.9 7.9 18.0 10.3
346.3 30.2 18.1 11.3
151.1 46.4 19.4 11.9
54.7 49.9 16.3 11.9
35.8 37.5 16.8 10.2
80.8 42.4 24.1 12.7
$< 3 M_\odot$
$3\text{–}5 M_\odot$
$5\text{–}20 M_\odot$
$20\text{–}50 M_\odot$
True lens mass range
IQR of $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
50
100
150
200
250
300