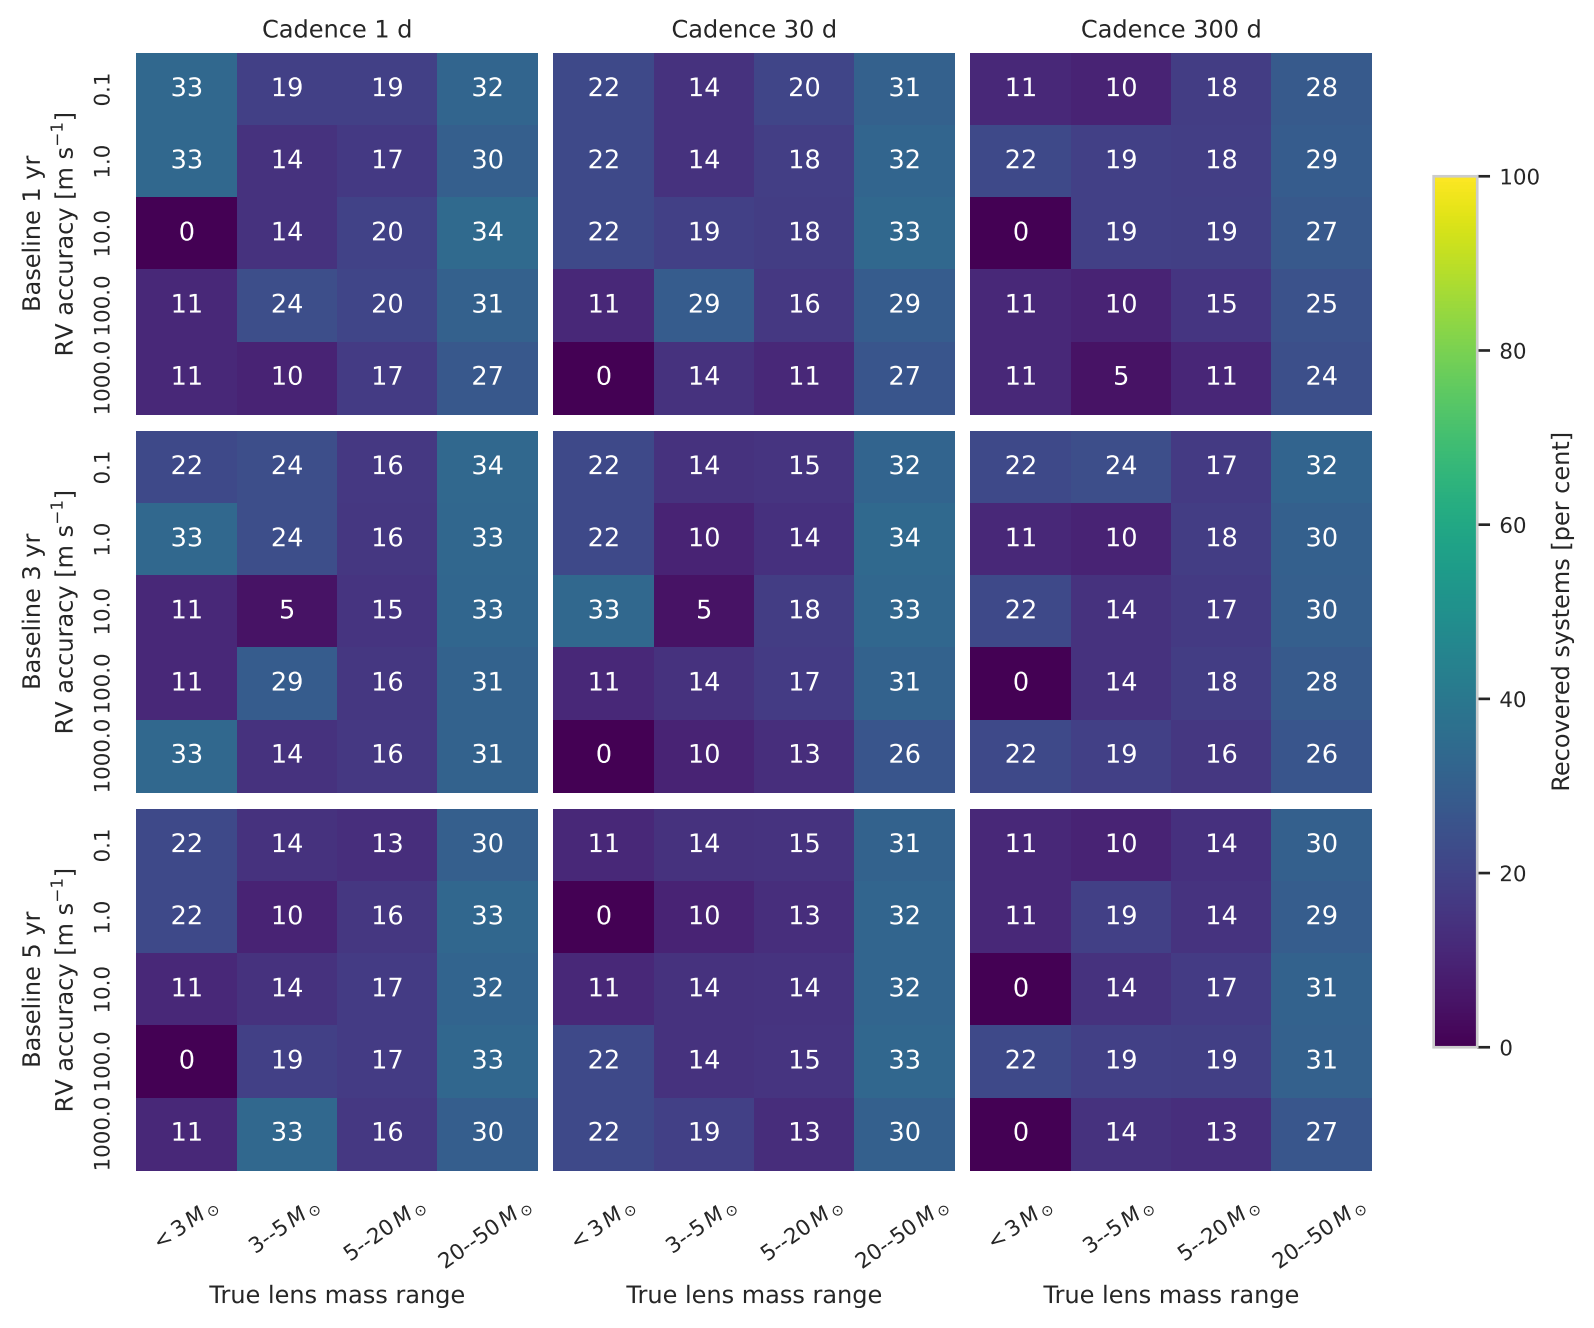
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
33 19 19 32
33 14 17 30
0 14 20 34
11 24 20 31
11 10 17 27
22 14 20 31
22 14 18 32
22 19 18 33
11 29 16 29
0 14 11 27
11 10 18 28
22 19 18 29
0 19 19 27
11 10 15 25
11 5 11 24
22 24 16 34
33 24 16 33
11 5 15 33
11 29 16 31
33 14 16 31
22 14 15 32
22 10 14 34
33 5 18 33
11 14 17 31
0 10 13 26
22 24 17 32
11 10 18 30
22 14 17 30
0 14 18 28
22 19 16 26
22 14 13 30
22 10 16 33
11 14 17 32
0 19 17 33
11 33 16 30
11 14 15 31
0 10 13 32
11 14 14 32
22 14 15 33
22 19 13 30
11 10 14 30
11 19 14 29
0 14 17 31
22 19 19 31
0 14 13 27
$<3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
0
20
40
60
80
100