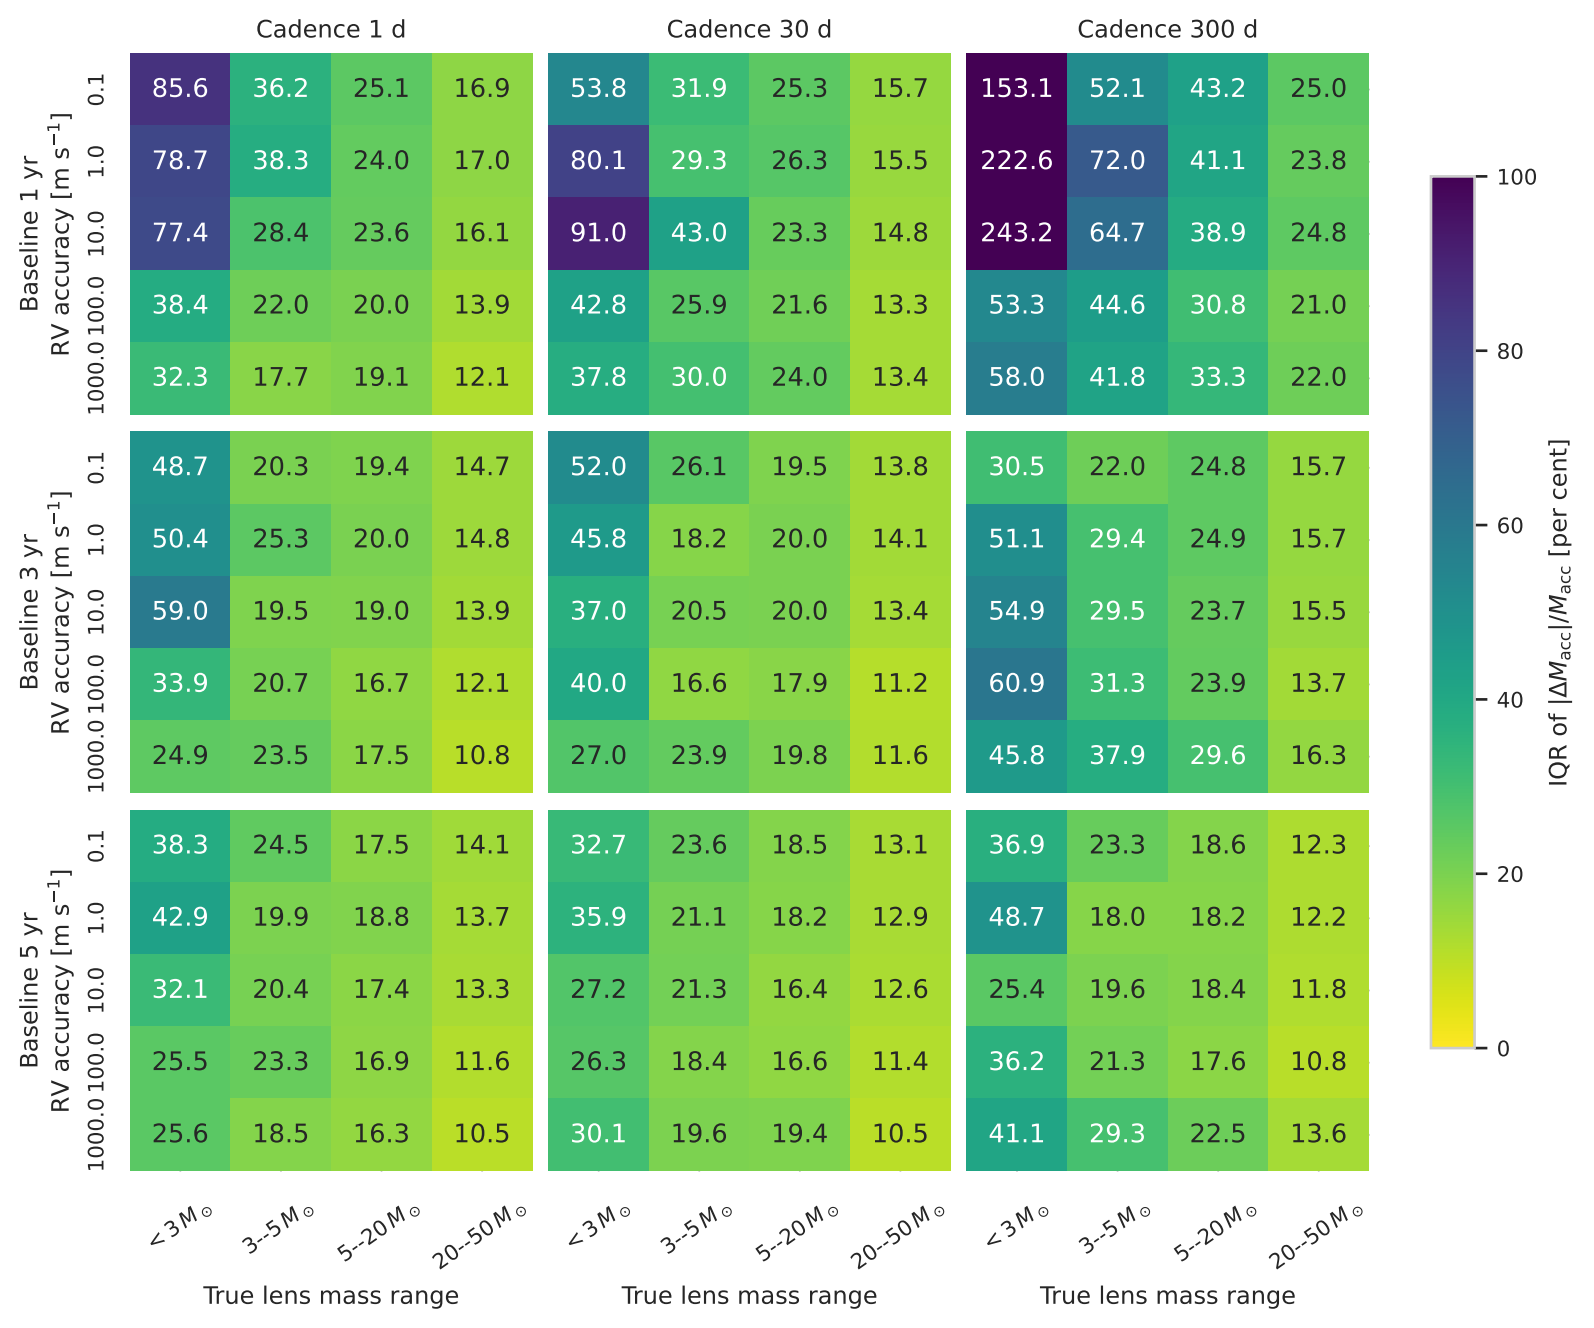
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
85.6 36.2 25.1 16.9
78.7 38.3 24.0 17.0
77.4 28.4 23.6 16.1
38.4 22.0 20.0 13.9
32.3 17.7 19.1 12.1
53.8 31.9 25.3 15.7
80.1 29.3 26.3 15.5
91.0 43.0 23.3 14.8
42.8 25.9 21.6 13.3
37.8 30.0 24.0 13.4
153.1 52.1 43.2 25.0
222.6 72.0 41.1 23.8
243.2 64.7 38.9 24.8
53.3 44.6 30.8 21.0
58.0 41.8 33.3 22.0
48.7 20.3 19.4 14.7
50.4 25.3 20.0 14.8
59.0 19.5 19.0 13.9
33.9 20.7 16.7 12.1
24.9 23.5 17.5 10.8
52.0 26.1 19.5 13.8
45.8 18.2 20.0 14.1
37.0 20.5 20.0 13.4
40.0 16.6 17.9 11.2
27.0 23.9 19.8 11.6
30.5 22.0 24.8 15.7
51.1 29.4 24.9 15.7
54.9 29.5 23.7 15.5
60.9 31.3 23.9 13.7
45.8 37.9 29.6 16.3
38.3 24.5 17.5 14.1
42.9 19.9 18.8 13.7
32.1 20.4 17.4 13.3
25.5 23.3 16.9 11.6
25.6 18.5 16.3 10.5
32.7 23.6 18.5 13.1
35.9 21.1 18.2 12.9
27.2 21.3 16.4 12.6
26.3 18.4 16.6 11.4
30.1 19.6 19.4 10.5
36.9 23.3 18.6 12.3
48.7 18.0 18.2 12.2
25.4 19.6 18.4 11.8
36.2 21.3 17.6 10.8
41.1 29.3 22.5 13.6
$< 3 M_\odot$
$3\text{–}5 M_\odot$
$5\text{–}20 M_\odot$
$20\text{–}50 M_\odot$
True lens mass range
IQR of $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100