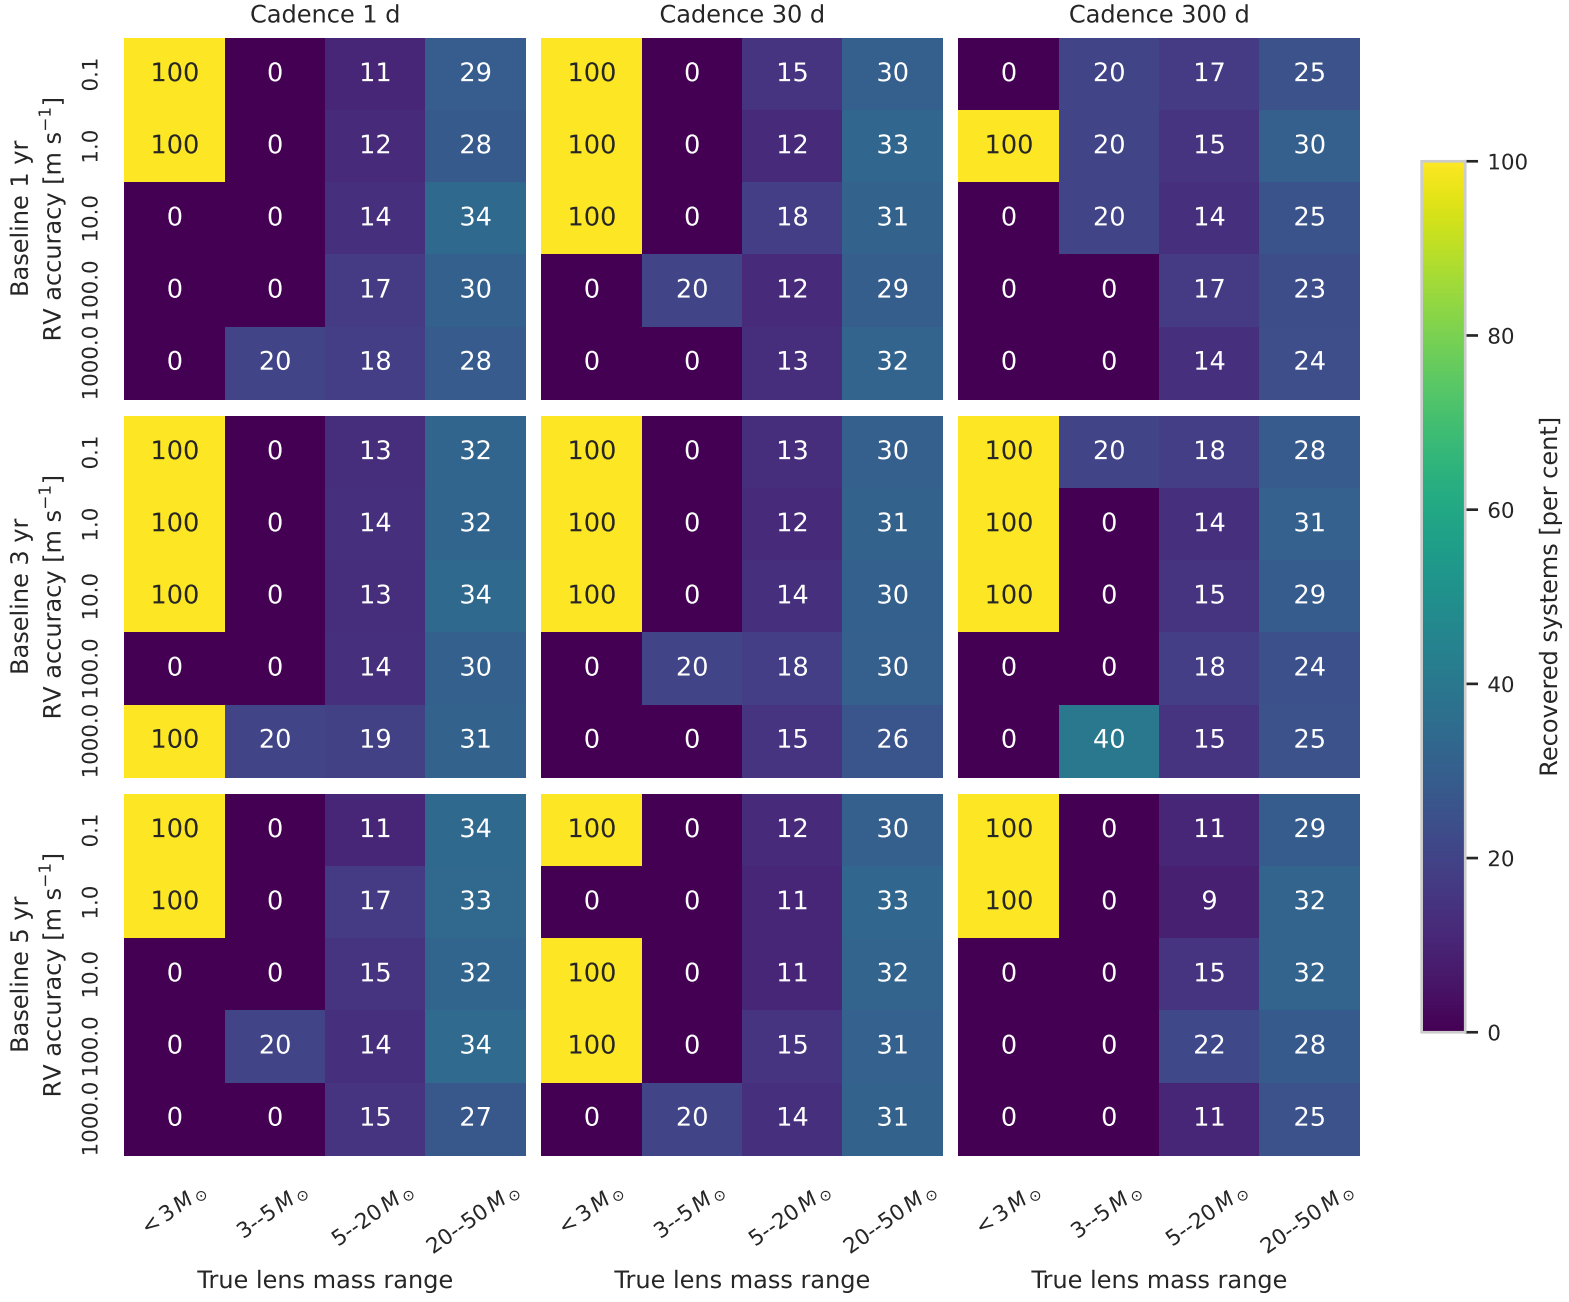
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
100 0 11 29
100 0 12 28
0 0 14 34
0 0 17 30
0 20 18 28
100 0 15 30
100 0 12 33
100 0 18 31
0 20 12 29
0 0 13 32
0 20 17 25
100 20 15 30
0 20 14 25
0 0 17 23
0 0 14 24
100 0 13 32
100 0 14 32
100 0 13 34
0 0 14 30
100 20 19 31
100 0 13 30
100 0 12 31
100 0 14 30
0 20 18 30
0 0 15 26
100 20 18 28
100 0 14 31
100 0 15 29
0 0 18 24
0 40 15 25
100 0 11 34
100 0 17 33
0 0 15 32
0 20 14 34
0 0 15 27
100 0 12 30
0 0 11 33
100 0 11 32
100 0 15 31
0 20 14 31
100 0 11 29
100 0 9 32
0 0 15 32
0 0 22 28
0 0 11 25
$<3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
Recovered systems [per cent]
100
80
60
40
20
0