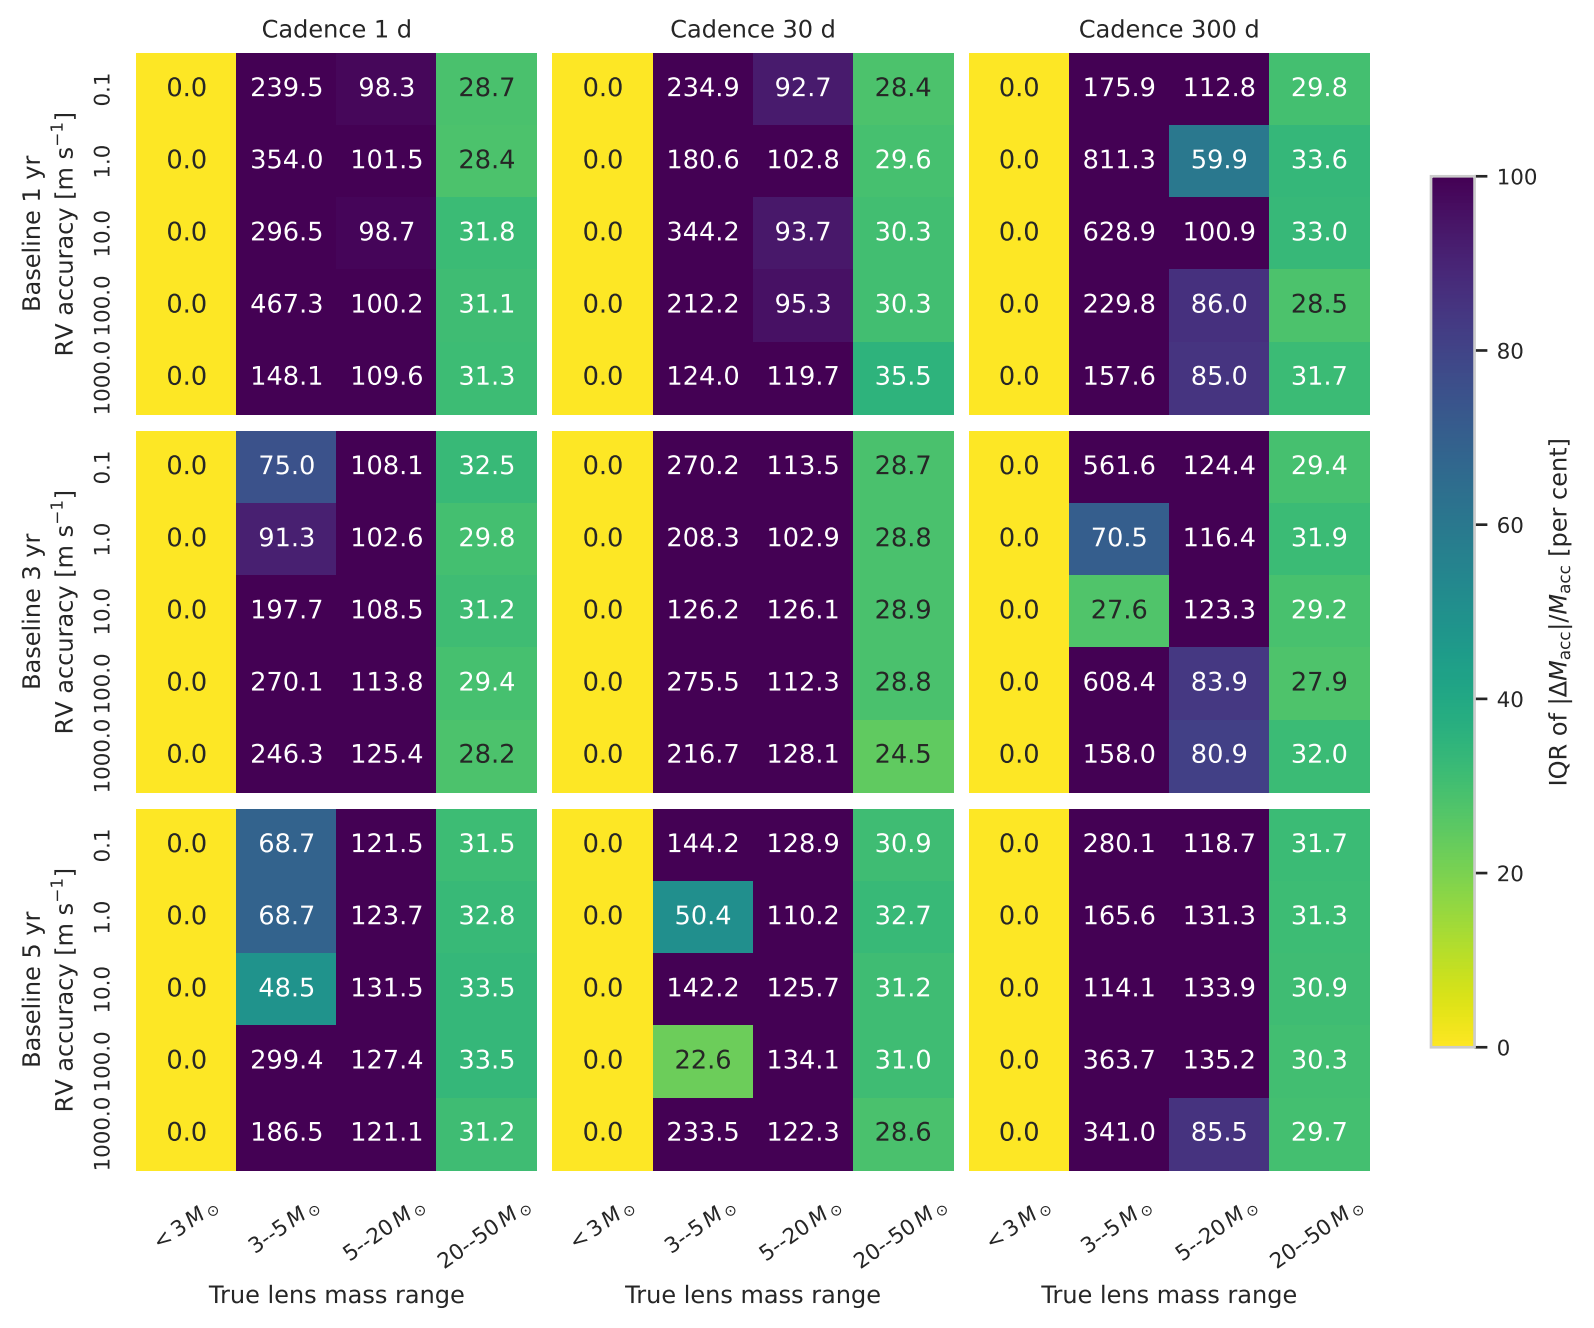
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
0.0 239.5 98.3 28.7
0.0 354.0 101.5 28.4
0.0 296.5 98.7 31.8
0.0 467.3 100.2 31.1
0.0 148.1 109.6 31.3
0.0 234.9 92.7 28.4
0.0 180.6 102.8 29.6
0.0 344.2 93.7 30.3
0.0 212.2 95.3 30.3
0.0 124.0 119.7 35.5
0.0 175.9 112.8 29.8
0.0 811.3 59.9 33.6
0.0 628.9 100.9 33.0
0.0 229.8 86.0 28.5
0.0 157.6 85.0 31.7
0.0 75.0 108.1 32.5
0.0 91.3 102.6 29.8
0.0 197.7 108.5 31.2
0.0 270.1 113.8 29.4
0.0 246.3 125.4 28.2
0.0 270.2 113.5 28.7
0.0 208.3 102.9 28.8
0.0 126.2 126.1 28.9
0.0 275.5 112.3 28.8
0.0 216.7 128.1 24.5
0.0 561.6 124.4 29.4
0.0 70.5 116.4 31.9
0.0 27.6 123.3 29.2
0.0 608.4 83.9 27.9
0.0 158.0 80.9 32.0
0.0 68.7 121.5 31.5
0.0 68.7 123.7 32.8
0.0 48.5 131.5 33.5
0.0 299.4 127.4 33.5
0.0 186.5 121.1 31.2
0.0 144.2 128.9 30.9
0.0 50.4 110.2 32.7
0.0 142.2 125.7 31.2
0.0 22.6 134.1 31.0
0.0 233.5 122.3 28.6
0.0 280.1 118.7 31.7
0.0 165.6 131.3 31.3
0.0 114.1 133.9 30.9
0.0 363.7 135.2 30.3
0.0 341.0 85.5 29.7
$<3\,M_\odot$
$3\text{--}5\,M_\odot$
$5\text{--}20\,M_\odot$
$20\text{--}50\,M_\odot$
True lens mass range
IQR of $|\Delta M_{acc}|/M_{acc}$ [per cent]
0
20
40
60
80
100