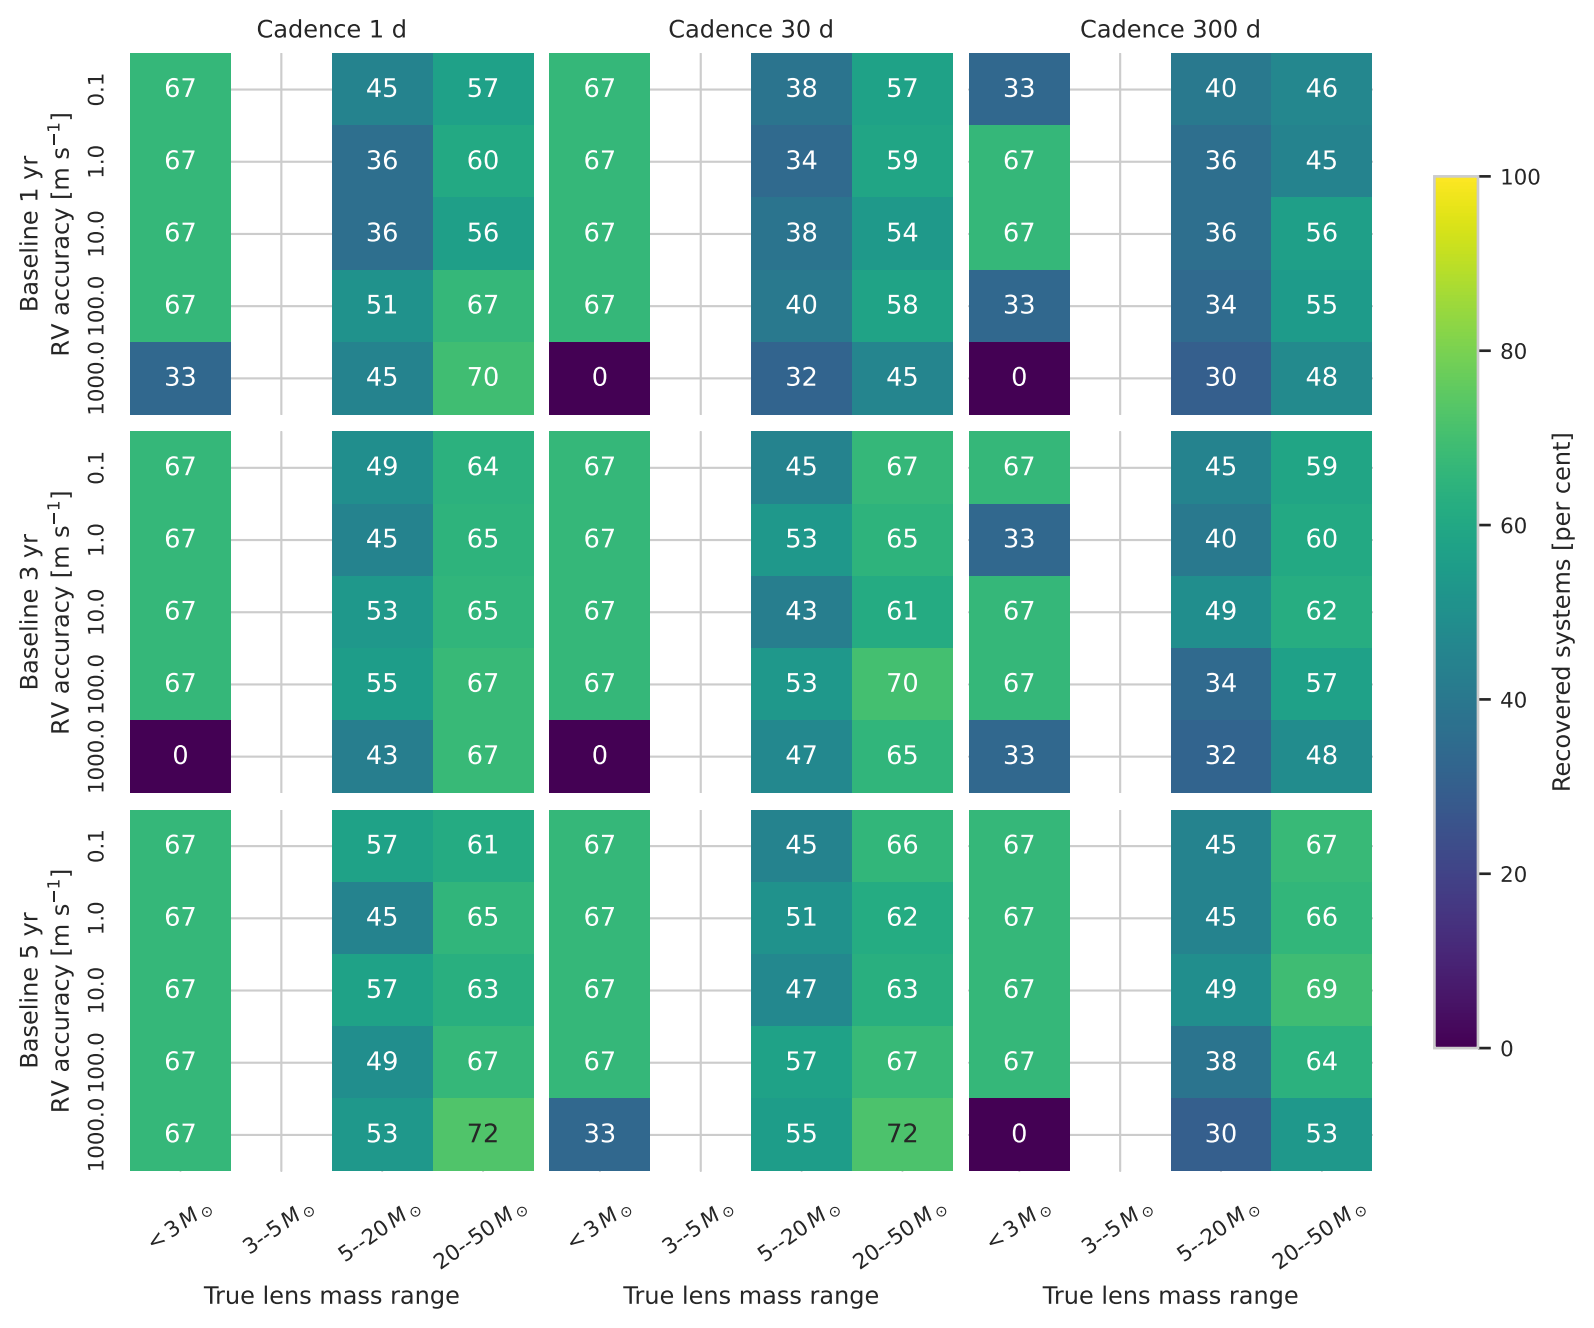
Cadence 1 d
Cadence 30 d
Cadence 300 d
Baseline 1 yr
Baseline 3 yr
Baseline 5 yr
RV accuracy [m s^{-1}]
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
67 45 57 67 38 57 33 40 46
67 36 60 67 34 59 67 36 45
67 36 56 67 38 54 67 36 56
67 51 67 67 40 58 33 34 55
33 45 70 0 32 45 0 30 48
67 49 64 67 45 67 67 45 59
67 45 65 67 53 65 33 40 60
67 53 65 67 43 61 67 49 62
67 55 67 67 53 70 67 34 57
0 43 67 0 47 65 33 32 48
67 57 61 67 45 66 67 45 67
67 45 65 67 51 62 67 45 66
67 57 63 67 47 63 67 49 69
67 49 67 67 57 67 67 38 64
67 53 72 33 55 72 0 30 53
Recovered systems [per cent]
100
80
60
40
20
0
$< 3 M_\odot$
$3\text{--}5 M_\odot$
$5\text{--}20 M_\odot$
$20\text{--}50 M_\odot$
True lens mass range