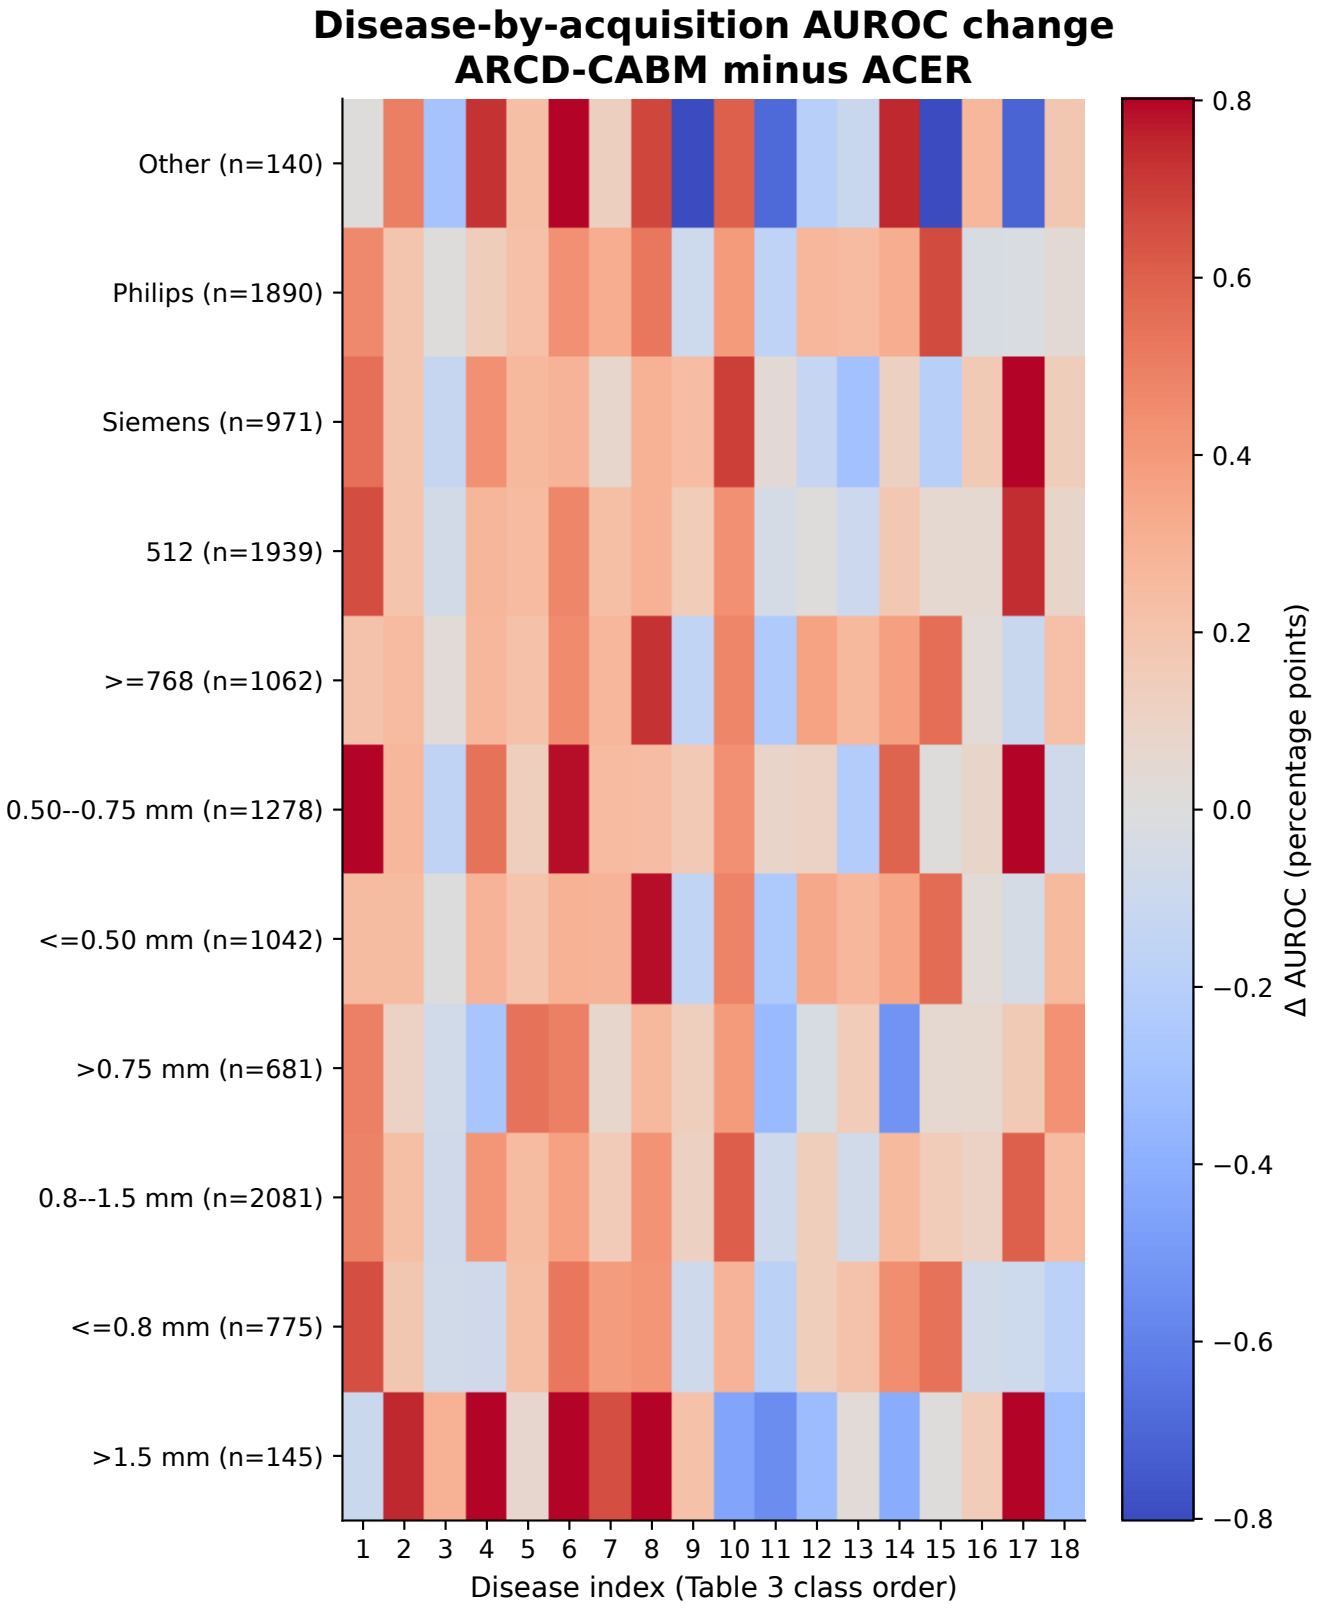
Disease-by-acquisition AUROC change
ARCD-CABM minus ACER
Other (n=140)
Philips (n=1890)
Siemens (n=971)
512 (n=1939)
>=768 (n=1062)
0.50--0.75 mm (n=1278)
<=0.50 mm (n=1042)
>0.75 mm (n=681)
0.8--1.5 mm (n=2081)
<=0.8 mm (n=775)
>1.5 mm (n=145)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Disease index (Table 3 class order)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
Δ AUROC (percentage points)