

MATRIX AURA SERIES MANUAL



Available languages

-  EN
-  ZH-HANT
-  JA
-  KO
-  VI
-  TH
-  AR
-  TR

Table of Contents

- PRODUCT INFORMATION
- INSTALLATION
- MAINTENANCE
- WARRANTY
- LAT PULLDOWN
- THÔNG TIN
- ÜRÜN BİLGİLERİ
- Other ManualsLib Projects

MATRIX

AURA SERIES

G3-S30-03



3	ENGLISH
7	繁體中文
11	日本語
15	한국어
19	TIẾNG VIỆT
23	ภาษาไทย
27	العربية
31	TÜRK



PRODUCT INFORMATION

PROPER USAGE

1. Do not exceed weight limits of the exercise device.
2. If applicable, set safety stops to appropriate height.
3. If applicable, adjust seat pads, leg pads, foot pads, range of motion adjustment, or any other type of adjustment mechanisms to a comfortable start position. Make certain that the adjusting mechanism is fully engaged to prevent unintentional movement and to avoid injury.
4. Sit on bench (if applicable) and get into appropriate position for exercise.
5. Exercise using no more weight than you can safely lift and control.
6. In a controlled manner, perform exercise.
7. Return weight to its fully-supported start position.


MAINTENANCE CHECKLIST	
ACTION	FREQUENCY
Clean Upholstery ¹	Daily
Inspect Cables ²	Daily
Clean Guide Rods	Monthly
Inspect Hardware	Monthly
Inspect Frame	Bi-Annually
Clean Machine	As Needed
Clean Grips ¹	As Needed
Lubricate Guide Rods ³	As Needed

¹ Upholstery & Grips should be cleaned with a mild soap and water or a non-ammonia based cleaner.

² Cables should be inspected for cracks or frays and immediately replaced if present. If excessive slack exists cable should be tightened without lifting the head plate.

³ Guide rods should be lubricated with Teflon based lubricant. Apply the lubricant to a cotton cloth and then apply up and down the guide rods.

TRAINING AREA

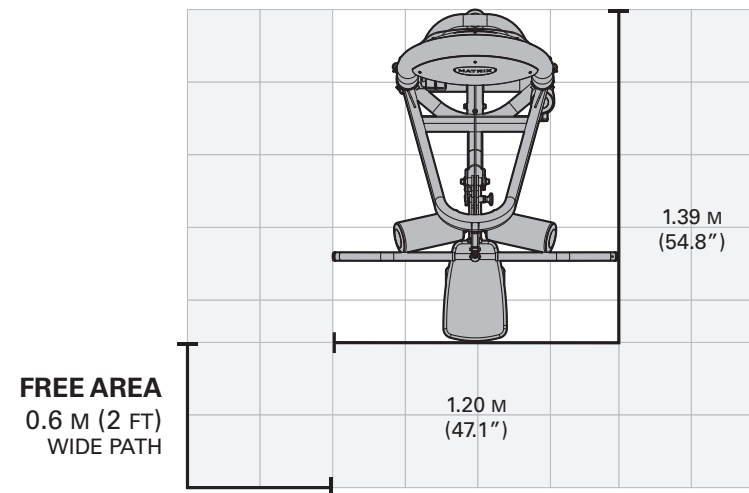

PRODUCT SPECIFICATIONS	
Max User Weight	136 kg / 300 lbs
Max Training Weight	138.6 kg / 305 lbs
Product Weight	245 kg / 540 lbs
Weight Stack	134 kg / 295 lbs
Incremental Weight (2)	2.3 kg / 5 lbs
Overall Dimensions (L x W x H)*	139.5 x 120 x 221.5 cm / 55 x 47 x 87"

* Ensure a minimum clearance width of 0.6 meters (24") for access to and passage around MATRIX strength equipment. Please note, 0.91 meters (36") is the ADA recommended clearance width for individuals in wheelchairs.

TORQUE VALUES	
M12 Bolt (Nyloc Nut & Flowdrill)	135 Nm / 100 ft-lbs
M10 Bolt (Nyloc Nut & Flowdrill)	77 Nm / 57 ft -lbs
M8 Bolts	25 Nm / 18 ft-lbs
M8 Plastic	15 Nm / 11 ft-lbs
M6 Bolts	15 Nm / 11 ft-lbs
Pad Bolts	10 Nm / 7 ft-lbs



PRODUCT INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

It is the sole responsibility of the purchaser of MATRIX products to instruct all individuals, whether they are the end user or supervising personnel on proper usage of the equipment.

It is recommended that all users of MATRIX exercise equipment be informed of the following information prior to its use.

Do not use any equipment in any way other than designed or intended by the manufacturer. It is imperative that MATRIX equipment be used properly to avoid injury.

INSTALLATION

1. **STABLE AND LEVEL SURFACE:** MATRIX exercise equipment must be installed on a stable base and properly leveled.
2. **SECURING EQUIPMENT:** Manufacturer recommends that all stationary MATRIX strength equipment be secured to the floor to stabilize equipment and eliminate rocking or tipping over. This must be performed by a licensed contractor.
3. Under no circumstances should you slide equipment across the floor due to risk of tipping. Use proper materials handling techniques and equipment recommended by OSHA.

All anchor points must be able to withstand 750 lbs. (3.3 kN) pull-out force.

MAINTENANCE

1. DO NOT use any equipment that is damaged and or has worn or broken parts. Use only replacement parts supplied by your country's local MATRIX dealer.
2. **MAINTAIN LABELS AND NAMEPLATES:** Do not remove labels for any reason. They contain important information. If unreadable or missing, contact your MATRIX dealer for a replacement.
3. **MAINTAIN ALL EQUIPMENT:** Preventative maintenance is the key to smooth operating equipment as well as keeping your liability to a minimum. Equipment needs to be inspected at regular intervals.
4. Ensure that any person(s) making adjustments or performing maintenance or repair of any kind is qualified to do so. MATRIX dealers will provide service and maintenance training at our corporate facility upon request.

ADDITIONAL NOTES

This equipment should only be used in supervised areas where access and control is specifically regulated by the owner. It is up to the owner to determine who is allowed access to this training equipment. The owner should consider a user's: degree of reliability, age, experience, etc.

This training equipment meets industry standards for stability when used for its intended purpose in accordance with the instructions provided by the manufacturer.

This equipment is for indoor use only. This training equipment is a Class S product (designed for use in a commercial environment such as a fitness facility). This training equipment is in compliance with EN 957-1 and the relevant portions of EN 957-2 and EN 957-4.

UNPACKING

Thank you for purchasing a MATRIX Fitness product. It is inspected before it is packaged. It is shipped in multiple pieces to facilitate the compact packaging of the machine. Prior to assembly, confirm all the components by matching them with the exploded diagrams. Carefully unpack the unit from this box and dispose of the packing materials in accordance with your local laws. Exercise device must be assembled by a trained assembly team or be pre-assembled prior to delivery.

CAUTION

To avoid injury to yourself and prevent damage to the frame components, be sure to have proper assistance removing the frame pieces from this box. Please be sure to install the equipment on a stable base, and properly level the machine. Ensure a minimum clearance width of 0.6 meters (24") for access to and passage around MATRIX strength equipment. Please note, 0.91 meters (36") is the ADA recommended clearance width for individuals in wheelchairs.

WARRANTY

For North America, please visit matrixfitness.com for warranty information along with warranty exclusions and limitations.



WARNING

- DEATH OR SERIOUS INJURY CAN OCCUR ON THIS EQUIPMENT. FOLLOW THESE PRECAUTIONS TO AVOID INJURY!**
1. Keep children under the age of 14 away from this strength training equipment. Teenagers must be supervised at all times while using this equipment.
 2. This equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment by a person responsible for their safety.
 3. All warnings and instructions should be read and proper instruction obtained prior to use. Use this equipment for its intended purpose ONLY.
 4. Inspect the machine before use. DO NOT use machine if it appears damaged or inoperable.
 5. Do not exceed weight capacity of this equipment.
 6. Check to see that the selector pin is completely inserted into the weight stack.
 7. NEVER use the machine with the weight stack pinned in an elevated position.
 8. NEVER use dumbbells or other means to incrementally increase the weight resistance. Only use the means provided directly from the manufacturer.
 9. Injuries to health may result from incorrect or excessive training. Cease exercise if you feel faint or dizzy. Obtain a medical exam before beginning an exercise program.
 10. Keep body, clothing, hair, and fitness accessories free and clear of all moving parts.
 11. Adjustable stops, where provided, must be used at all times.
 12. When adjusting any adjustable mechanism (stop position, seat position, pad location, range of motion limiter, pulley carriage, or any other type), make certain that the adjustable mechanism is fully engaged prior to use to prevent unintended motion.
 13. Manufacturer recommends that this equipment be secured to the floor to stabilize and eliminate rocking or tipping over. Use a licensed contractor.
 14. If equipment is NOT secured to floor: NEVER allow resistance straps, ropes or other means to be attached to this equipment, as this may result in serious injury. NEVER use this equipment for support during stretching, as this may result in serious injury.
 15. DO NOT REMOVE THIS LABEL. REPLACE IF DAMAGED OR ILLEGIBLE.




ASSEMBLY


1	Hardware	Qty
Z10	Bolt (M10x110L-15L)	14
Z17	Bolt (M10x25L)	3
Z18	Arc Washer (M10)	23
Z19	Bolt (M10x80L-35L)	2
Z20	Washer (M10)	8
F11	Nut (M10)	16
F50	Flat Washer (M10)	4

Torque Value
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb


Use shims if base is not level.

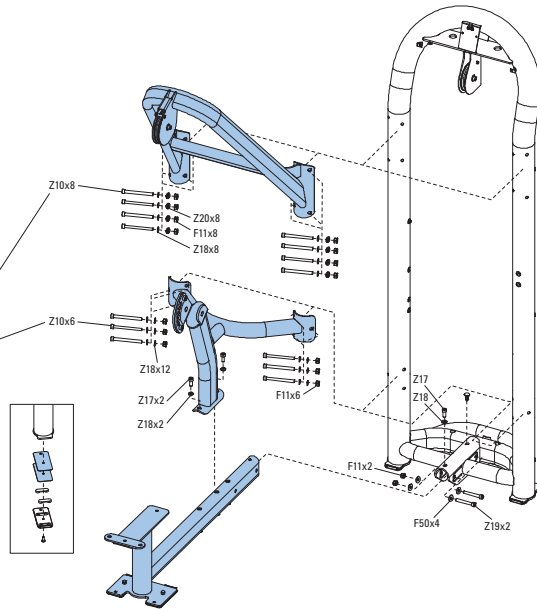


2	Hardware	Qty
L11	Spring Washer (M8)	2
L14	Screw (M5x16L)	4
L17	Bolt (M8x20L)	2
L42	Screw (M6x15L)	2
F48	Flat Washer (M5)	4
K12	Snap Ring	4
Z13	Flat Washer (M8)	2

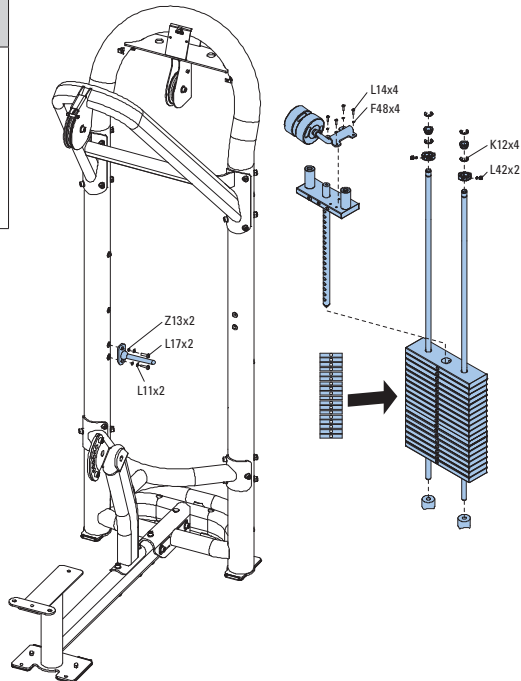

3	Hardware	Qty
Z07	Bolt (M12x25L)	2
Z08	Flat Washer (M12)	2
Z09	Spring Washer (M12)	2

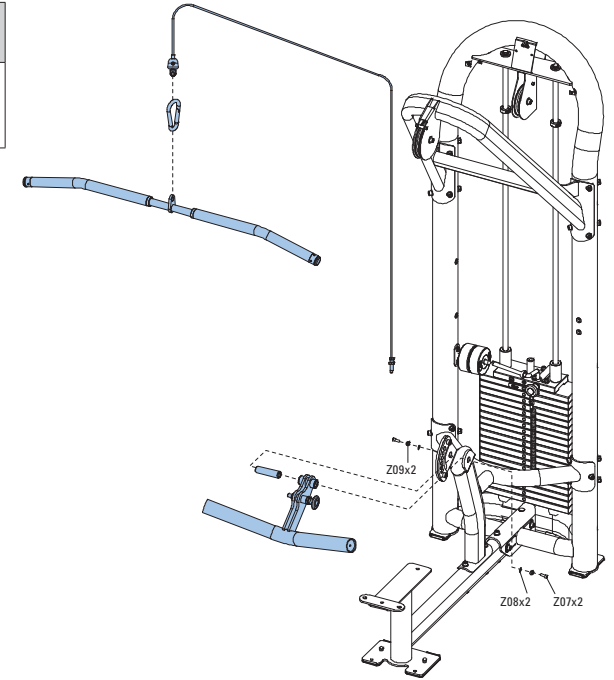


4	Hardware	Qty
B26	Bolt (M10x25L)	3
Z13	Flat Washer (M8)	2
Z14	Bolt (M8x20L)	2

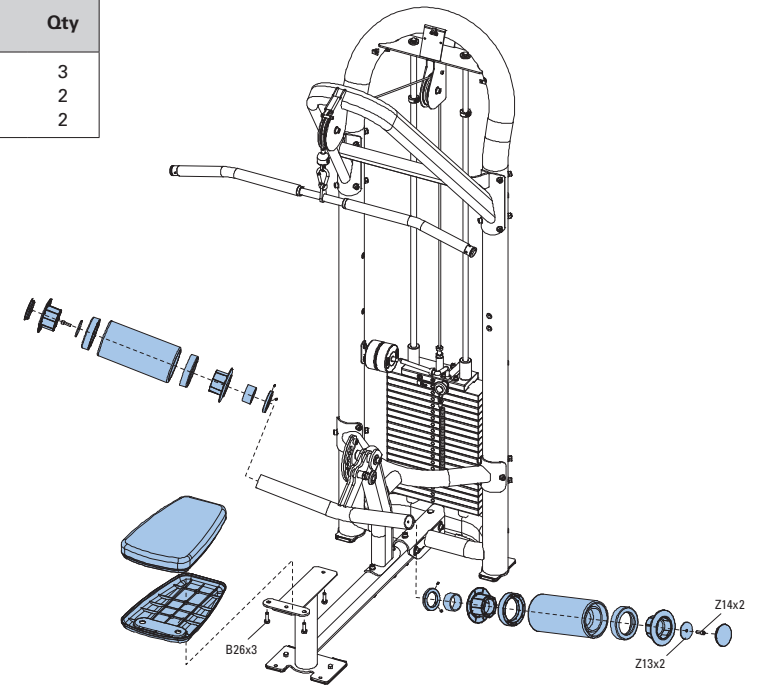



ASSEMBLY

5	Hardware	Qty
B27	Bolt (M8x30L)	2
B45	Screw (M4x12L)	6
B51	Flat Washer (M4)	6
L17	Bolt (M8x20L)	2

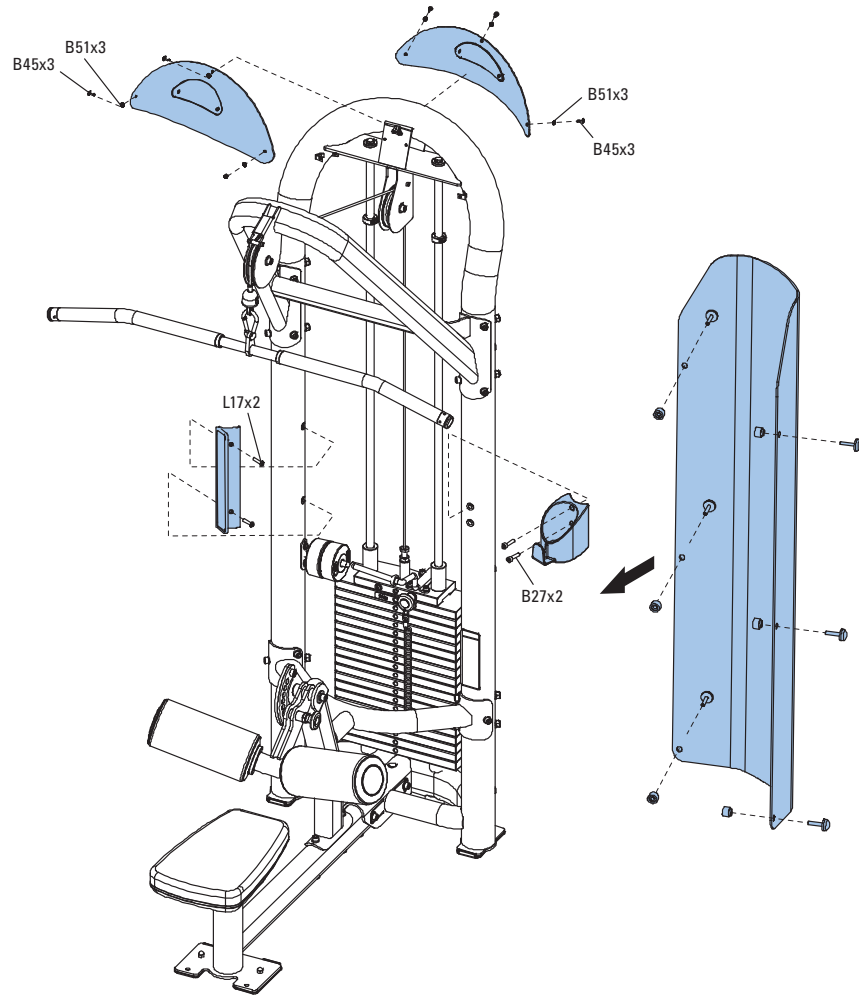

ASSEMBLY COMPLETE

PLACARD





信息

正確的使用方式

1. 不可超出訓練器材的重量限制。
2. 若有安全止動器，請將安全止動器調整至適當的高度。
3. 儘可能將座墊、腿墊、腳墊、活動範圍調整裝置或任何其他類型的調整裝置，調整到令您感到舒適的開始位置。確認調整裝置完全鎖緊，避免突然移動或造成傷害。
4. 若有訓練椅，請坐在訓練椅上並調整至適當的訓練位置。
5. 訓練時的重量不可超過您可安全舉重及控制的範圍。
6. 請在適度的控制範圍內進行訓練。
7. 將重量片放回支撐重量片的開始位置。

保養檢查清單


措施	頻率
清潔墊子 ¹	每天一次
檢查鋼索 ²	每天一次
清潔導桿	每月一次
檢查五金	每月一次
檢查機架	每半年一次
清潔器材	隨時視需要
清潔握把 ¹	隨時視需要
潤滑導桿 ³	隨時視需要

¹ 請以溫和的肥皂和清水或不含氨成份的清潔劑清潔墊子與握把。

² 檢查鋼索是否有破裂或磨損情形，若有應立即更換。若鋼索過鬆，應在不抬起頂板的情況下拉緊鋼索。

³ 請以鐵弗龍潤滑劑潤滑導桿。以棉布沾取潤滑劑後，再上下擦拭導桿。

訓練區域

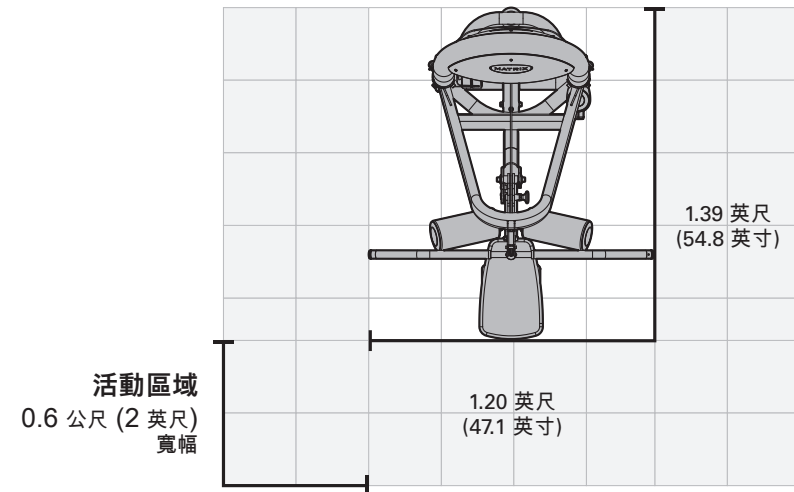

產品規格

使用者體重承載上限	136 kg / 300 lbs
訓練重量承載上限	138.6 kg / 305 lbs
產品重量	245 kg / 540 lbs
重量片	134 kg / 295 lbs
輔助選擇塊	2.3 kg / 5 lbs
總尺寸 (長 x 寬 x 高)*	139.5 x 120 x 221.5 cm / 55 x 47 x 87 英寸

* MATRIX 重量器材周圍務必保留至少 0.6 公尺 (24 英寸) 的寬度，以利使用及通行。請注意，美國身心障礙法案 (ADA) 建議的輪椅通行寬度是 0.91 公尺 (36 英寸)。

扭力值

M12 螺栓 (Nyloc 螺帽和 Flowdrill)	135 Nm / 100 ft-lbs
M10 螺栓 (Nyloc 螺帽和 Flowdrill)	77 Nm / 57 ft-lbs
M8 螺栓	25 Nm / 18 ft-lbs
M8 塑膠	15 Nm / 11 ft-lbs
M6 螺栓	15 Nm / 11 ft-lbs
靠墊螺栓	10 Nm / 7 ft-lbs



信息

重要安全資訊

MATRIX 產品買主應負責確保已充分教導最終使用者或監督人員器材的正確使用方式。

建議所有 MATRIX 健身器材使用者在使用前瞭解下列資訊。

所有器材的使用方式需以製造商的設計原理或原始用途為主，不可擅自更改。請務必遵行正確的 MATRIX 器材使用方式，以避免造成傷害。

安裝

1. 穩固的平面：MATRIX 健身器材必須安裝於穩固且平坦的表面上。
2. 固定器材：製造商建議將所有固定式 MATRIX 重量設備固定於地面，以提高穩定性並避免晃動或傾覆。必須由合格承包商進行安裝。

所有固定點的鎖固扭力須達 750 磅 (3.3 kN)。

保養

1. 任何器材一旦損壞或零件磨損/破損，一律不得繼續使用。請使用當地 MATRIX 經銷商所販售的替換零件。
2. 保養標籤和貼標：不可因任何原因撕除標籤。標籤內含重要資訊。如標籤模糊不清或不見，請聯絡 MATRIX 經銷商並要求重新張貼。
3. 保養所有器材：預防性保養是保持器材功能正常及善盡安全責任的關鍵。請定期檢查器材。
4. 確認負責調整或保養/維修器材的人員均為合格人員。MATRIX 經銷商可應要求，在我們的公司設施內，提供維修及保養訓練。

其他注意事項

本器材必須在其所有人可實施具體管控的受監督區域內使用。器材所有人有權決定哪些人可使用本訓練器材。器材所有人應考量使用者的：可靠程度、年齡、經驗等等。

如遵行製造商提供之說明並按照其設計用途使用，本訓練器材符合業界規範的穩定性標準。

本器材僅供室內使用。本訓練器材屬 S 類產品 (專用於健身房等的商務環境)。本訓練器材符合 EN ISO 20957-1 及 EN 957-2 的規定。

開箱

感謝您購買 MATRIX Fitness 產品。我們在包裝前已經檢查過產品。為減少器材包裝體積，本產品拆分多件運送。進行組裝前，請先比對各零組件與圖表內容是否相符。小心地將器材從本包裝箱取出後，請依照當地法規妥善棄置包裝材料。運動裝置必須由經過訓練的組裝團隊進行組裝，或者在送貨前已經預先組裝。

注意

為避免受傷及防範破壞器材零組件，請務必請他人協助將器材零組件從包裝箱內取出。請務必將器材安裝在穩固的平面上，並使機器保持水平。MATRIX 重量器材周圍務必保留至少 0.6 公尺 (24 英寸) 的寬度，以利使用及通行。請注意，美國身心障礙法案 (ADA) 建議的輪椅通行寬度是 0.91 公尺 (36 英寸)。

保固

如果您在北美，請至 matrixfitness.com 查詢保固資訊，以及保固的例外和限制條款。

警告

本器材使用不當可能導致死亡或嚴重人身傷害。請遵行以下注意事項，避免受傷！

1. 未滿 14 歲的兒童請勿接近本重量訓練器材。青少年須在成人全程監督下使用本器材。
2. 本器材不適用於體能、知覺或精神機能不佳或缺經驗及知識的人士；如欲使用，必須在他人監督下進行，且須由可負責其人身安全者指導器材用途及使用方式。
3. 使用前請詳閱所有警告及說明，並接受正確的指導。請遵循本器材的用途。
4. 使用前請先檢查器材。切勿使用已損壞或無法操作的器材。
5. 使用本器材時，不可超過承重限制。
6. 檢查確認選擇插鞘完全插入重量片架內。
7. 若重量片架固定於高處，切勿使用本機器。
8. 切勿利用啞鈴或其他方式增加重量片阻力。只能按照製造商提供的方式進行。
9. 訓練方式不正確或訓練過度皆有可能損礙健康。若感覺昏厥或暈眩，請停止訓練。開始進行訓練課程之前，請接受體檢。
10. 身體、衣物、頭髮及健身配件皆須與所有活動零件保持距離。
11. 若有可調節限制器，務必全程使用。
12. 當您調整任何可調節裝置 (限制器位置、座椅位置、踏墊位置、移動範圍限制裝置、滑輪滑動架或任何其他類型的裝置)，請務必先確認可調節裝置完全鎖上再使用，避免裝置突然移動。
13. 製造商建議將本器材固定於地面，以提高穩定性並避免晃動或傾覆。請選擇合格承包商。
14. 若未將本器材固定於地面：一律禁止將抗力帶、抗力繩或其他類似配件綁附於本器材，否則可能會導致嚴重人身傷害。請勿以本器材做為伸展運動的支撐點，否則可能會導致嚴重人身傷害。
15. 請勿撕除此標籤。若標籤破損或模糊不清，請更換新標籤。




組裝


1	五金	數量
Z10	螺絲 (M10x110L-15L)	14
Z17	螺絲 (M10x25L)	3
Z18	弧形墊圈 (M10)	23
Z19	螺絲 (M10x80L-35L)	2
Z20	墊圈 (M10)	8
F11	螺帽 (M10)	16
F50	平墊圈 (M10)	4

扭力值
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb


根据需要使用垫片

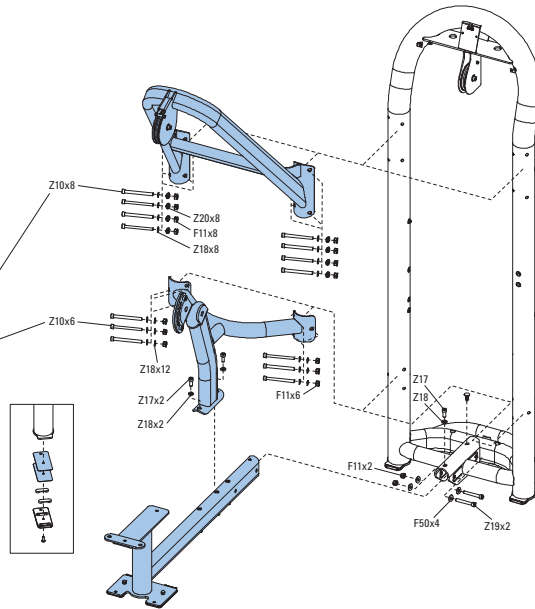


3	五金	數量
Z07	螺絲 (M12x25L)	2
Z08	平墊圈 (M12)	2
Z09	彈簧墊圈 (M12)	2

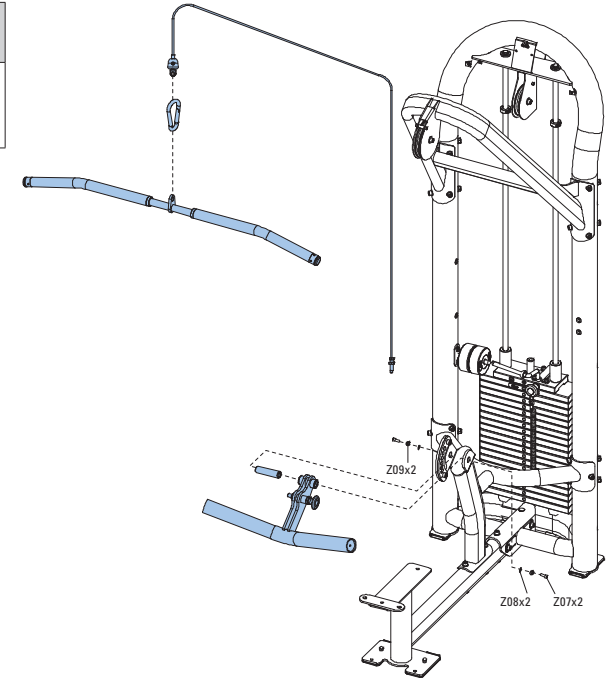

2	五金	數量
L11	彈簧墊圈 (M8)	2
L14	螺絲 (M5x16L)	4
L17	螺絲 (M8x20L)	2
L42	螺絲 (M6x15L)	2
F48	平墊圈 (M5)	4
K12	卡環	4
Z13	平墊圈 (M8)	2

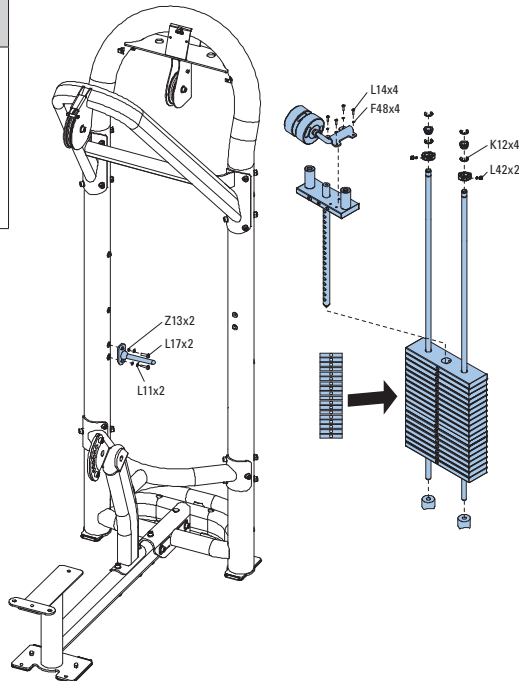


4	五金	數量
B26	螺絲 (M10x25L)	3
Z13	平墊圈 (M8)	2
Z14	螺絲 (M8x20L)	2

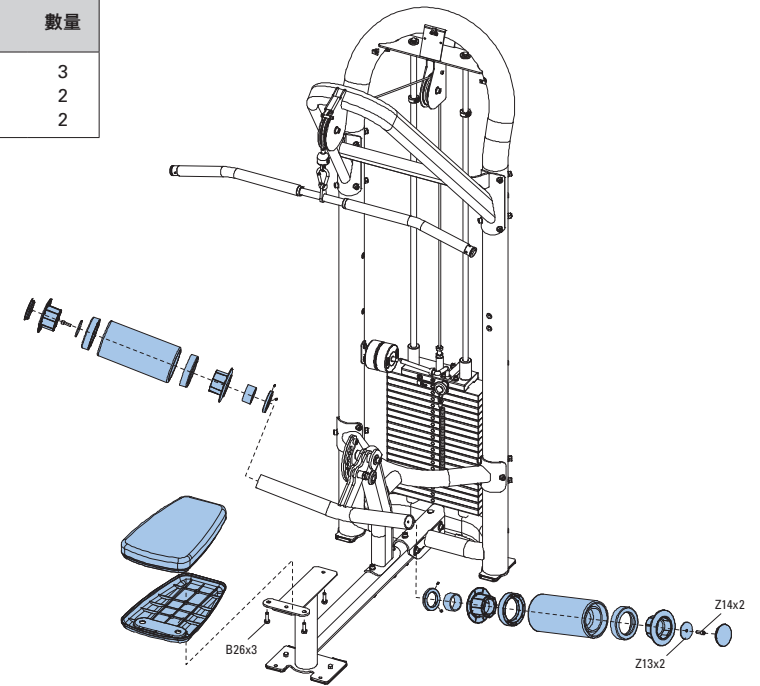




組裝

5	五金	數量
B27	螺絲 (M8x30L)	2
B45	螺絲 (M4x12L)	6
B51	平墊圈 (M4)	6
L17	螺絲 (M8x20L)	2

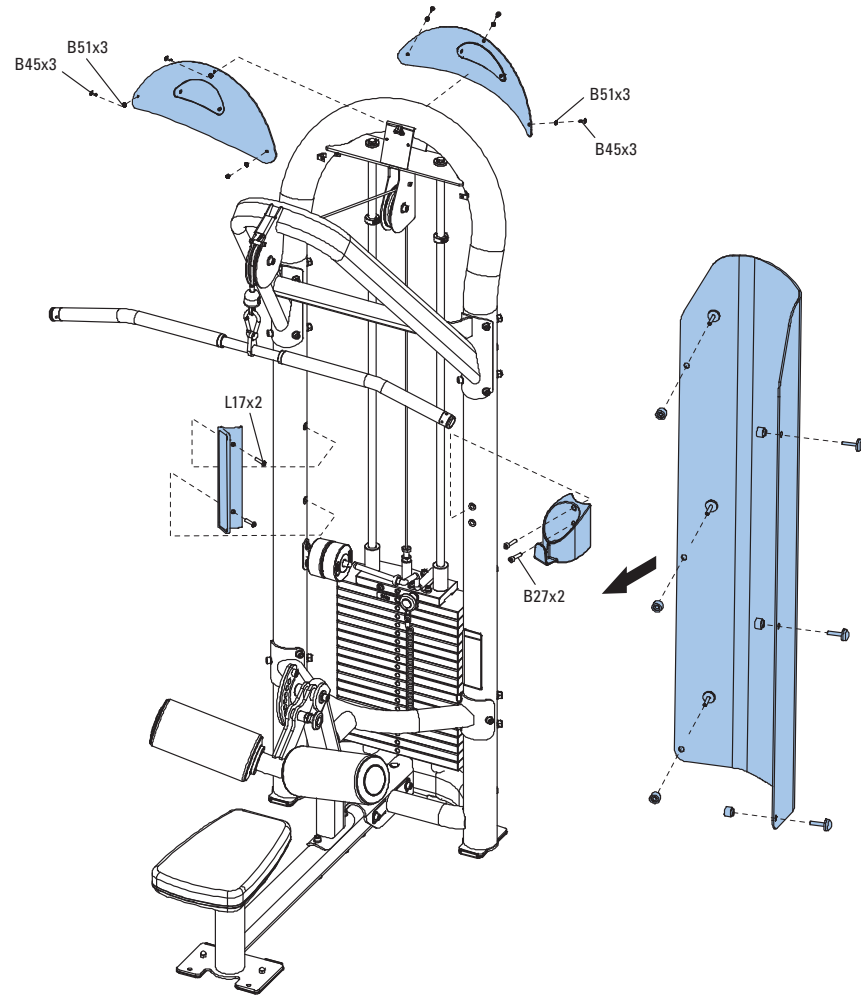

組裝完成

標語牌

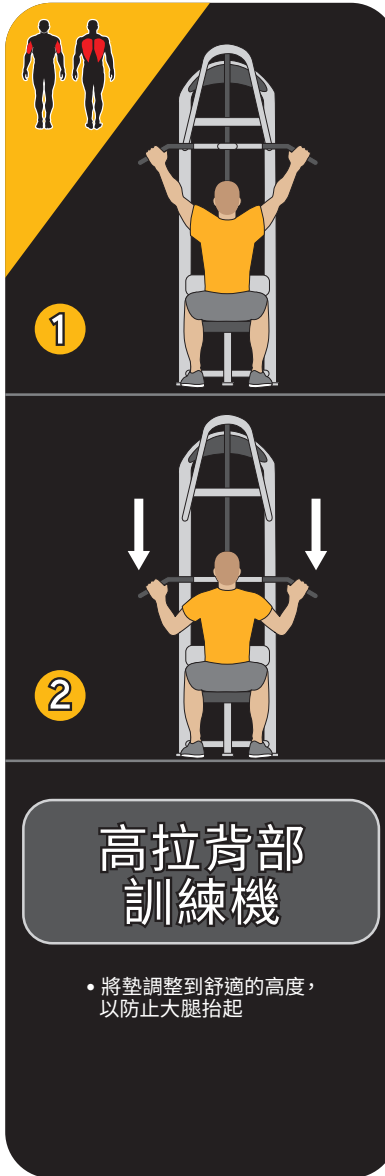



情報

正しい使用法

1. エクササイズ器具の使用重量制限を超えないようにしてください。
2. 必要に応じて、安全ストッパーを適切な高さに取り付けます。
3. シートパッド、レッグパッド、フットパッド、可動域の調整など必要に応じて装置を調節し、無理のない位置でエクササイズを開始できるようにします。器具が急に動いたりけがをしたりすることがないよう、調節装置が完全にかみ合っていることを確認してください。
4. ベンチに座り（該当する場合）、エクササイズに適した姿勢をとります。
5. 安全に持ち上げて取り扱える範囲のウェイトを使用します。
6. 器具を慎重に操作しながら、エクササイズを行います。
7. ウェイトを所定の開始位置に戻します。

メンテナンスチェックリスト


項目	頻度
シート部クリーニング ¹	毎日
ケーブル点検 ²	毎日
ガイドロッドクリーニング	毎月
金属部点検	毎月
フレーム点検	半年に1回
マシンクリーニング	随時
グリップクリーニング ¹	随時
ガイドロッド注油 ³	随時

¹ シート部とグリップは低刺激性の石けんと水、または非アンモニア性クリーナーで拭いてください。

² ケーブルに亀裂や擦り切れがないかを点検し、見つかった場合にはすぐに交換してください。大きく緩んでいる場合は、ヘッドプレートを持ち上げずにケーブルを締めてください。

³ ガイドロッドの注油には、テフロンベースの潤滑剤を使用してください。潤滑剤を含ませた綿布を上下に動かしてガイドロッドに塗布します。

のトレーニングエリア

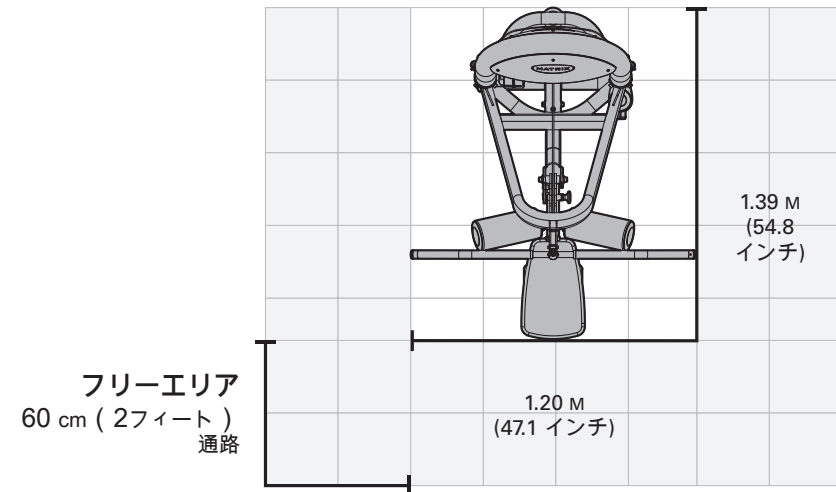

製品仕様

最大使用者重量	136 kg (300 lb)
最大使用重量	138.6 kg (305 lb)
本体重量	245 kg (540 lb)
ウェイトスタック	134 kg (295 lb)
追加ウェイト	2.3 kg (5 lb)
本体寸法 (L x W x H) *	139.5 x 120 x 221.5 cm (55 x 47 x 87 in.)

* Matrixストレングスマシンを使用する際は、安全のため、周囲に60 cm (24 in) 以上の空きスペースを必ず設けてください。ADA (障害を持つアメリカ人法) では、車いす利用者のため、左右にそれぞれ91 cm (36 in) 以上の空きスペースを設けるよう推奨しています。

トルク値

M12ボルト (ナイロックナット、フロードリル)	135 Nm (100 ft-lb)
M10ボルト (ナイロックナット、フロードリル)	77 Nm (57 ft-lb)
M8ボルト	25 Nm (18 ft-lb)
M8プラスチック	15 Nm (11 ft-lb)
M6ボルト	15 Nm (11 ft-lb)
パッドボルト	10 Nm (7 ft-lb)



情報

安全に関する重要事項

Matrix製品ご購入者各位の責任において、エンドユーザーであるかインストラクターであるかを問わず、使用者全員に器具の適切な使用方法を指導してください。

Matrixのエクササイズ器具使用者には、事前に以下の内容をお知らせください。

器具はメーカーによる設計または目的の範囲内で使用してください。本器具を使用する際は必ず適切な使用方法を守り、けがの防止を徹底してください。

設置

- 安定した水平面：Matrixの運動器具は、安定した平面に水平に設置してください。
- 器具の固定：器具の安定と揺れ・転倒防止のため、Matrixの据え置き型筋力トレーニング器具はすべて床に固定してください。設置は正規の請負業者が行う必要があります。

固定金具はすべて3.3 kN (750ポンド) の引き抜き強度に耐えられる必要があります。

メンテナンス

- 機器が故障している場合や、部品が摩耗・破損している場合は決して使用しないでください。交換部品は必ずお住まいの国・地域のMatrix販売代理店からお求めください。
- ラベルとネームプレートの保持：ラベルは決して剥がさないでください。重要事項が記載されています。紛失したり、読みにくくなったりした場合は、Matrix販売代理店に連絡して交換を依頼してください。
- 機器全体のメンテナンス：メンテナンスは、機器を円滑に作動させて責任範囲を最小限に抑えるために重要です。機器は定期的に点検する必要があります。
- 調整、メンテナンス、修理は必ず当該作業を行う資格のある担当者が実施してください。ご希望に応じて、Matrixの販売代理店で点検とメンテナンス研修を実施します。

追加事項

本器具はインストラクターの目の届く範囲内に設置し、施設運営者が器具の使用と管理について明確に定めた場所で使用する必要があります。本器具の使用を許可する決定は、施設運営者の判断に委ねられます。施設運営者が判断材料とするのは利用者の信頼度、年齢、経験等です。

本トレーニング器具は、取扱説明書に記載された目的で使用する際の、業界の安定性基準を満たしています。

本機は屋内でのみ使用可能です。本機はクラスSに分類される製品 (フィットネス施設のような商業環境で使用するために考案された製品) です。本機はEN ISO 20957-1とEN 957-2に準拠しています。

梱包を解く

Matrix Fitness製品をご購入いただき、ありがとうございます。本製品は梱包の前に検査済みです。複数のパーツに分けて出荷することで、マシンの梱包サイズを小さくしています。組み立て前に、すべてのパーツを分解図と照らし合わせてご確認ください。本体を箱から慎重に取り出し、梱包材はお住まいの地域の規則に従って処分してください。エクササイズ器具は、訓練を受けた組立チームが組み立てるか、納入前にあらかじめ組み立てておく必要があります。

注意事項

けがやフレームの破損を避けるため、パーツを箱から取り出す際は必ず他の人に補助してもらってください。器具は必ず安定した平面に設置し、水平に置かれていることを確認してください。Matrixストレンクス器具を使用する際は、安全のため最低60 cm (24インチ) のスペースを必ず周囲に設けてください。ADA (障害を持つアメリカ人法) では、車いす利用者のために91 cm (36インチ) の幅を空けておくことを推奨しています。

保証

北米にお住まいの方は、保証に関する免責と限度の詳細について matrixfitness.com でご覧いただけます。

警告

- 本器具の使用により、死または重傷を負うおそれがあります。けがを避けるため、次の注意を必ず守ってください。
- 14歳未満のお子様には、本器具を使用させないでください。また、20歳未満の場合は終始監督下で使用してください。
 - 本器具は身体・感覚・精神の状態が不安定な方、経験・知識のない人の使用を意図したものではありません。該当する人の使用には、その安全に責任のある人が監督または指導する必要があります。
 - ご使用前に必ずすべての注意書きと使用説明書を読み、適切な使用方法を理解してください。また、本来の目的以外では使用しないでください。
 - 使用前に機器を検査してください。破損や故障がある場合には使用しないでください。
 - 本器具の最大積載重量を超えて使用しないでください。
 - セレクトタービンがウェイトスタックに完全に差し込まれていることを確認してください。
 - ウェイトスタックが浮いたままピンで固定されている器具は絶対に使用しないでください。
 - ウェイトを増加させる目的でダンベル等を使用しないでください。製造者から直接提供された方法のみ使用してください。
 - トレーニング方法を誤ったり、過度のトレーニングを行ったりすると、健康を損なうおそれがあります。使用中にめまいやふらつきを感じた場合は、すぐにトレーニングを中止してください。トレーニングプログラムを開始する前に健康診断をしてください。
 - 可動部に身体、服、髪、フィットネス用アクセサリーが触れないようにご注意ください。
 - アジャスタブルストッパーがある場合は、必ず使用してください。
 - 調整装置 (停止位置、シート位置、パッド位置、モーションリミッターの範囲、プリーキヤリッジ、その他) を調整する際は、急に動かないよう、完全にロックされていることを確認してください。
 - 本器具を安定させ、ぐらつきや転倒が生じないように、床に固定してください。契約業者に依頼してください。
 - 床に固定されていない場合は、重傷を負うおそれがありますので、レジスタンスストラップ、ロープ、その他を本器具に装着しないでください。重傷を負うおそれがありますので、ストレッチ時に本器具を支えと使用しないでください。
 - このラベルは剥がさないでください。破れた読み取れなくなったりした場合は新しく貼り直してください。


組立

1 ハードウェア 数量

Z10	ボルト (M10×110L-15L)	14
Z17	ボルト (M10×25L)	3
Z18	アークワッシャー (M10)	23
Z19	ボルト (M10×80L-35L)	2
Z20	フラットワッシャー (M10)	8
F11	ナット (M10)	16
F50	フラットワッシャー (M10)	4


トルク値
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb

オプション：シムを使用

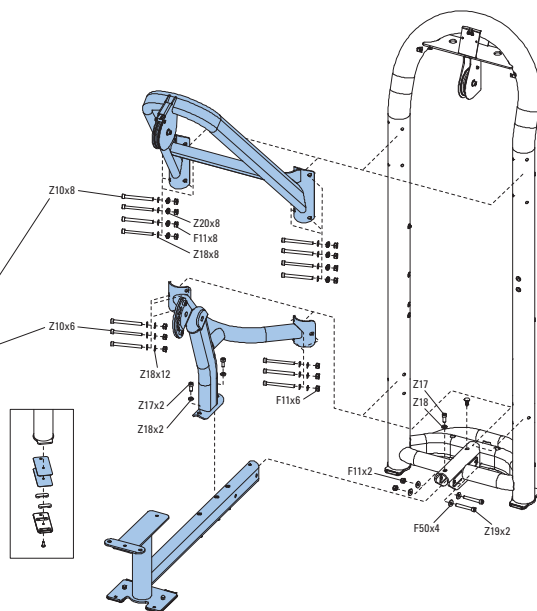


3 ハードウェア 数量

Z07	ボルト (M12×25L)	2
Z08	フラットワッシャー (M12)	2
Z09	スプリングワッシャー (M12)	2

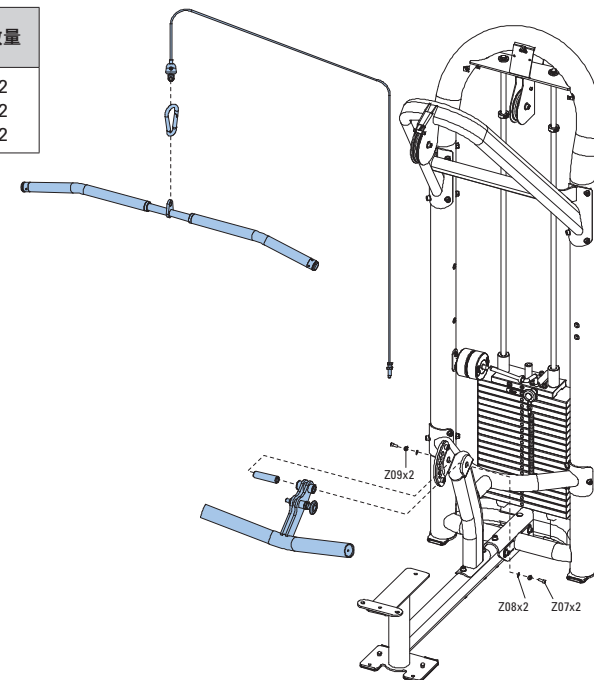


2 ハードウェア 数量

L11	スプリングワッシャー (M8)	2
L14	ネジ (M5×16L)	4
L17	ボルト (M8×20L)	2
L42	ネジ (M6×15L)	2
F48	フラットワッシャー (M5)	4
K12	止め輪	4
Z13	フラットワッシャー (M8)	2

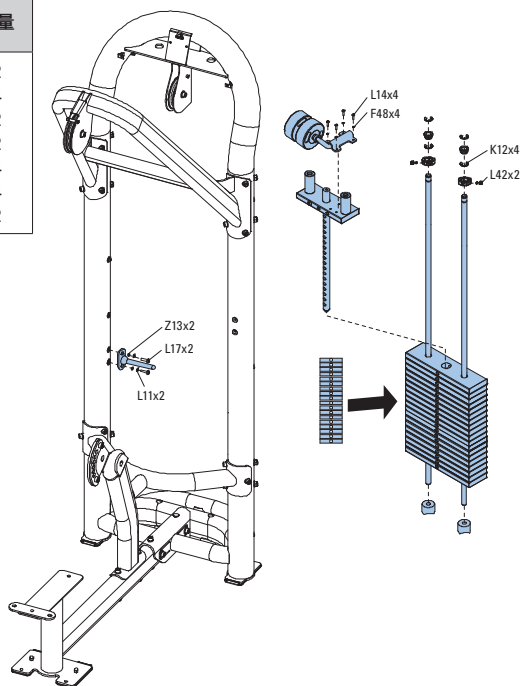

4 ハードウェア 数量


B26	ボルト (M10×25L)	3
Z13	フラットワッシャー (M8)	2
Z14	ボルト (M8×20L)	2

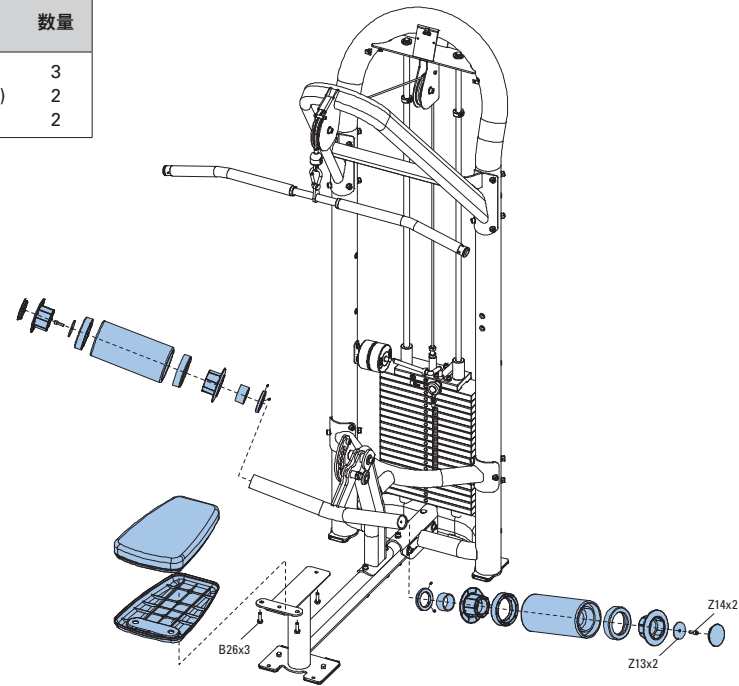



組立

5	ハードウェア	数量
B27	ボルト (M8x30L)	2
B45	ネジ (M4x12L)	6
B51	フラットワッシャー (M4)	6
L17	ボルト (M8x20L)	2

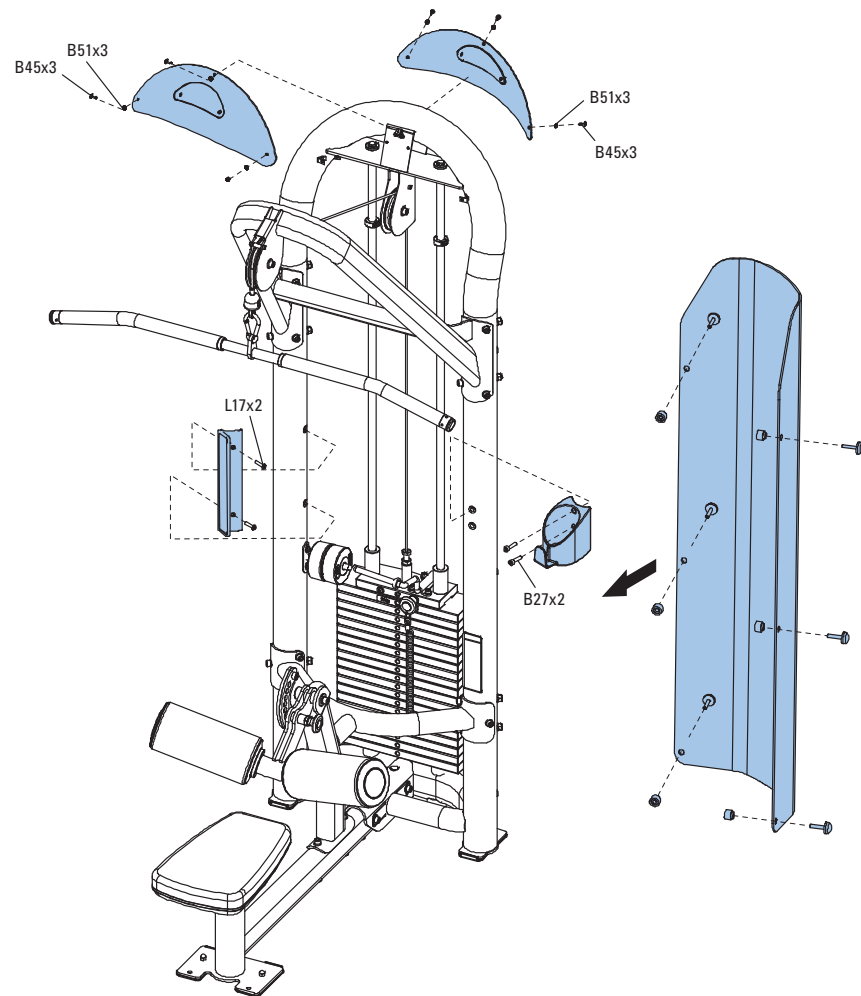

組み立て完了

プラカード





정보

올바른 사용

1. 운동 장치의 중량 제한을 초과하지 마십시오.
2. 해당하는 경우 안전 스톱을 적절한 높이로 설정하십시오.
3. 해당하는 경우 좌석 패드, 다리 패드, 발 패드, 동작 조정 범위 또는 기타 모든 유형의 조정 기계 장치를 편안한 시작 위치로 조정하십시오. 기계 장치를 조정할 때 의도하지 않은 움직임을 예방하고 부상을 방지하도록 완전히 고정되었는지 확인하십시오.
4. 벤치에 앉아(해당하는 경우) 운동에 적절한 자리를 잡으십시오.
5. 안전하게 들어 올리고 제어할 수 있는 중량을 넘지 않는 웨이트를 사용하여 운동하십시오.
6. 통제된 방식으로 운동하십시오.
7. 웨이트를 안전하게 지탱되는 시작 위치로 돌려 놓으십시오.

유지 관리 점검표


조치	빈도
덮개 청소 ¹	매일
케이블 검사 ²	매일
가이드 봉 청소	매월
장비 검사	매월
프레임 검사	연 2회
기계 청소	필요에 따라
그립 청소 ¹	필요에 따라
가이드 봉 윤활 ³	필요에 따라

¹ 덮개와 그립은 순한 비누와 물 또는 비-암모니아 계열 세제를 사용하여 세척해야 합니다.

² 케이블에 균열이나 마멸이 있는지 검사하고, 있을 경우 즉시 교체해야 합니다. 과도한 처짐이 있으면 헤드 플레이트를 들어 올리지 말고 케이블을 팽팽하게 당겨야 합니다.

³ 가이드 봉은 테플론 계열 윤활제를 발라야 합니다. 면직물에 윤활제를 묻힌 다음 가이드 봉 위 아래로 바르십시오.

운동 구역

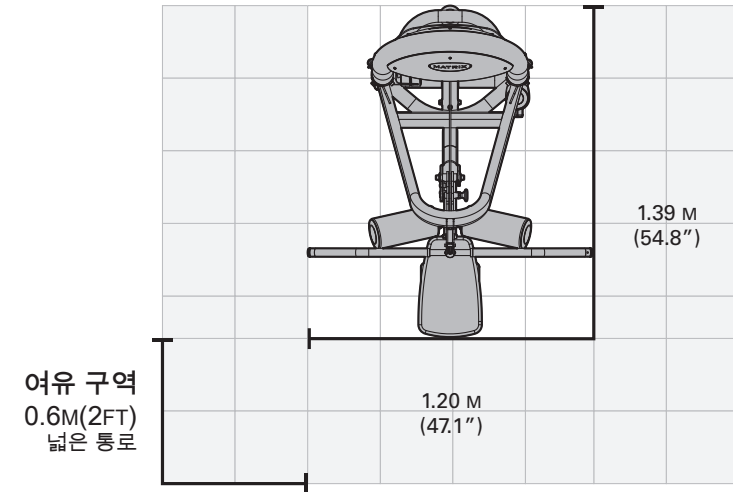

제품 사양

사용자 최대 중량	136kg / 300lbs.
최대 운동 중량	138.6kg / 305lbs.
제품 중량	245kg / 540lbs.
웨이트 스택	134kg / 295lbs.
추가용 웨이트	2.3kg / 5lbs.
전체 크기 (L x W x H)*	139.5 x 120 x 221.5cm / 55 x 47 x 87"

* MATRIX 운동 장비 주위로 최소 0.6m(24")의 간격을 두어 접근하거나 통과할 수 있게 하십시오. 휠체어 사용자에게 대한 ADA 권장 간격은 0.91m(36")입니다.

토크 값

M12 볼트(나일론 너트 및 Flowdrill)	135Nm / 100ft-lbs
M10 볼트(나일론 너트 및 Flowdrill)	77Nm / 57ft-lbs
M8 볼트	25Nm / 18ft-lbs
M8 플라스틱	15Nm / 11ft-lbs
M6 볼트	15Nm / 11ft-lbs
패드 볼트	10Nm / 7ft-lbs



정보

중요한 안전 정보

최종 사용자 혹은 감독하는 사람 그 누구든지 모든 개인에게 장비의 올바른 사용법에 대해 교육하는 것은 MATRIX 제품 구매자의 단독 책임입니다.

MATRIX 운동 장비를 사용하기 전, 모든 사용자에게 다음과 같은 정보를 알려주는 것이 좋습니다.

제조업체가 설계 또는 의도했던 것 이외의 다른 방식으로 장비를 사용하지 마십시오. 부상을 방지하기 위해 MATRIX 장비를 반드시 올바르게 사용해야 합니다.

설치

1. 안정적인 수평면: MATRIX 운동 장비는 안정된 기반 위에 설치되고 수평상태를 제대로 맞춰야 합니다.
2. 장비 고정: 모든 정지된 MATRIX 운동 장비는 바닥에 고정시켜 안정시키고 흔들리거나 넘어지지 않도록 해야 합니다(제조업체 권장 사항). 설치하는 허가 받은 업체가 실시해야 합니다.

모든 고정점은 750파운드(3.3kN)의 인발력을 견딜 수 있어야 합니다.

유지 관리

1. 손상되었거나 낡거나 부러진 부품이 있는 장비는 사용하지 마십시오. 현지 국가의 MATRIX 딜러가 공급하는 교체 부품만 사용하십시오.
2. 라벨과 명판 유지 관리: 어떤 이유로든 라벨을 제거하지 마십시오. 라벨에는 중요한 정보가 들어 있습니다. 읽을 수 없거나 없어진 경우 MATRIX 딜러에게 문의하여 교체하십시오.
3. 모든 장비 유지 관리: 예방차원의 유지 관리가 장비 작동을 원활하게 하고 책임을 최소로 유지하는 열쇠입니다. 장비는 정기적인 검사가 필요합니다.
4. 어떤 종류의 장비든 조정 또는 유지 관리나 수리를 수행하는 사람은 모두 해당 작업을 할 자격이 있는지 확인해야 합니다. 요청이 있을 경우 MATRIX 딜러가 당사 시설에서 서비스와 유지 관리 교육을 제공합니다.

추가 참고 사항

이 장비는 소유자가 특별히 접근과 제어를 통제하는 감독 구역에서만 사용해야 합니다. 이 운동 장비에 접근할 수 있는 사람을 결정하는 것은 소유자가 할 일입니다. 소유자는 사용자의 다음 사항을 고려해야 합니다. 신뢰도, 나이, 경험 등.

이 운동 장비는 제조업체가 제공한 지침에 따라 의도한 목적으로 사용할 경우 안정성에 대한 산업 표준을 충족합니다.

이 장비는 실내 전용입니다. 이 운동 장비는 클래스 S 제품(피트니스 시설과 같은 상업적 환경에서 사용하도록 설계)입니다. 이 운동 장비는 EN ISO 20957-1 및 EN 957-2를 준수합니다.

포장재 제거

MATRIX Fitness 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 이 제품은 포장 전에 검사를 거쳤습니다. 기계의 소형 포장용 용이하게 하기 위하여 여러 날개 부품으로 발송됩니다. 조립하기 전에 분해 조립도와 부품을 맞추어 보고 이를 모두 확인하십시오. 이 상자에서 조심해서 장치를 꺼내고, 현지 법률에 따라 포장재를 처리하십시오. 운동 장비는 반드시 숙련된 조립 팀이 조립하거나 사전에 조립된 상태로 배송되어야 합니다.

주의 사항

자신의 부상을 방지하고 프레임 부품의 손상을 예방하려면, 이 상자에서 프레임 부분들을 꺼내는 데 올바른 도움을 받으십시오. 장비를 안정된 기반 위에 설치하고 기계가 제대로 수평을 갖췄는지 확인하십시오. MATRIX 운동 장비 주위로 최소 0.6m(24")의 간격을 두어 접근하거나 통과할 수 있게 하십시오. 휠체어 사용자에게 대한 ADA 권장 간격은 0.91m(36")입니다.

품질보증

북미지역 고객은 matrixfitness.com에서 제품보증 정보와 예외사항 및 책임제한 정보를 볼 수 있습니다.

⚠ 경고

본 장비에서 사망 또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다. 다음 예방조치에 따라 부상을 방지하십시오!

1. 14세 미만의 어린이는 이 근력 운동 장비에 접근해서는 안 됩니다. 10대 청소년들은 항상 감독 하에 본 장비를 사용해야 합니다.
2. 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람은 안전 책임자로부터 장비 사용에 관한 감독이나 지침을 받은 경우가 아니면, 이 장비를 사용해서는 안 됩니다.
3. 사용하기 전에 모든 경고 및 지침을 읽고 적절한 지침을 받아야 합니다. 이 장비는 의도한 목적으로만 사용하십시오.
4. 사용하기 전에 기계를 점검하십시오. 기계가 손상되었거나 작동할 수 없으면 사용하지 마십시오.
5. 이 장비의 웨이트 용량을 초과하지 마십시오.
6. 선택가 핀이 웨이트 스택에 완전히 끼워졌는지 확인하십시오.
7. 웨이트 스택이 높은 위치에 꽂혀 있다면 기계를 사용하지 마십시오.
8. 덤벨이나 다른 수단을 사용하여 점차적으로 웨이트 저항을 증가시키지 마십시오. 제조업체에서 직접 제공한 수단만 사용하십시오.
9. 잘못되거나 과도한 운동으로 건강을 해칠 수 있습니다. 어지러움을 느낄 경우 운동을 중단하십시오. 운동 프로그램을 시작하기 전에 의료 검사를 받으십시오.
10. 신체, 옷, 머리카락 및 피트니스 액세서리가 걸리지 않도록 하고 모든 움직이는 부품을 치우십시오.
11. 조정식 스톱이 제공되었다면 항상 사용해야 합니다.
12. 조정식 메커니즘(정지 위치, 시트 포지션, 패드 위치, 운동 리미터 범위, 롤러 캐리지 또는 기타 유형)을 조정할 때는 의도치 않은 움직임을 방지하기 위해 사용하기 전에 조정식 메커니즘이 완전히 체결되었는지 확인하십시오.
13. 이 장비는 바닥에 고정시켜 안정시키고 흔들리거나 넘어지지 않도록 해야 합니다(제조업체 권장 사항). 허가된 계약업체를 이용하십시오.
14. 장비가 바닥에 고정되지 않은 경우: 저항 스트랩, 로프 또는 기타 수단을 이 장비에 달지 마십시오. 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 근력 운동 중 이 장비를 지지대로 사용하지 마십시오. 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
15. 이 라벨을 제거하지 마십시오. 라벨이 손상되거나 판독할 수 없는 경우 교체하십시오.




조립

1 하드웨어 수량

Z10	볼트 (M10x110L-15L)	14
Z17	볼트 (M10x25L)	3
Z18	아크 와셔 (M10)	23
Z19	볼트 (M10x80L-35L)	2
Z20	와셔 (M10)	8
F11	너트 (M10)	16
F50	플랫 와셔 (M10)	4


토크 값
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb

선택 사항 : shim

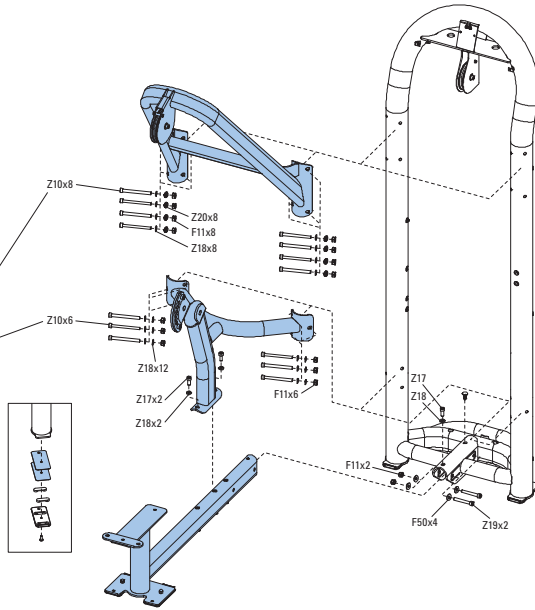


3 하드웨어 수량

Z07	볼트 (M12x25L)	2
Z08	플랫 와셔 (M12)	2
Z09	스프링 와셔 (M12)	2

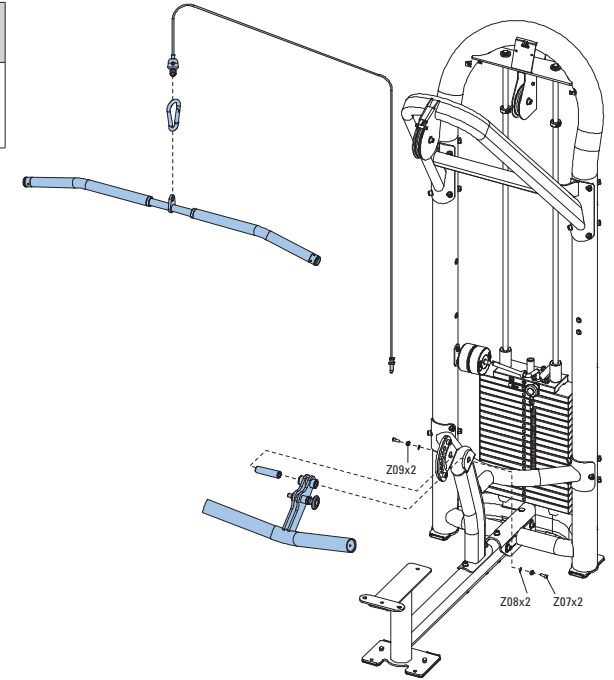


2 하드웨어 수량

L11	스프링 와셔 (M8)	2
L14	나사 (M5x16L)	4
L17	볼트 (M8x20L)	2
L42	나사 (M6x15L)	2
F48	플랫 와셔 (M5)	4
K12	스냅 링	4
Z13	플랫 와셔 (M8)	2

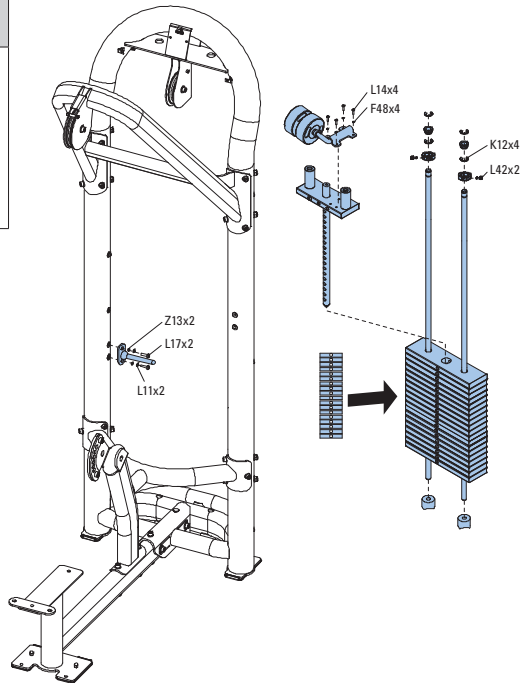

4 하드웨어 수량


B26	볼트 (M10x25L)	3
Z13	플랫 와셔 (M8)	2
Z14	볼트 (M8x20L)	2

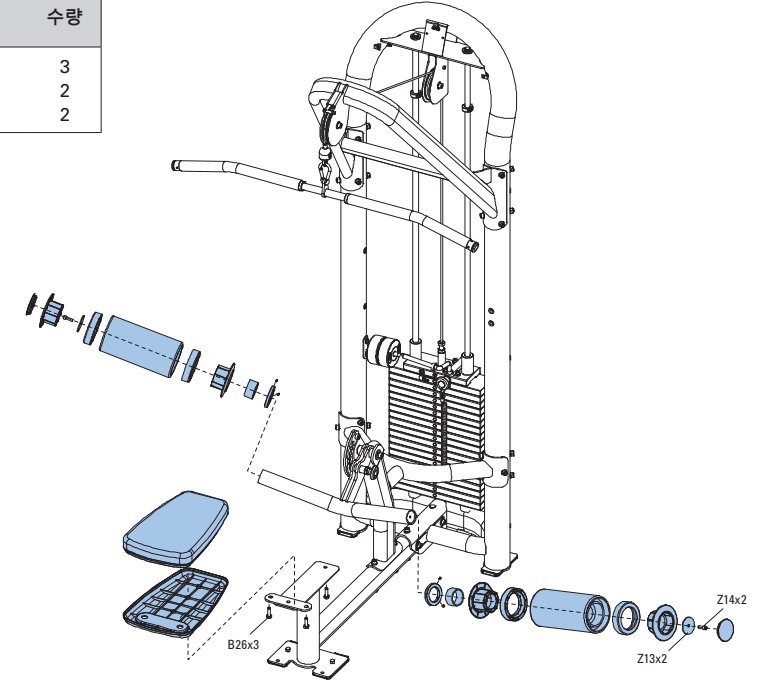



조립

5	하드웨어	수량
B27	볼트 (M8x30L)	2
B45	나사 (M4x12L)	6
B51	플랫 와셔 (M4)	6
L17	볼트 (M8x20L)	2

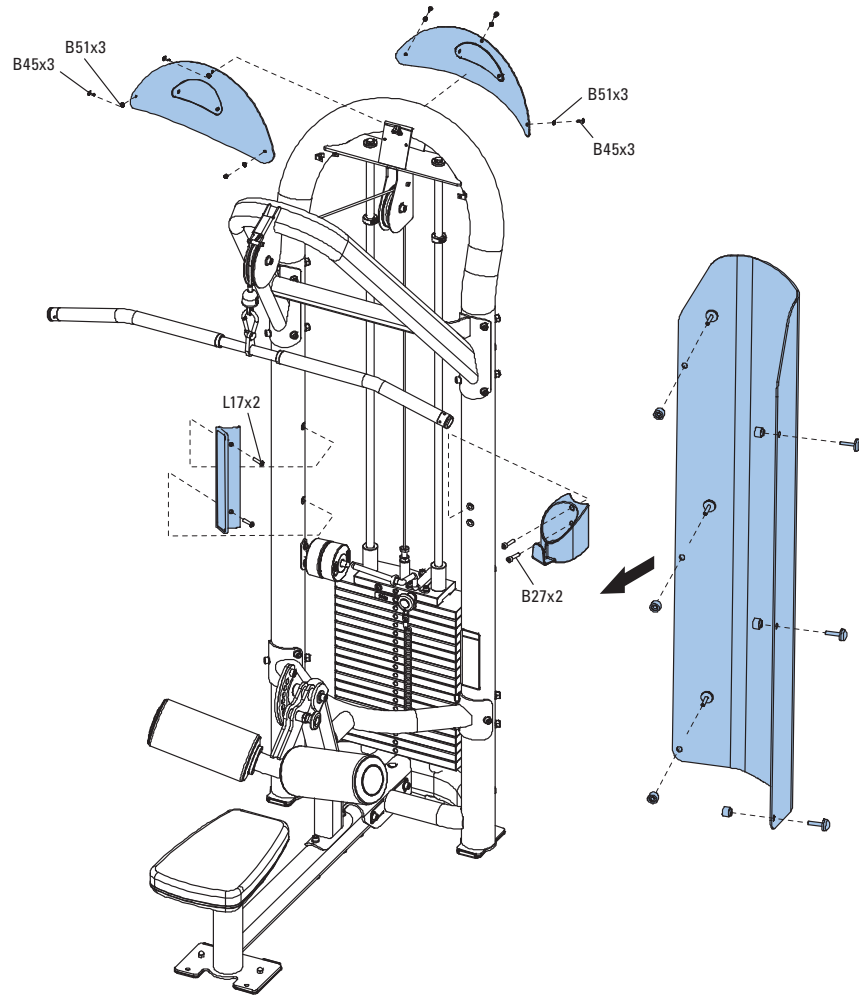

조립이 완료되었습니다

방





THÔNG TIN

SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

1. Không được vượt quá giới hạn trọng lượng của thiết bị tập.
2. Nếu phù hợp, cài đặt các bộ phận chặn an toàn đến chiều cao thích hợp.
3. Nếu phù hợp, điều chỉnh tấm đỡ yên, tấm đỡ chân, tấm đỡ bàn chân, phạm vi chuyển động, hoặc bất kỳ dạng cơ chế điều chỉnh nào khác đến một vị trí bắt đầu thoải mái. Đảm bảo rằng cơ chế điều chỉnh đã cài sẵn để tránh vô tình chuyển động và để tránh thương tật.
4. Ngồi trên băng (nếu phù hợp) và vào vị trí thích hợp để tập.
5. Tập luyện khi sử dụng trọng lượng không vượt quá trọng lượng bạn có thể nâng và kiểm soát một cách an toàn.
6. Tập luyện theo cách có kiểm soát.
7. Đưa tạ về vị trí bắt đầu được đỡ đầy đủ của nó.

DANH SÁCH KIỂM TRA BẢO DƯỠNG


HÀNH ĐỘNG	TẦN SUẤT
Vệ Sinh Nệm ¹	Hàng ngày
Kiểm Tra Dây Cáp ²	Hàng ngày
Vệ Sinh Các Thanh Dẫn	Hàng tháng
Kiểm Tra Thiết Bị	Hàng tháng
Kiểm Tra Khung	Hai Lần Một Năm
Vệ Sinh Máy	Khi Cần Thiết
Vệ Sinh Báng Cầm ¹	Khi Cần Thiết
Bôi Trơn Các Thanh Dẫn ³	Khi Cần Thiết

¹ Phải vệ sinh Nệm & Báng Cầm bằng xà phòng nhẹ và nước hoặc chất tẩy không chứa amoniac.

² Phải kiểm tra dây cáp xem có bị nứt hay xước không và thay ngay nếu có. Nếu quá chùng, phải siết cáp mà không nâng thanh giăng.

³ Phải bôi trơn các thanh dẫn bằng dầu bôi trơn dùng Teflon. Thoa dầu bôi trơn lên một tấm vải cotton và sau đó thoa lên xuống các thanh dẫn.

KHU VỰC TẬP LUYỆN

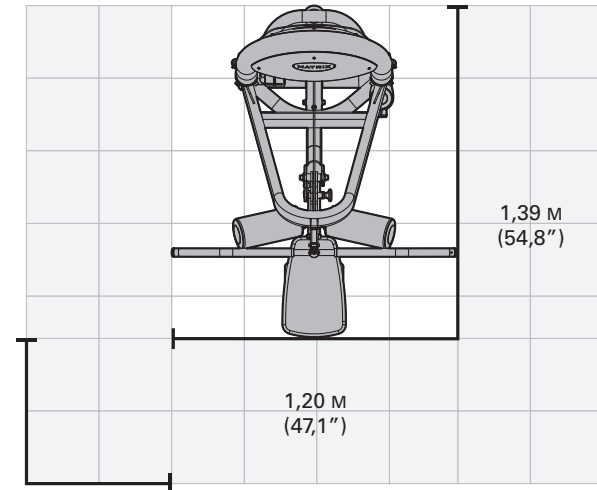

THÔNG KHOẢNG
0,6 M (2 FT)
LỐI ĐI RỘNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

Cân Nặng Tối Đa Của Người Dùng	136 kg / 300 cân Anh
Trọng Lượng Tập Tối Đa	138,6 kg / 305 cân Anh
Trọng Lượng Sản Phẩm	245 kg / 540 cân Anh
Khối Tạ	134 kg / 295 cân Anh
Thêm Tạ	2,3 kg / 5 cân Anh
Kích Thước Chung (Dài x Rộng x Cao)*	139,5 x 120 x 221,5 cm / 55 x 47 x 87"

* Đảm bảo chiều rộng thông khoảng tối thiểu là 0,6 mét (24") để tiếp cận và di chuyển quanh thiết bị tập MATRIX, Vui lòng lưu ý, 0,91 mét (36") là chiều rộng thông khoảng được ADA khuyến cáo đối với người sử dụng xe lăn,

GIÁ TRỊ MÔMEN

Bulông M12 (Đai Ốc Nyloc & Flowdrill)	135 Nm / 100 ft-lbs
Bulông M10 (Đai Ốc Nyloc & Flowdrill)	77 Nm / 57 ft-lbs
Bulông M8	25 Nm / 18 ft-lbs
M8 Plastic	15 Nm / 11 ft-lbs
Bulông M6	15 Nm / 11 ft-lbs
Bulông Đỡ	10 Nm / 7 ft-lbs



THÔNG TIN

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

Người mua sản phẩm MATRIX có trách nhiệm hướng dẫn tất cả các cá nhân, cho dù họ là người dùng cuối hay nhân sự giám sát, về việc sử dụng thiết bị đúng cách.

Tất cả người dùng thiết bị tập MATRIX nên nắm rõ thông tin sau đây trước khi sử dụng.

Không được sử dụng bất kỳ thiết bị nào theo bất kỳ cách nào khác với thiết kế hoặc mục đích của hãng sản xuất. Điều rất quan trọng là phải sử dụng thiết bị MATRIX đúng cách để tránh bị thương.

LẮP ĐẶT

- BỀ MẶT ỔN ĐỊNH VÀ CÂN BẰNG:** Phải lắp đặt thiết bị tập MATRIX trên nền ổn định và cân bằng phù hợp.
- THIẾT BỊ CỐ ĐỊNH:** Hãng sản xuất khuyến cáo nên cố định thiết bị tập luyện MATRIX dạng tĩnh vào sàn nhà để ổn định và loại bỏ tình trạng rung lắc hay lật. Thao tác này phải được thực hiện bởi nhà thầu có giấy phép.

Mọi điểm neo phải có thể chịu được lực kéo 750 cân Anh (3,3 kN).

BẢO DƯỠNG

- KHÔNG** được sử dụng bất kỳ thiết bị nào đã bị hỏng và/hoặc có các bộ phận bị hư mòn hoặc hỏng. Chỉ sử dụng các bộ phận thay thế được cung cấp bởi đại lý bán hàng MATRIX tại địa phương của bạn.
- DUY TRÌ NHÃN VÀ BẢNG THÔNG SỐ:** Không được gỡ nhãn vì bất kỳ lý do gì. Chúng chứa thông tin quan trọng. Nếu không đọc được hoặc thiếu nhãn, hãy liên hệ với đại lý bán hàng MATRIX của bạn để thay.
- BẢO DƯỠNG TẤT CẢ THIẾT BỊ:** Bảo dưỡng phòng ngừa đóng vai trò quan trọng để đảm bảo thiết bị vận hành trơn tru cũng như đảm bảo trách nhiệm pháp lý của bạn ở mức tối thiểu. Cần phải kiểm tra thiết bị đều đặn.
- Đảm bảo rằng bất kỳ ai thực hiện điều chỉnh hay bảo dưỡng hay sửa chữa dưới bất kỳ hình thức nào đều có năng lực thực hiện. Các đại lý bán hàng MATRIX sẽ tổ chức huấn luyện bảo trì và bảo dưỡng tại cơ sở công ty của bạn theo yêu cầu.

LƯU Ý BỔ SUNG

Chỉ được sử dụng thiết bị này ở các khu vực có giám sát, ở đó chủ sở hữu có quy định cụ thể về việc tiếp cận và điều khiển thiết bị. Chủ sở hữu toàn quyền quyết định ai được phép tiếp cận thiết bị tập này. Chủ sở hữu phải cân nhắc: mức độ tin cậy, độ tuổi, kinh nghiệm của người dùng, v.v.

Thiết bị tập này đáp ứng các tiêu chuẩn trong ngành về tính ổn định khi được sử dụng theo mục đích thiết kế tuân thủ hướng dẫn của hãng sản xuất.

Thiết bị này chỉ được sử dụng cho mục đích sử dụng trong nhà. Thiết bị tập luyện này là một sản phẩm Hạng S (được thiết kế để sử dụng trong môi trường thương mại chẳng hạn như cơ sở tập thể hình). Thiết bị tập luyện này tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 20957-1 và EN 957-2.

THÁO BAO BÌ

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm tập của MATRIX. Sản phẩm đã được kiểm tra trước khi đóng gói. Sản phẩm được vận chuyển thành nhiều phần để tạo điều kiện đóng gói gọn gàng. Trước khi lắp ráp, hãy xác nhận tất cả bộ phận bằng cách so sánh chúng với các sơ đồ bên ngoài. Cần thận trọng tháo bao bì của thiết bị từ hộp này và vứt bỏ vật liệu đóng gói theo quy định luật pháp địa phương. Thiết bị tập phải được lắp ráp bởi đội lắp ráp có chuyên môn hoặc được lắp ráp sẵn trước khi giao.

THẬN TRỌNG

Để tránh thương tích cho bản thân bạn và phòng ngừa hư hỏng các bộ phận khung, đảm bảo nhờ người khác hỗ trợ thích hợp khi tháo các bộ phận khung ra khỏi hộp này. Vui lòng đảm bảo lắp đặt thiết bị trên một nền ổn định, và cân bằng máy đúng cách. Đảm bảo chiều rộng thông khoảng tối thiểu là 0,6 mét (24") để tiếp cận và di chuyển quanh thiết bị tập MATRIX. Vui lòng lưu ý, 0,91 mét (36") là chiều rộng thông khoảng được ADA khuyến cáo đối với người sử dụng xe lăn.

BẢO HÀNH

Đối với khu vực Bắc Mỹ, vui lòng truy cập matrixfitness.com để biết thông tin bảo hành cùng với các trường hợp loại trừ và giới hạn bảo hành.

CẢNH BÁO

CÓ THỂ XẢY RA TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH NGHIÊM TRỌNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY. THỰC HIỆN THEO CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG NGỪA TỬ VONG HOẶC BỊ THƯƠNG!

- Đảm bảo trẻ em dưới 14 tuổi tránh xa thiết bị tập này. Thanh thiếu niên phải luôn có người giám sát khi sử dụng thiết bị này.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng bởi các cá nhân có khuyết tật về thể chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Phải đọc tất cả cảnh báo và hướng dẫn thích hợp trước khi sử dụng. Chỉ sử dụng thiết bị này theo mục đích thiết kế của nó.
- Kiểm tra máy trước khi sử dụng. KHÔNG được sử dụng máy nếu bị hư hỏng hoặc không thể vận hành.
- Không được tác động lực nặng quá công suất của thiết bị này.
- Đảm bảo chốt chọn đã lắp hẳn vào chốt tạ.
- KHÔNG BAO GIỜ được sử dụng máy với chốt tạ được chốt ở vị trí cao.
- KHÔNG BAO GIỜ sử dụng thanh tạ hoặc cách khác để tăng dần lực trở của tạ. Chỉ sử dụng phương tiện được hãng sản xuất trực tiếp cung cấp.
- Thương tật có thể xảy ra vì tập không đúng cách hoặc quá mức. Ngưng tập nếu bạn bị chóng mặt hoặc choáng váng. Khám sức khỏe trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện.
- Đảm bảo cơ thể, quần áo, tóc và phụ kiện tập không vướng vào tất cả các bộ phận chuyển động.
- Phải luôn sử dụng các thiết bị chặn có thể điều chỉnh khi được cung cấp.
- Khi điều chỉnh bất kỳ cơ chế nào có thể điều chỉnh (vị trí bộ phận chặn, vị trí yên, vị trí tấm đế chân, phạm vi của thiết bị hạn định chuyển động, bàn trượt pull, hoặc bất kỳ loại nào khác), đảm bảo rằng cơ chế có thể điều chỉnh đó được gài hẳn trước khi sử dụng để tránh chuyển động không mong muốn.
- Hãng sản xuất khuyến cáo nên cố định thiết bị này vào sàn nhà để ổn định và loại bỏ tình trạng rung lắc hay lật. Thuê nhà thầu có giấy phép.
- Nếu thiết bị này KHÔNG được cố định vào sàn nhà: KHÔNG bao giờ được cố kéo, dây thừng hay dụng cụ khác gắn vào thiết bị này, vì có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng. KHÔNG bao giờ sử dụng thiết bị này làm vật đỡ trong thao tác vươn giãn, vì có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng.
- KHÔNG ĐƯỢC GỠ NHÃN NÀY. THAY NẾU BỊ HỎNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC.




LẮP RÁP


1	Thiết bị	Số lượng
Z10	Bu lông (M10x110L-15L)	14
Z17	Bu lông (M10x25L)	3
Z18	Vòng Đệm Hình Cung (M10)	23
Z19	Bu lông (M10x80L-35L)	2
Z20	Vòng Đệm (M10)	8
F11	Đai ốc (M10)	16
F50	Vòng Đệm Phẳng (M10)	4

Giá trị mômen
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb


Tùy chọn: Sử dụng miếng đệm

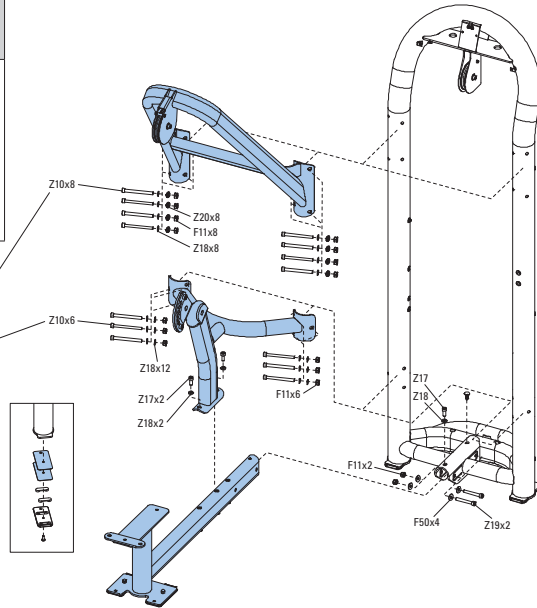


2	Thiết bị	Số lượng
L11	Vòng Đệm Lò Xo (M8)	2
L14	Ốc vít (M5x16L)	4
L17	Bu lông (M8x20L)	2
L42	Ốc vít (M6x15L)	2
F48	Vòng Đệm Phẳng (M5)	4
K12	Chụp chiếc nhẵn	4
Z13	Vòng Đệm Phẳng (M8)	2

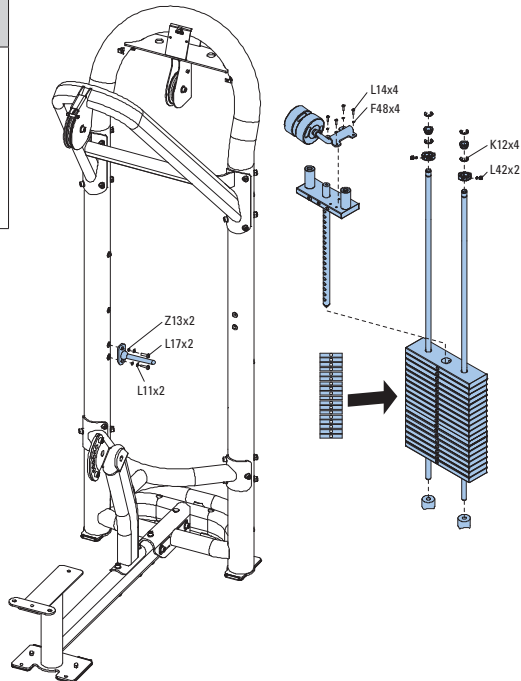

3	Thiết bị	Số lượng
Z07	Bu lông (M12x25L)	2
Z08	Vòng Đệm Phẳng (M12)	2
Z09	Vòng Đệm Lò Xo (M12)	2

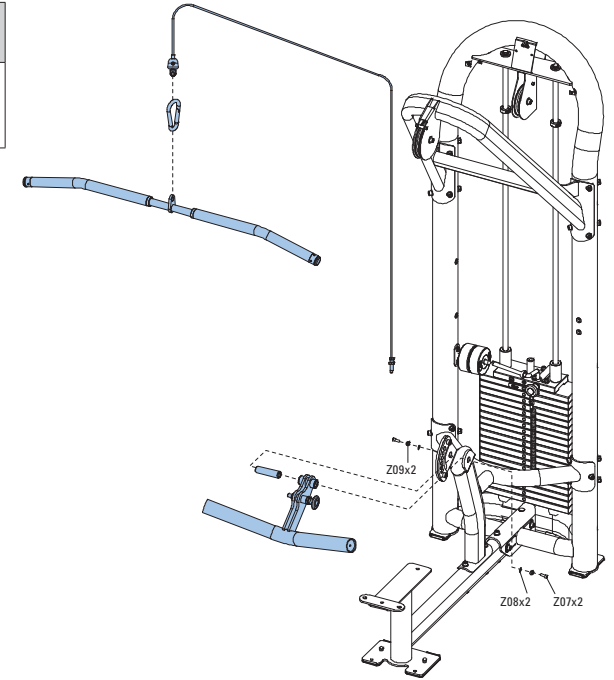


4	Thiết bị	Số lượng
B26	Bu lông (M10x25L)	3
Z13	Vòng Đệm Phẳng (M8)	2
Z14	Bu lông (M8x20L)	2

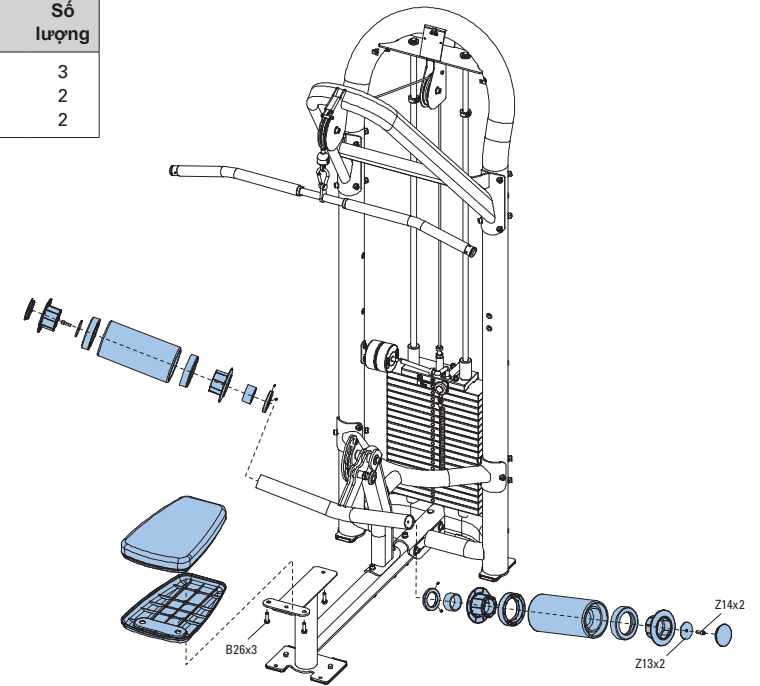



LẮP RÁP

5	Thiết bị	Số lượng
B27	Bu lông (M8x30L)	2
B45	Ốc vít (M4x12L)	6
B51	Vòng Đệm Phẳng (M4)	6
L17	Bu lông (M8x20L)	2

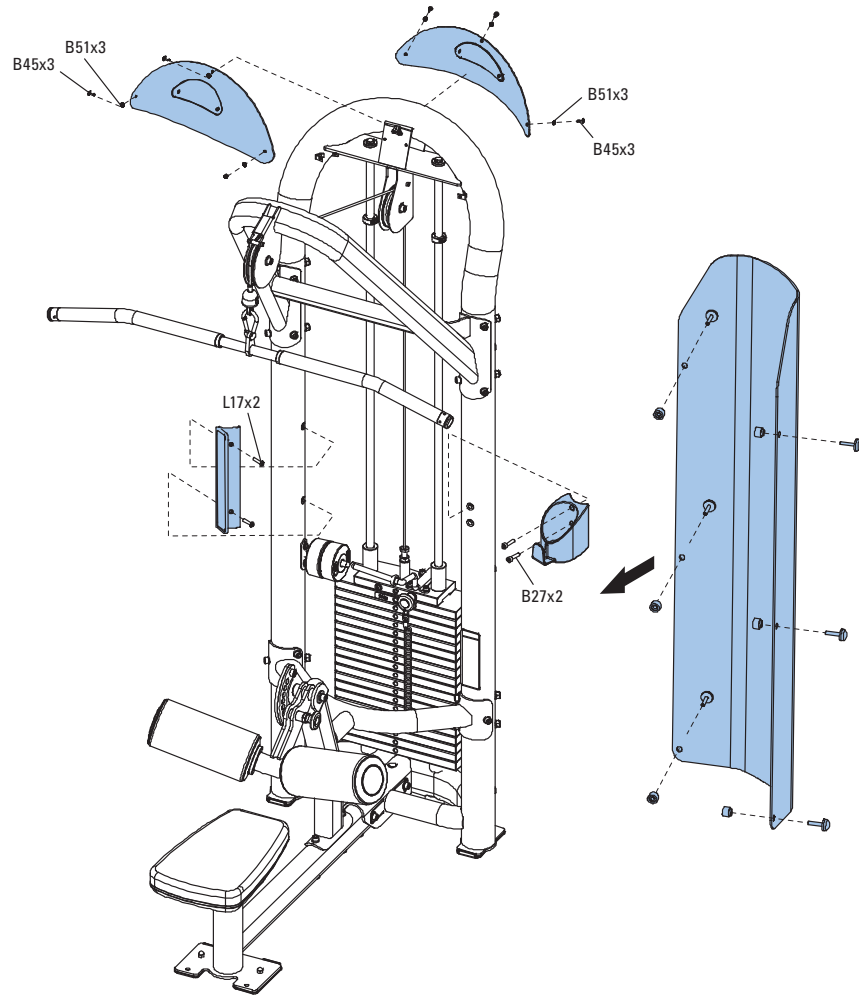

LẮP RÁP HOÀN TẤT

KÝ TÊN





ข้อมูล

การใช้งานที่เหมาะสม

- ห้ามใช้งานเกินขีดจำกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้ของอุปกรณ์ออกกำลังกาย
- หากทำได้ ตั้งตัวกันเพื่อความปลอดภัยในระดับความสูงที่เหมาะสม
- ถ้าทำได้ ปรับเบาะนั่ง แผ่นรองขา แผ่นรองเท้า ช่วงการปรับการเคลื่อนไหว หรือกลไกการปรับอื่นๆ ในตำแหน่งเริ่มต้นที่สบาย ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากลไกการปรับล็อกเข้าตำแหน่งแน่นหนาเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจและป้องกันการได้รับบาดเจ็บ
- นั่งบนที่นั่ง (หากมี) ในตำแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมออกกำลังกาย
- ออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักที่คุณสามารถยกและควบคุมได้อย่างปลอดภัย
- ออกกำลังกายภายใต้การควบคุม
- ดันน้ำหนักกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่รองรับน้ำหนักได้เต็มที่

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษา


การดำเนินการ	ความถี่
ทำความสะอาดเบาๆ ¹	ทุกวัน
ตรวจสอบสายเคเบิล ²	ทุกวัน
ทำความสะอาดเหล็กลูก	ทุกเดือน
ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์	ทุกเดือน
ตรวจสอบโครง	ปีละสองครั้ง
ทำความสะอาดเครื่อง	ตามความจำเป็น
ทำความสะอาดมือจับ ¹	ตามความจำเป็น
หล่อลื่นเหล็กลูก ³	ตามความจำเป็น

¹ ทำความสะอาดเบาๆ และมือจับด้วยน้ำผสมสบู่ชนิดอ่อนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย

² ตรวจสอบสายว่ามีรอยแตกหรือชำรุดหรือไม่และเปลี่ยนใหม่ทันทีหากพบการชำรุด หากสายเคเบิลหลวมเกินไป ให้ขันแน่นโดยไม่ต้องยกแผ่นปิดด้านบน

³ หล่อลื่นเหล็กลูกด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของเทฟลอน ใช้ผ้าฝ้ายชุบน้ำมันหล่อลื่นเช็ดขึ้นลงที่เหล็กลูก

พื้นที่ออกกำลังกาย

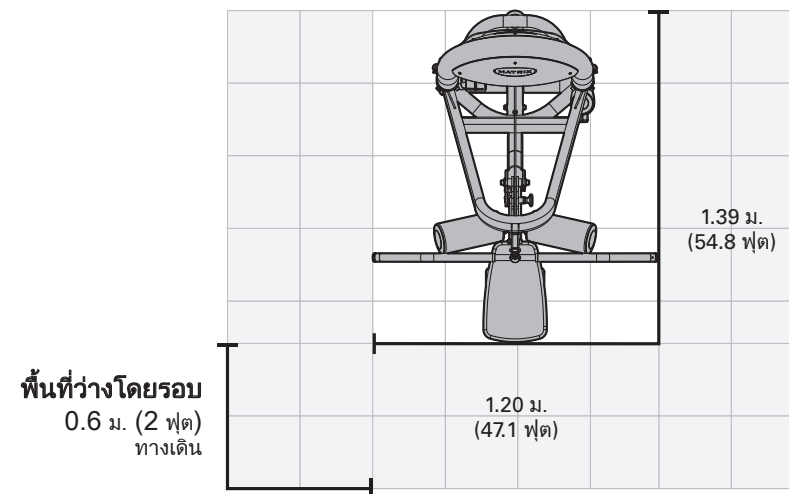

พื้นที่ว่างโดยรอบ
0.6 ม. (2 ฟุต)
ทางเดิน

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด	136 kg / 300 ปอนด์
น้ำหนักการออกกำลังกายสูงสุด	138.6 kg / 305 ปอนด์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	245 kg / 540 ปอนด์
แทนใส่น้ำหนัก	134 kg / 295 ปอนด์
น้ำหนักสำหรับเพิ่ม	2.3 kg / 5 ปอนด์
ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง)*	139.5 x 120 x 221.5 ซม. / 55 x 47 x 87 ปอนด์

* ตรวจสอบว่ามีระยะห่างอย่างน้อย 0.60 เมตร (24 นิ้ว) สำหรับทางเดินเข้าและเดินผ่านรอบอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ MATRIX โปรดทราบ ADA แนะนำให้มีความกว้างมีระยะห่าง 0.91 เมตร (36 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้รถเข็น

ค่าแรงบิดในการขัน

โบลท์ M12 (น็อต Nyloc และเกลียวเจาะแบบเชื่อมในตัว)	135 Nm / 100 ft-lbs
โบลท์ M10 (น็อต Nyloc และเกลียวเจาะแบบเชื่อมในตัว)	77 Nm / 57 ft-lbs
โบลท์ M8	25 Nm / 18 ft-lbs
พลาสติก M8	15 Nm / 11 ft-lbs
โบลท์ M6	15 Nm / 11 ft-lbs
โบลท์แผ่นรอง	10 Nm / 7 ft-lbs



ข้อมูล

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ MATRIX เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแนะนำผู้ใช้หรือผู้ดูแลในการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ผู้ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย MATRIX ทุกคนควรทราบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งาน

ห้ามใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่นอกเหนือจากที่ผู้ผลิตออกแบบหรือกำหนดไว้ ใช้อุปกรณ์ MATRIX อย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้ง

- พื้นที่ที่มั่นคงและได้ระดับ: ต้องติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย MATRIX บนพื้นที่มั่นคงและได้ระดับอย่างถูกต้อง
- การยึดอุปกรณ์: ผู้ผลิตแนะนำให้ยึดอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ MATRIX ที่อยู่กับที่ทั้งหมดกับพื้นอย่างแน่นหนาเพื่อให้อุปกรณ์ยึดอย่างมั่นคงและป้องกันอุปกรณ์แกว่งหรือล้มคว่ำ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาต

จุดยึดทั้งหมดต้องรับแรงดึงได้ 750 ปอนด์ (3.3 kN)

การบำรุงรักษา

- ห้ามใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่ชำรุดเสียหายและ/หรือมีชิ้นส่วนที่ฉีกขาดหรือแตกหัก ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ที่จัดหาโดยตัวแทนจำหน่าย MATRIX ในประเทศของคุณเท่านั้น
- การดูแลรักษาป้ายและป้ายชื่อต่างๆ: ห้ามดึงป้ายออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญ หากไม่สามารถอ่านป้ายได้หรือสูญหาย ติดต่อตัวแทนจำหน่าย MATRIX เพื่อขอเปลี่ยนป้ายใหม่
- การดูแลรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด: การบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีความสำคัญต่อการทำงานที่ราบรื่นของอุปกรณ์ และลดภาระการดูแลรักษาของคุณให้น้อยที่สุด ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ที่ทำการปรับหรือบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมงานซ่อมทุกชนิดจะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว่าข้างต้น ตัวแทนจำหน่าย MATRIX จะจัดให้มีการฝึกอบรมการบริการและการบำรุงรักษาในบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอ

หมายเหตุเพิ่มเติม

ใช้อุปกรณ์นี้ในพื้นที่ที่มีการควบคุมดูแลเท่านั้น โดยเจ้าของอุปกรณ์จะต้องกำหนดการเข้าใช้และการควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง และพิจารณาอนุญาตบุคคลที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ออกกำลังกายนี้ ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผู้ใช้งาน: ความเหมาะสมของผู้ใช้ อายุ ประสบการณ์ เป็นต้น

อุปกรณ์ออกกำลังกายนี้ตรงตามมาตรฐานความทนทานระดับอุตสาหกรรม เมื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

อุปกรณ์นี้ใช้ภายในอาคารเท่านั้น อุปกรณ์ออกกำลังกายนี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส S (ออกแบบมาสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ เช่น สถานออกกำลังกาย) อุปกรณ์ออกกำลังกายนี้เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO 20957-1 และ EN 957-2

การเปิดกล่องบรรจุอุปกรณ์

ขอคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกาย MATRIX อุปกรณ์ได้รับการตรวจสอบก่อนบรรจุกล่อง และจัดส่งแยกเป็นชิ้นเพื่อความสะดวกในการบรรจุกล่องที่มีขนาดกะทัดรัด ก่อนทำการประกอบ ตรวจสอบยืนยันว่ามีส่วนประกอบครบและตรงตามแผนภาพที่แสดง นำอุปกรณ์ออกจากกล่องอย่างระมัดระวังและกำจัดทั้งวัสดุบรรจุโดยสอดคล้องตามกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ อุปกรณ์ออกกำลังกายต้องประกอบโดยทีมประกอบอุปกรณ์ที่ผ่านการฝึกอบรม หรือทำการประกอบอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนการจัดส่ง

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อตัวเองและป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบของโครง ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อนำชิ้นส่วนของโครงออกจากกล่องนี้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นที่มั่นคงและในระดับที่เหมาะสม ตรวจสอบว่ามีระยะห่างอย่างน้อย 0.60 เมตร (24 นิ้ว) สำหรับทางเดินเข้าและเดินผ่านรอบอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ MATRIX โปรตทราบบ ADA แนะนำให้มีความกว้างมีระยะห่าง 0.91 เมตร (36 นิ้ว) สำหรับผู้ใช้รถเข็น

การรับประกัน

สำหรับในอเมริกาเหนือ โปรดเข้าไปที่ matrixfitness.com สำหรับข้อมูลการรับประกันควบคู่กับข้อบกพร่องและข้อจำกัดในการรับประกัน

คำเตือน

- อุปกรณ์นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงชีวิตได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ**
- ห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปีอยู่ใกล้กับอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ เด็ดขาดห้ามให้อุปกรณ์นี้ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์
 - อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มิใช่ข้อจำกัดทางกายระบบประสาทหรือทางจิต หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือแนะนำการใช้อุปกรณ์โดยผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
 - อ่านป้ายเตือนและคำแนะนำทั้งหมดและขอคำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องก่อนใช้อุปกรณ์ ใช้อุปกรณ์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
 - ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน ห้ามใช้อุปกรณ์หากมีร่องรอยชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้
 - ห้ามใช้น้ำหนักเกินขีดจำกัดการรับน้ำหนักของอุปกรณ์นี้
 - ตรวจสอบว่าสลักเลือกน้ำหนักสอดเข้าในแท่นใส่น้ำหนักเข้าที่เรียบร้อยแล้ว
 - ห้ามใช้อุปกรณ์หากสลักเลือกน้ำหนักไม่สอดเข้าในแท่นใส่น้ำหนักอย่างถูกต้อง
 - ห้ามใช้ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ในการเพิ่มระดับความเหนื่อยยาก ใช้อุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือผู้ผลิตเท่านั้น
 - การบาดเจ็บอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องหรือหนักเกินไป หยุดออกกำลังกายหากรู้สึกจะเป็นลมหรือเวียนศีรษะระหว่างการออกกำลังกายก่อนเริ่มโปรแกรมการออกกำลังกาย
 - ระวังอย่าให้ส่วนของร่างกาย เสื้อผ้าผมและอุปกรณ์ออกกำลังกายเสริมเข้าไปติดกับอุปกรณ์และอยู่ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ทั้งหมด
 - ใช้ตัวกั้นแบบปรับได้ (ถ้ามี) ทุกครั้ง
 - เมื่อปรับตั้งกลไกตัวปรับ (ตำแหน่งหยุดตำแหน่งที่นั่ง ตำแหน่งแผ่นรอง ช่วงจำกัดการเคลื่อนที่ ด้ามจับ หรือกลไกอื่นๆ) ตรวจสอบว่ากลไกตัวปรับล็อกเข้าที่ก่อนใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ
 - ผู้ผลิตแนะนำให้ยึดอุปกรณ์นี้กับพื้น เพื่อให้อุปกรณ์ยึดอย่างมั่นคงและป้องกันอุปกรณ์แกว่งหรือล้มคว่ำ ติดตั้งอุปกรณ์โดยผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาต
 - ในกรณีที่ไม่ยึดอุปกรณ์กับพื้น ห้ามใช้ยาง เชือกหรือวัสดุอื่นๆ ผูกโยงกับอุปกรณ์นี้โดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บและห้ามใช้อุปกรณ์นี้ด้วยหรืออาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากแรง
 - ห้ามดึงป้ายออก เปลี่ยนใหม่หากเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถอ่านได้




การประกอบ


1	ชิ้นส่วน	จำนวน
Z10	โบลท์ (M10x110L-15L)	14
Z17	โบลท์ (M10x25L)	3
Z18	แหวนรองชนิดโค้ง (M10)	23
Z19	โบลท์ (M10x80L-35L)	2
Z20	แหวนรอง (M10)	8
F11	น็อต (M10)	16
F50	แหวนรองแบน (M10)	4

ค่าแรงบิดในการขัน
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb


ทางเลือก: ใช้แผ่นรองพื้น

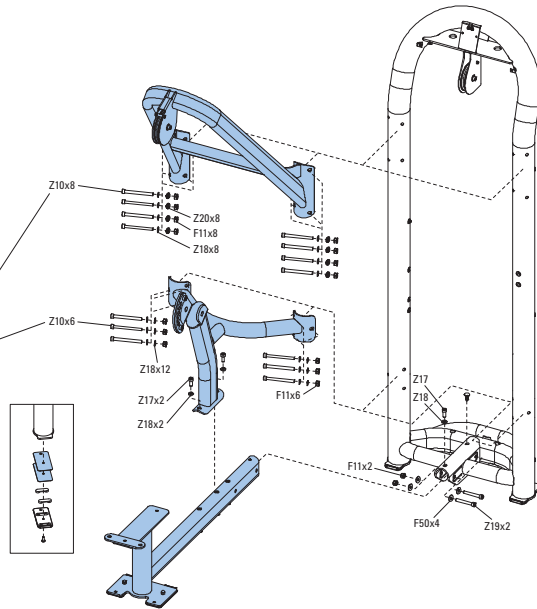


2	ชิ้นส่วน	จำนวน
L11	แหวนรองสปริง (M8)	2
L14	สกรู (M5x16L)	4
L17	โบลท์ (M8x20L)	2
L42	สกรู (M6x15L)	2
F48	แหวนรองแบน (M5)	4
K12	แหวนสแน็ป	4
Z13	แหวนรองแบน (M8)	2

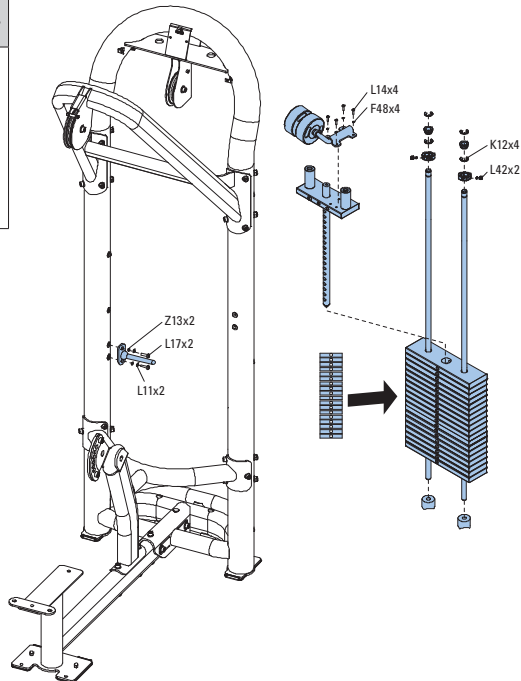

3	ชิ้นส่วน	จำนวน
Z07	โบลท์ (M12x25L)	2
Z08	แหวนรองแบน (M12)	2
Z09	แหวนรองสปริง (M12)	2

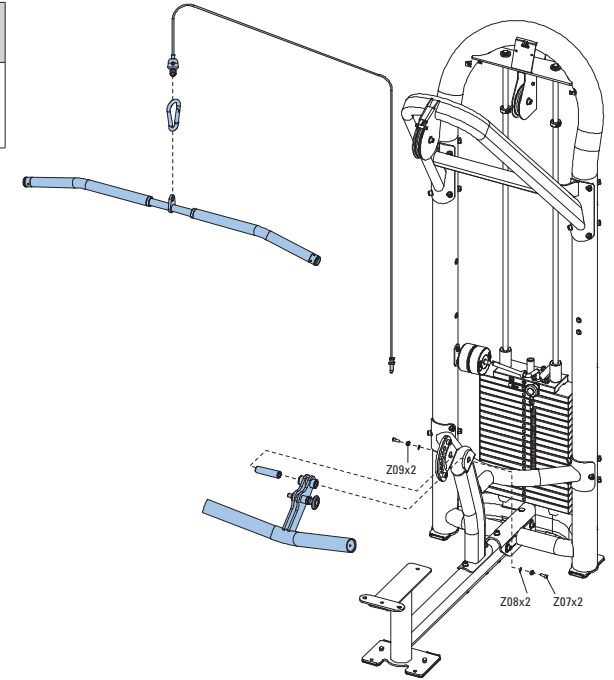


4	ชิ้นส่วน	จำนวน
B26	โบลท์ (M10x25L)	3
Z13	แหวนรองแบน (M8)	2
Z14	โบลท์ (M8x20L)	2

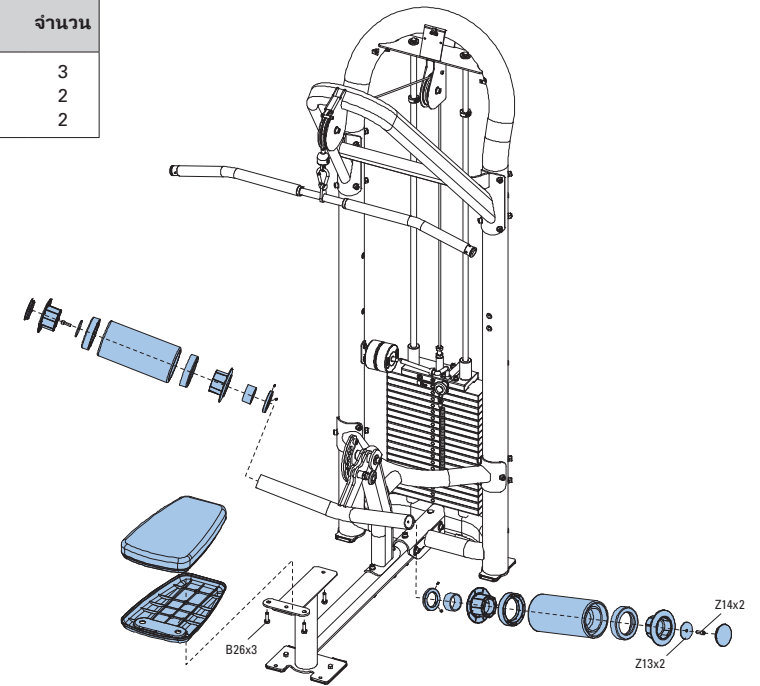



การประกอบ

5	ชิ้นส่วน	จำนวน
B27	โบลท์ (M8x30L)	2
B45	สกรู (M4x12L)	6
B51	แหวนรองแบน (M4)	6
L17	โบลท์ (M8x20L)	2

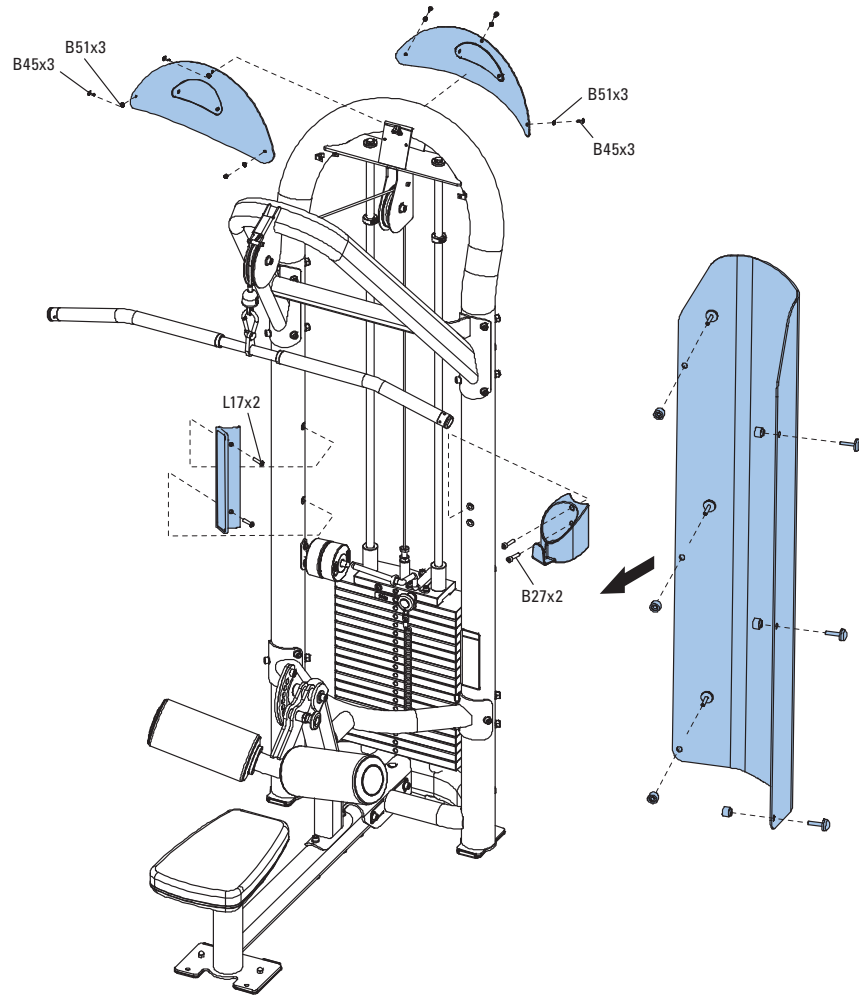

การประกอบเสร็จสมบูรณ์


ลงมือ



الاستخدام الملائم

1. لا تتجاوز حدود الوزن المخصصة لجهاز التمرينات.
2. إن أمكن، فقم بتثبيت نقاط المسك لأغراض السلامة عند ارتفاع ملائم.
3. إن أمكن، فاضبط بطانات المقعد، أو بطانات الساقين، أو بطانات القدمين، أو نطاق ضبط الحركة، أو غيرها من الآليات القابلة للضبط عند مستوى مريح لبدء التمرين. تأكد من أن آلية الضبط معشقة بالكامل لتفادي الحركة غير المقصودة ولعدم التعرض للإصابة.
4. اجلس على المقعد (إن أمكن) واتخذ الوضع الملائم للتمرين.
5. تجنب التمرين باستخدام أوزان زائدة عن تلك التي يمكنك حملها والسيطرة عليها بأمان.
6. بطريقة منصبطة، قم بتنفيذ التمرينات.
7. أعد الأوزان إلى موضع بدء التمرين المدعوم بالكامل.

منطقة تمرين

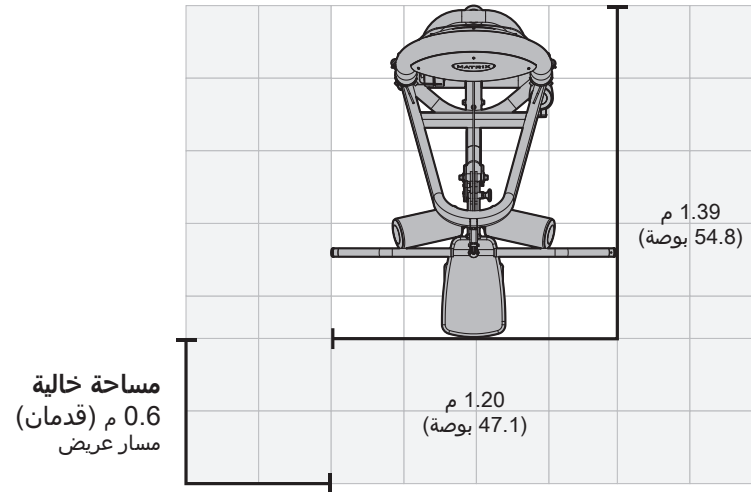

مواصفات المنتج

أقصى وزن للمستخدم	136 كجم / 300 رطل
أقصى وزن للتمرين	138.6 كجم / 305 أرطال
وزن المنتج	245 كجم / 540 رطلاً
حزمة الأوزان	134 كجم / 295 رطلاً
الوزن المضاف	2.3 كجم / 5
الأبعاد الإجمالية (الطول x العرض x الارتفاع)*	139.5 × 120 × 221.5 سم / 55 × 47 × 87 بوصة

* تأكد من وجود خلوص بعرض 0.6 متر (24 بوصة) على الأقل للوصول إلى جهاز القوة من MATRIX والمرور حوله. يرجى ملاحظة أن مساحة 0.91 متر (36 بوصة) هي عرض الخلوص الموصى به من قبل ADA للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

قيم عزم الدوران

مسامير M12 (صامولة Nyloc و Flowdrill)	135 نيوتن متر / 100 قدمًا-رطل
مسامير M10 (صامولة Nyloc و Flowdrill)	77 نيوتن متر / 57 قدمًا-رطل
مسامير M8	25 نيوتن متر / 18 قدمًا-رطل
بلاستيك M8	15 نيوتن متر / 11 قدمًا-رطل
مسامير M6	15 نيوتن متر / 11 قدمًا-رطل
مسامير الوسادة	10 نيوتن متر / 7 أقدام-رطل

قائمة فحوصات الصيانة

الإجراء	التكرار
تنظيف تنجيد الفرش ¹	يوميًا
فحص الكابلات ²	يوميًا
تنظيف قضبان التوجيه	شهريًا
فحص المكونات	شهريًا
فحص الإطار	نصف سنويًا
تنظيف الآلة	حسب الحاجة
تنظيف المقابض ¹	حسب الحاجة
تشحيم قضبان التوجيه ³	حسب الحاجة

¹ يجب تنظيف تنجيد الفرش والمقابض باستخدام صابون خفيف مع الماء أو باستخدام مادة تنظيف خالية من النشادر.

² يجب فحص الكابلات للبحث عن شقوق أو تمزق واستبدالها على الفور إذا كانت موجودة. في حالة وجود ارتخاء مفراط في الكابل، يجب ربطه دون رفع لوحة الرأس.

³ يجب تشحيم قضبان التوجيه باستخدام مادة تشحيم معتمدة على التفلون. ضع مادة التشحيم على قطعة قماش قطني، ثم حركها على قضبان التوجيه لأعلى وأسفل.



الملائم

معلومات السلامة المهمة

يتحمل مشتري منتجات MATRIX وحده دون غيره مسؤولية توجيه جميع الأفراد، سواء كانوا مستخدمين نهائين أم مشرفين، نحو طريقة الاستخدام الصحيحة للجهاز.

ومن الموصى به أن يتم عرض المعلومات التالية على جميع مستخدمي أجهزة تمارين MATRIX قبل الشروع في استخدامها.

لا تستخدم أي جهاز باتباع أي طريقة بخلاف الطريقة الموضحة أو المقصودة من الجهة المصنعة. ويكون إلزامياً استخدام أجهزة ماتريكس بشكل ملائم وبطريقة صحيحة لتفادي التعرض لإصابة.

التركيب

1. سطح مستو وثابت: يجب تركيب أجهزة التمرينات من MATRIX على قاعدة ثابتة وأن تكون مستوية بطريقة صحيحة.
2. تثبيت الأجهزة: توصي الجهة المصنعة بتثبيت جميع أجهزة الشد من MATRIX على الأرضية لضمان التوازن للجهاز والتخلص من الاهتزاز والانقلاب. ويجب أن يتم تنفيذ ذلك بواسطة أحد المقاولين المرخصين.

ويجب أن تكون جميع نقاط التثبيت قادرة على تحمل قوة سحب تبلغ 750 رطلاً (3.3 كيلو نيوتن).

الصيانة

1. لا تستخدم أي جهاز تالف و / أو يحتوي على أجزاء بالية أو معطلة. استخدم قطع الغيار المتوفرة فقط عن طريق وكيل MATRIX المحلي في دولتك.
2. الاحتفاظ بالملصقات والبطاقات: تجنب إزالة الملصقات لأي سبب من الأسباب. وذلك لاحتوائها على معلومات مهمة. وفي حال تعذر قراءتها أو فقدتها، فاتصل بوكيل MATRIX الذي تتعامل معه لاستبدالها.
3. صيانة جميع الأجهزة: تعتبر الصيانة الوقائية العامل الرئيسي لتشغيل الجهاز بسلاسة، وتحملك أدنى مسؤولية. وينبغي فحص الجهاز على فترات منتظمة.
4. تأكد من أن أي شخص (أشخاص) يقوم (يقومون) بعمليات الضبط أو الصيانة أو الإصلاح من أي نوع يكون مؤهلاً (مؤهلين) للقيام بذلك. سيوفر وكلاء MATRIX تمرينات على الخدمة والصيانة في منشآت شركتنا عند طلب ذلك.

ملاحظات إضافية

يجب أن يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن الخاضعة للإشراف حيث ينظم المالك على وجه الخصوص عمليتي الوصول والتحكم. ويكون الأمر متروكاً للمالك فيما يتعلق بتحديد من يسمح له بالوصول إلى جهاز التمرينات هذا. ويجب أن يضع المالك نصب عينيه ما يلي: درجة الموثوقية، والعمر، والخبرة وغيرها من العوامل.

يبقى جهاز التمرينات هذا بمعايير الصناعة فيما يتعلق بالثبات عند استخدامه للغرض المخصص له ووفقاً للإرشادات التي تحددها الجهة المصنعة.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط. جهاز التمرينات هذا منتج من الفئة S (مصمم للاستخدام في بيئة تجارية مثل قاعة اللياقة البدنية). جهاز التمرينات هذا يمثل للمعيارين EN ISO 957-2 و20957-1.

إفراغ العبوة

شكراً لك على شرائك أحد منتجات ماتريكس فيتنس. لقد تم فحص المنتج قبل وضعه في العبوة. ويتم شحن المنتج في أجزاء متعددة لتسهيل تعبئة الآلة في مساحة صغيرة. لذا، تأكد من مطابقة جميع المكونات بالمخططات التفصيلية. توخ الحذر عند إخراج الوحدة من هذا الصندوق وتخلص من مواد التغليف وفقاً للقوانين المحلية. يجب تجميع جهاز التمرينات بواسطة فريق التجميع الذي تم تدريبه على ذلك، أو يمكن تجميعه بشكل مسبق قبل التسليم.

تنبيه

لتفادي التعرض لإصابة ومنع تعرض مكونات الإطار للتلغ، احرص على التماس المساعدة المناسبة عند إخراج أجزاء الإطار من هذا الصندوق. ويرجى الحرص على تركيب الجهاز على قاعدة ثابتة وأن تكون الآلة مستوية بطريقة ملائمة. تأكد من وجود خلوصٍ بعرض 0.6 متر (24 بوصة) على الأقل للوصول إلى جهاز القوة من MATRIX والممرور حوله. يرجى ملاحظة أن مساحة 0.91 متر (36 بوصة) هي عرض الخلوص الموصى به من قبل ADA للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

الضمان

بالنسبة لأمريكا الشمالية، تفضل بزيارة matrixfitness.com للاطلاع على معلومات الضمان بالإضافة إلى استثناءات وقيود الضمان.

تحذير


1. يمكن أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث الوفاة أو التعرض لإصابة جسيمة. اتبع التعليمات التالية لتفادي التعرض لإصابة!
 2. حافظ على جهاز تمرينات القوة هذا بعيداً عن الأطفال الأقل من 14 سنة. يجب الإشراف على المراهقين أثناء استخدام هذا الجهاز في جميع الأوقات.
 2. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية الضعيفة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.
 3. يجب قراءة جميع التحذيرات والإرشادات والحصول على التمرين الملائم قبل الاستخدام. لا تستخدم هذا الجهاز إلا للغرض المخصص له فقط.
 4. افحص الآلة قبل الاستخدام. تجنب مطلقاً استخدام الآلة إذا بدا عليها علامات التلف أو تعذر التشغيل.
 5. لا تتجاوز الوزن المسموح به لهذا الجهاز.
 6. تحقق من أن الدبوس المحدد يتم إدخاله تمامًا في حزمة الوزن.
 7. لا تستخدم هذا الآلة أثناء تثبيت حزمة الوزن في موقع مرتفع.
 8. لا تستخدم أبداً الممثل أو وسائل أخرى لزيادة مقاومة الوزن تدريجياً. استخدم فقط الوسائل التي تقدم مباشرة من الشركة المصنعة.
 9. قد تتعرض للإصابات نتيجة التمرين بطريقة غير صحيحة أو الإفراط في التمرين. توقف عن التمرين إذا شعرت بالدوار أو الدوخة، قم بإجراء فحص طبي قبل بدء برنامج التمرين.
 10. أبق أعضاء الجسد والملابس والشعر وملحقات التمرين بعيدة تماماً عن جميع الأجزاء المتحركة.
 11. يجب استخدام نقاط المسك القابلة للضغط، إن كانت متاحة، طوال الوقت.
 12. عند ضبط أي آلية قابلة للضغط (وضع التوقف، أو وضع المقعد، أو موضع البطانة، أو مدى محدد نطاق الحركة، أو بكرة النقل، أو أي نوع آخر)، تأكد من التعشيق الكامل للآلية القابلة للضغط قبل الاستخدام لتفادي الحركة غير المقصودة.
 13. توصي الجهة المصنعة بتثبيت هذا الجهاز على الأرضية لضمان التوازن والتخلص من الاهتزاز والانقلاب. اعتمد على مقاول معتمد.
 14. إذا لم يتم تثبيت الجهاز على الأرضية: تجنب مطلقاً السماح بتوصيل أحزمة المقاومة أو الحبال أو غيرها من الوسائل بهذا الجهاز، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لإصابة جسيمة. تجنب مطلقاً استخدام هذا الجهاز كدعامة أثناء تنفيذ تمرينات الإطالة، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لإصابة جسيمة.
 15. تجنب إزالة هذا الملصق، واستبدله في حالة تلفه أو صعوبة قراءة محتوياته.

التركيب




الكمية	الجهاز	1
14	مسمار (M10x110-15L)	Z10
3	مسمار (M10x25L)	Z17
23	فلكة مقوسة (M10)	Z18
2	مسمار (M10x80L-35L)	Z19
8	فلكة (M10)	Z20
16	صامولة (M10)	F11
4	فلكة مسطحة (M10)	F50


نارودلا مزع عميقي
45 نيوتن متر / 33 قدما-رطل
35 نيوتن متر / 26 قدما-رطل

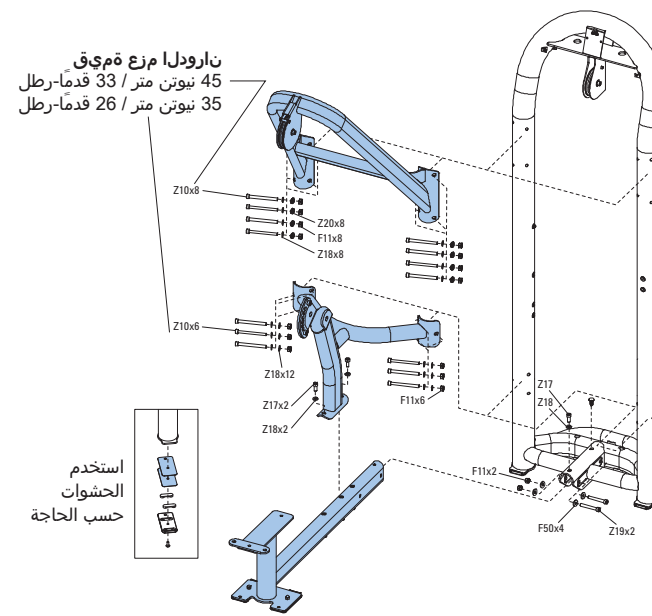


الكمية	الجهاز	3
2	مسمار (M12x25L)	Z07
2	فلكة مسطحة (M12)	Z08
2	فلكة نابضية (M12)	Z09

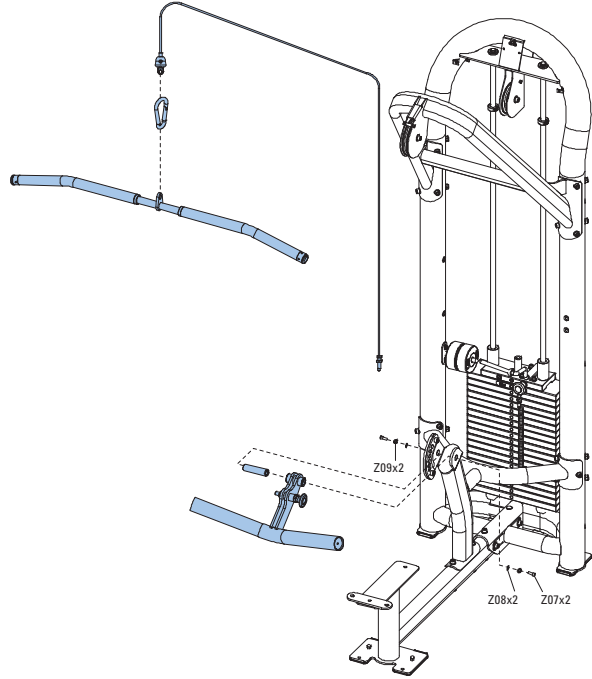

الكمية	الجهاز	2
2	فلكة نابضية (M8)	L11
4	برغي (M5x16L)	L14
2	مسمار (M8x20L)	L17
2	برغي (M6x15L)	L42
4	فلكة مسطحة (M5)	F48
4	حلقة الخاطف	K12
2	فلكة مسطحة (M8)	Z13

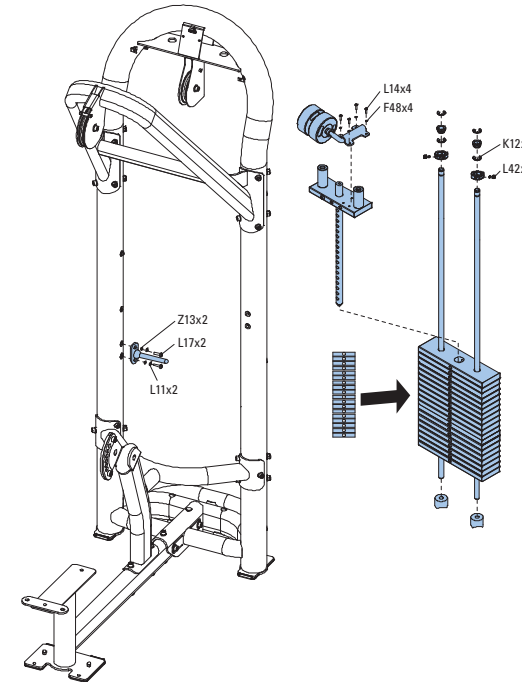


الكمية	الجهاز	4
3	مسمار (M10x25L)	B26
2	فلكة مسطحة (M8)	Z13
2	مسمار (M8x20L)	Z14

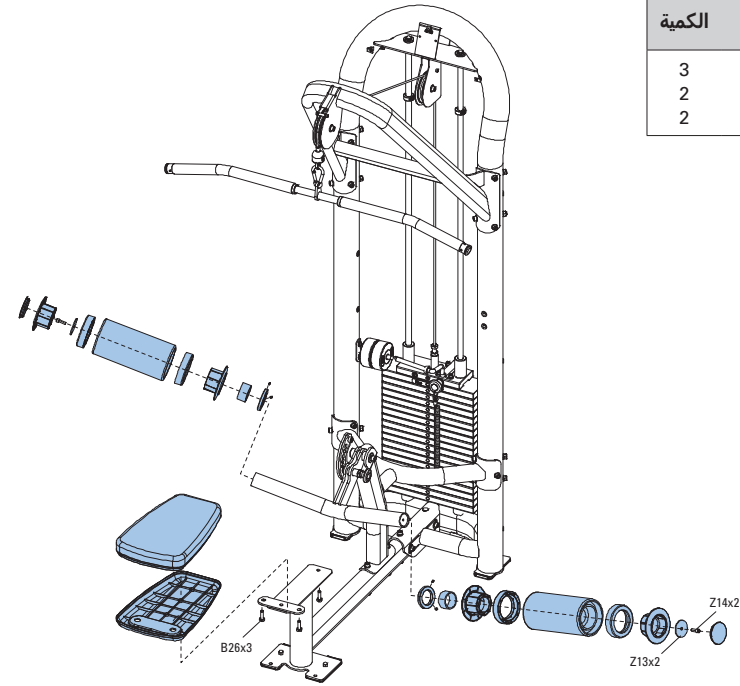

التركيب



الكمية	الجهاز	5
2	مسمار (M8x30L)	B27
6	برغي (M4x12L)	B45
6	فلكة مسطحة (M4)	B51
2	مسمار (M8x20L)	L17

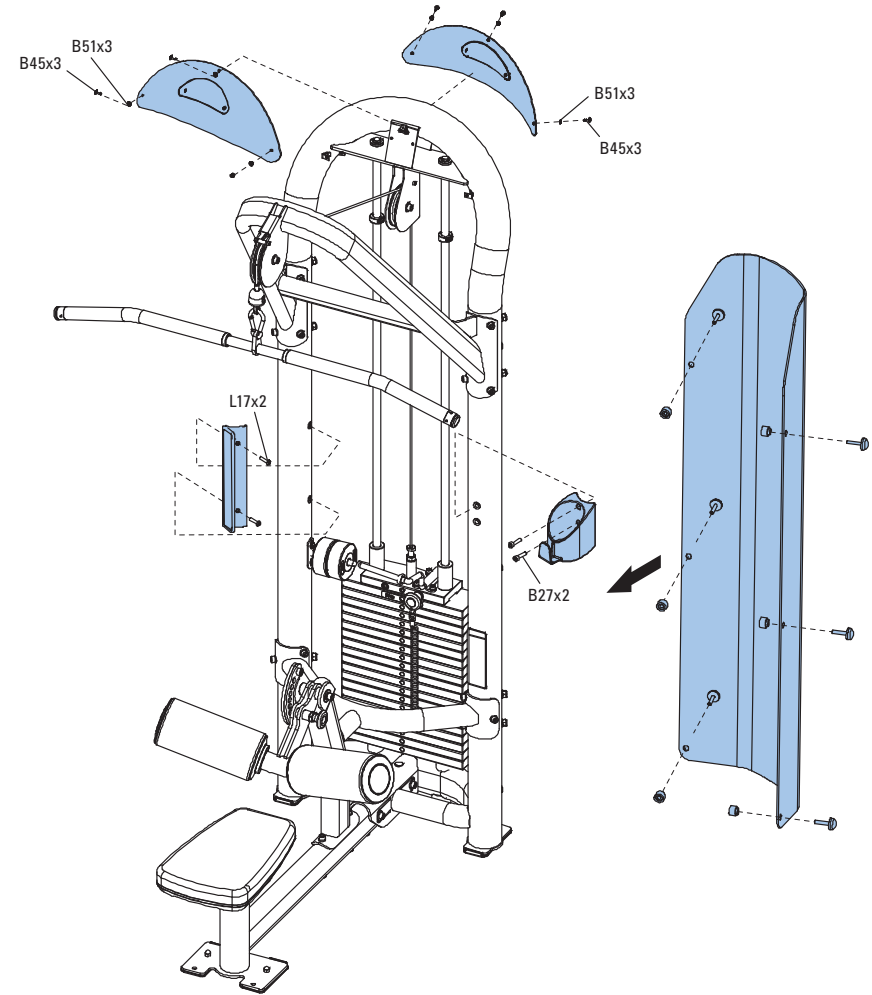

لافتة



تم استكمال التجميع




ÜRÜN BİLGİLERİ

DOĞRU KULLANIM

1. Egzersiz aletinin ağırlık limitlerini aşmayın.
2. Gerekliyse, güvenlik stoplarını uygun yüksekliğe ayarlayın.
3. Gerekliyse, koltuk pedlerini, bacak pedlerini, ayak pedlerini, hareket aralığı ayarını veya diğer ayar mekanizmalarını rahat bir başlangıç pozisyonuna ayarlayın. İstenmeyen hareketleri ve yaralanmaları önlemek için ayarlama mekanizmasının tamamen devreye girdiğinden emin olun.
4. (Varsa) sehpa oturur ve egzersiz için uygun pozisyona geçin.
5. Güvenle kaldırıp kontrol edebileceğinizden daha fazla ağırlık kullanarak egzersiz yapmayın.
6. Kontrollü bir şekilde egzersiz yapın.
7. Ağırlığı tam destekli başlangıç pozisyonuna döndürün.

EGZERSİZ ALANI

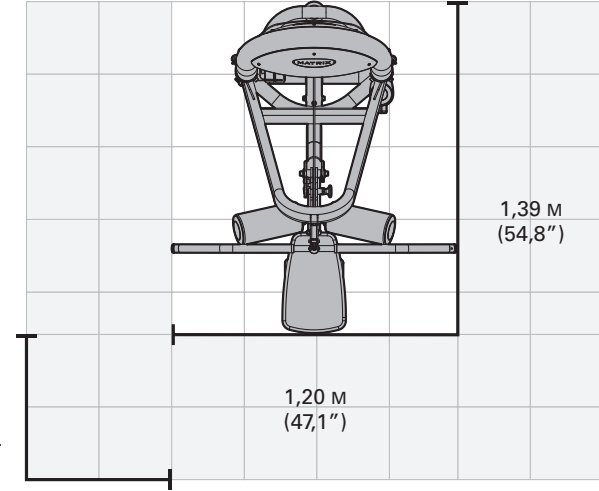

SERBEST ALAN
0,6 M (2 FT)
GENİŞ YOL

BAKIM LİSTESİ

EYLEM	SIKLIK
Döşeme temizliği ¹	Her gün
Kabloların kontrolü ²	Her gün
Kılavuz çubukların temizliği	Ayda bir
Donanımın kontrolü	Ayda bir
Çerçevenin kontrolü	Yılda iki kez
Makinenin temizliği	Gerektiğinde
Elciklerin temizliği ¹	Gerektiğinde
Kılavuz çubukların yağlanması ³	Gerektiğinde

¹ Döşeme ve elcikler, yumuşak bir sabun ve su veya amonyak içermeyen bir temizleyici ile temizlenmelidir.

² Kablolarda çatlak veya yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli ve varsa hemen değiştirilmelidirler. Aşırı gevşek olmaları durumunda, kablo başlık plakası kaldırılmadan gerilmelidir.

³ Kılavuz çubuklar Teflon bazlı bir madde ile yağlanmalıdır. Yağlayıcı maddeyi pamuklu bir beze uyguladıktan sonra kılavuz çubukları üzerinde yukarı aşağı hareket ederek yağlayın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Azami Kullanıcı Ağırlığı	136 kg / 300 lbs
Maksimum Antrenman Ağırlığı	138,6 kg / 305 lbs
Ürün Ağırlığı	245 kg / 540 lbs
Weight Stack	134 kg / 295 lbs
Incremental Weight (2)	2,3 kg / 5 lbs
Genel Ölçüler (U x G x Y)*	139,5 x 120 x 221,5 cm / 55 x 47 x 87"

* MATRIX kuvvet ekipmanına erişim ve etrafından geçiş için en az 0,6 metrelik (24") bir açıklık bırakın. Lütfen unutmayın, 0,91 metre (36") tekerlekli sandalyedeki kişiler için Amerikan Engelliler Kanunu tarafından önerilen açıklıktır.

TORK DEĞERLERİ

M12 Cıvata (Fiberli Somun ve Flowdrill)	135 Nm / 100 ft-lbs
M10 Cıvata (Fiberli Somun ve Flowdrill)	77 Nm / 57 ft-lbs
M8 Cıvata	25 Nm / 18 ft-lbs
M8 Plastik	15 Nm / 11 ft-lbs
M6 Cıvata	15 Nm / 11 ft-lbs
Ped Cıvataları	10 Nm / 7 ft-lbs



ÜRÜN BİLGİLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Son kullanıcı veya gözetimci olsun, herkesin ekipmanın doğru kullanımı hakkında bilgilendirilmesi, tamamen MATRIX ürünlerini satın alan kişinin sorumluluğundadır.

MATRIX egzersiz ekipmanının tüm kullanıcılarına, kullanımdan önce aşağıdaki bilgilerin verilmesi tavsiye edilmektedir.

Hiçbir ekipmanı üreticinin tasarladığı veya amaçladığı kullanımlar dışında kullanmayın. Yaralanmaları önlemek için, MATRIX ekipmanının doğru kullanılması mutlak gereklidir.

KURULUM

1. SAĞLAM VE DÜZ YÜZEY: MATRIX egzersiz ekipmanı sabit bir zemin üzerine kurulmalı ve uygun şekilde düz hizada olmalıdır.
2. GÜVENLİK EKİPMANI: Üretici, dengeleme ve sallanma veya devrilmeyi önlemek amacıyla, tüm sabit MATRIX kuvvet ekipmanlarının zemine sabitletmesini önermektedir. Bu işlem, yetkili bir yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.
3. Devrilme riski nedeniyle hiçbir koşulda ekipmanı zemin üzerinde iterek kaydırmamalısınız. Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi OSHA tarafından önerilen uygun malzeme kullanım tekniklerini ve ekipmanları kullanın.

Tüm bağlantı noktaları 750 lbs ağırlığa kadar dayanıklıdır. Çekme kuvveti (3,3 kN).

BAKIM

1. Hasarlı veya aşınmış veya kırılmış parçaları olan ekipmanları KULLANMAYIN. Yalnızca ülkenizin yerel MATRIX satıcısı tarafından sağlanan yedek parçaları kullanın.
2. ETİKETLERİN VE İSİM PLAKALARININ BAKIMI: Etiketleri kesinlikle yerlerinden çıkarmayın. Önemli bilgiler içermektedirler. Okunaksız veya eksik olmaları halinde, değiştirmek için MATRIX bayinizle iletişime geçin.
3. TÜM EKİPMANLARIN BAKIMI: Önleyici bakım, ekipmanın sorunsuz çalışmasının ve sorumluluklarınızı en az seviyede tutmanın anahtarıdır. Ekipmanın düzenli aralıklarla denetlenmesi gereklidir.
4. Bir ayarlama ya da bakım veya onarım yapan kişilerin bu işlemler için yetkili olduklarından emin olun. MATRIX bayileri talep üzerine kurumsal tesisimizde servis ve bakım eğitimi verecektir.

EK NOTLAR

Bu ekipman sadece erişim ve kontrolün özellikle ekipman sahibi tarafından düzenlendiği denetimli alanlarda kullanılmalıdır. Bu egzersiz ekipmanına kimlerin erişiminin olacağı da mal sahibinin kararıdır. Mal sahibi, bu kararı verirken, kullanıcıların güvenilirlik derecesi, yaşı, deneyimi vb. gibi bilgileri dikkate almalıdır.

Bu egzersiz ekipmanı, üretici tarafından sağlanan talimatlara uygun olarak öngörülen amaç ile kullanılması halinde stabilite endüstri standartlarını karşılamaktadır.

Bu ekipman yalnızca kapalı alanda kullanım içindir. Bu egzersiz ekipmanı, S Sınıfı bir üründür (spor salonu gibi ticari bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır). Bu egzersiz ekipmanı EN ISO 20957-1 ve EN 957-2 ile uyumludur.

PAKETİ AÇMA

MATRIX Fitness ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürün paketlenmeden önce denetime tabi tutulmuştur. Makinenin kompakt paketlenmesini kolaylaştırmak için birden fazla parça halinde gönderilmektedir. Montajdan önce, patlatılmış diyagram ile karşılaştırarak, tüm parçaların mevcut olduğunu onaylayın. Birimi kutudan dikkatlice çıkarın ve paketleme malzemelerini yerel düzenlemelere göre imha edin. Egzersiz cihazı, eğitimli bir montaj ekibi tarafından veya teslimattan önce kurulmalıdır.

DİKKAT

Yaralanmaları ve çerçeve bileşenlerine zararları önlemek için, çerçeve parçalarını bu kutudan çıkarırken uygun şekilde yardım alın. Lütfen ekipmanı sağlam bir zemin üzerine kurduğunuzdan ve makineyi düzgün bir şekilde dengelediğinizden emin olun. MATRIX kuvvet ekipmanına erişim ve etrafından geçiş için en az 0,6 metrelik (24") bir açıklık bırakın. Lütfen unutmayın, 0,91 metre (36") tekerlekli sandalyedeki kişiler için Amerikan Engelliler Kanunu tarafından önerilen açıklıktır.

GARANTİ

Türkiye için geçerli garanti bilgileri ve garanti harici durumlar ve sınırlamalar için lütfen matrixfitness.com adresini ziyaret edin.

UYARI

BU DONANIMDA ÖLÜM VEYA CİDDİ YARALANMALAR OLUŞABİLİR. YARALANMALARINI ÖNLEMELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖNERİLERİ UYGULAYIN!

1. 14 yaşın altındaki çocukları bu kuvvet antrenmanı ekipmanından uzak tutun. 20 yaş altı gençler, bu ekipmanı kullanırken her zaman gözetim altında bulundurulmalıdır.
2. Bu ekipman, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ekipmanın kullanımına ilişkin bir denetim veya talimat olmadığı sürece, düşük fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin kullanımını için tasarlanmamıştır.
3. Kullanımdan önce tüm uyarılar ve talimatlar okunmalı ve gerekli bilgilendirmeler alınmalıdır. Bu ekipmanı YALNIZCA tasarlandığı amaç için kullanın.
4. Kullanmadan önce makineyi inceleyin. Hasarlı veya çalışmayacak halde görünüyorsa makineyi KULLANMAYIN.
5. Bu ekipmanın ağırlık kapasitesini aşmayın.
6. Seçtiğiniz pimin ağırlıklara iyice yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.
7. Ağırlıklar yüksek konumdayken pim takılmışsa, makineyi ASLA kullanmayın.
8. Ağırlık direncini kademeli olarak artırmak için ASLA dambıl veya benzeri araçları kullanmayın. Yalnızca doğrudan üretici tarafından sağlanan araçları kullanın.
9. Hatalı veya aşırı antrenman nedeniyle yaralanmalar oluşabilir. Bayılacak gibi olmanız veya başınızın dönmesi halinde çalışmayı bırakın. Bir egzersiz programına başlamadan önce tıbbi bir muayene yapın.
10. Vücudunuzu, kıyafetlerinizi, saçınızı ve fitness aksesuarlarınızı tüm hareketli parçalardan uzak tutun.
11. Mevcutsa, ayarlanabilir durdurucular her zaman kullanılmalıdır.
12. Ayarlanabilir bir mekanizmayı ayarlarken (durma konumu, oturma konumu, ped konumu, hareket sınırlayıcı aralığı, kasnak taşıyıcı veya diğer), ayarlanabilir mekanizmanın istenmeyen hareketleri önleyecek şekilde devrede olup olmadığını kontrol edin.
13. Üretici, dengeleme ve sallanma veya devrilmeyi önlemek amacıyla bu ekipmanın zemine sabitletmesini önermektedir. Yetkili bir yüklenici şirket ile çalışın.
14. Ekipman zemine sabit DEĞİLSE: Ciddi yaralanmalara neden olabileceğinden, ASLA direnc kayışlarının, halatların veya diğer araçların bu ekipmana bağlanmasına izin vermayın. Ciddi yaralanmalara neden olabileceğinden, bu ekipmanı esneme hareketleri sırasında ASLA destek amaçlı kullanmayın.
15. BU ETİKETİ ÇIKARMAYIN. HASARLI VEYA OKUNAKSIZ İSE DEĞİŞTİRİN.




KURULUM


1	Donanım	Adet
Z10	Civata (M10x110L-15L)	14
Z17	Civata (M10x25L)	3
Z18	Ark Rondela (M10)	23
Z19	Civata (M10x80L-35L)	2
Z20	Rondela (M10)	8
F11	Somun (M10)	16
F50	Düz Rondela (M10)	4

Tork değerleri
45 Nm / 33 ft-lb
35 Nm / 26 ft-lb


Şimlari gerektiği gibi kullanın

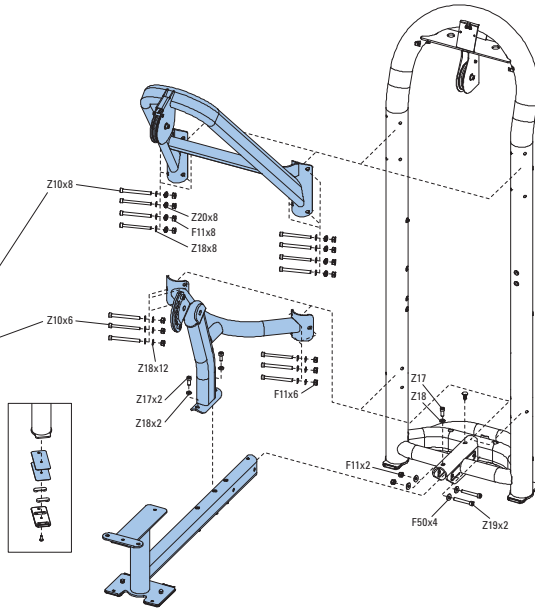


2	Donanım	Adet
L11	Yaylı Rondela (M8)	2
L14	Vida (M5x16L)	4
L17	Civata (M8x20L)	2
L42	Vida (M6x15L)	2
F48	Düz Rondela (M5)	4
K12	Yapış halka	4
Z13	Düz Rondela (M8)	2

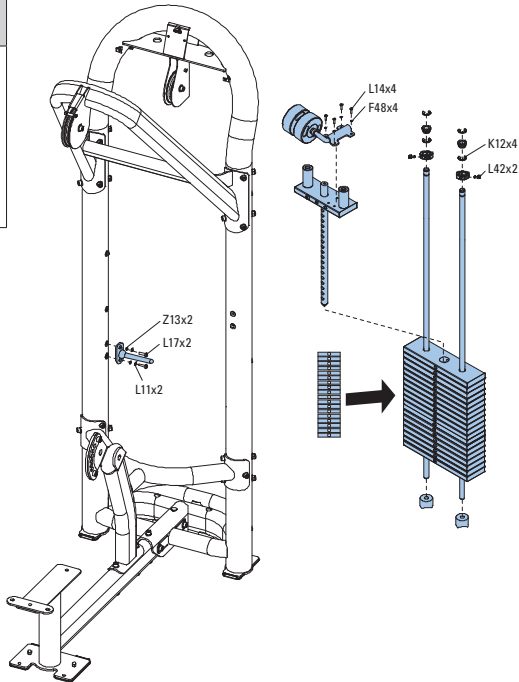

3	Donanım	Adet
Z07	Civata (M12x25L)	2
Z08	Düz Rondela (M12)	2
Z09	Yaylı Rondela (M12)	2

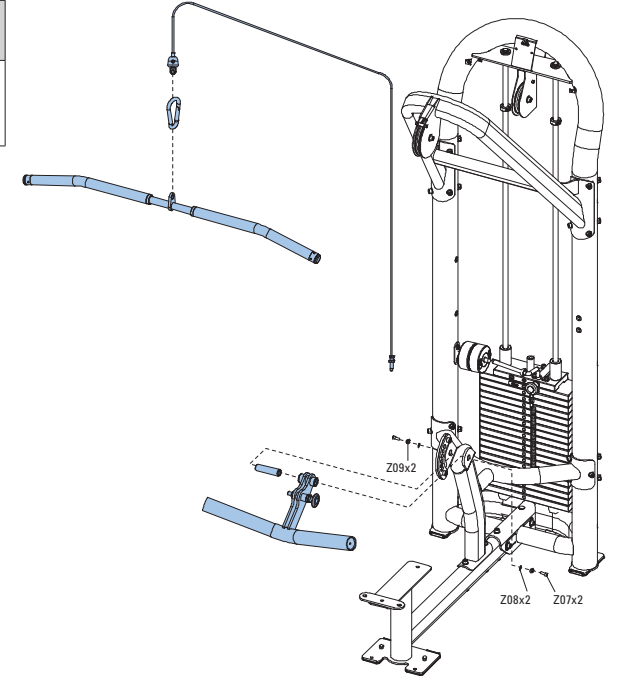


4	Donanım	Adet
B26	Civata (M10x25L)	3
Z13	Düz Rondela (M8)	2
Z14	Civata (M8x20L)	2

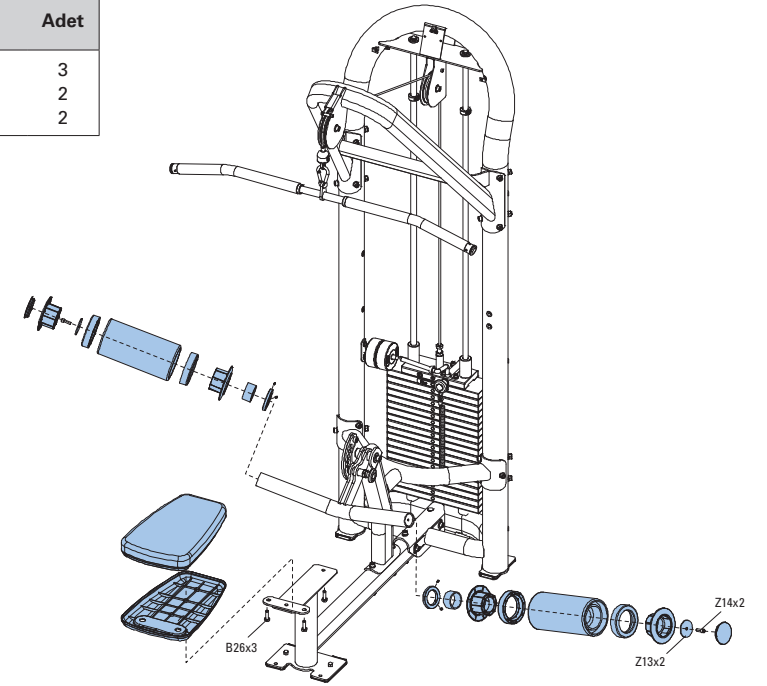



KURULUM

5	Donanım	Adet
B27	Cıvata (M8x30L)	2
B45	Vida (M4x12L)	6
B51	Düz Rondela (M4)	6
L17	Cıvata (M8x20L)	2

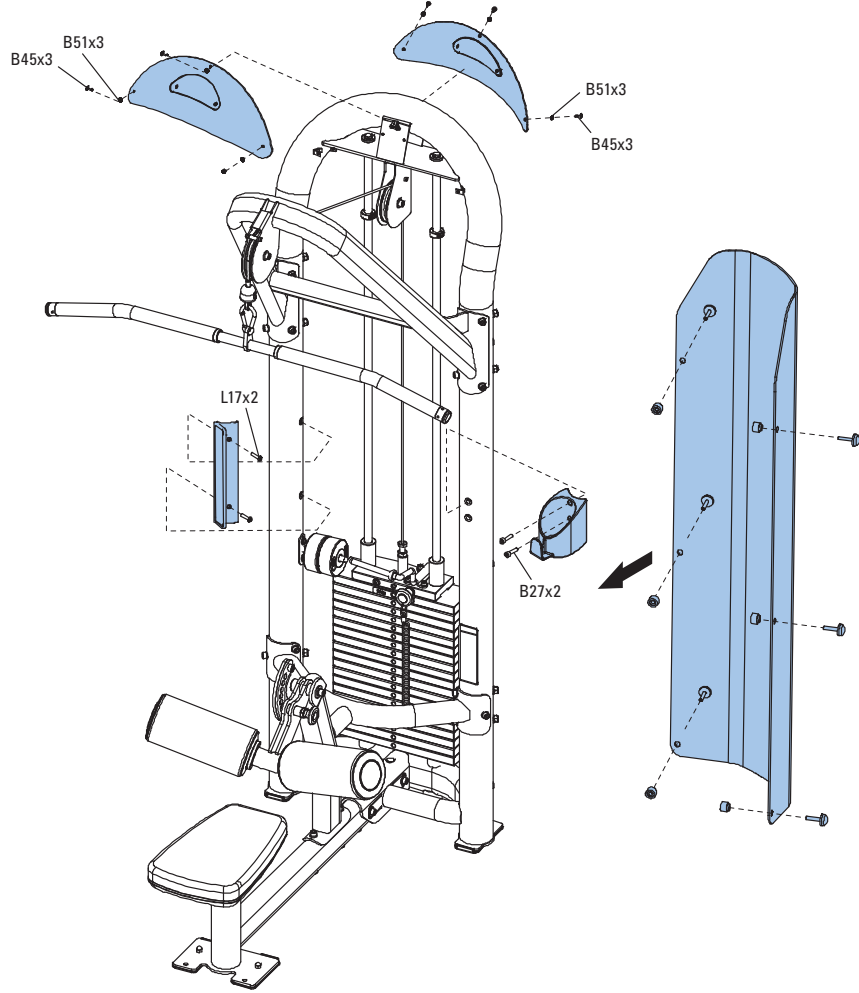

KURULUM TAMAMLANDI

LEVHASI



MATRIX



G3-S30-03

© 2022 Johnson Health Tech
Rev 1.0 C

Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Languages