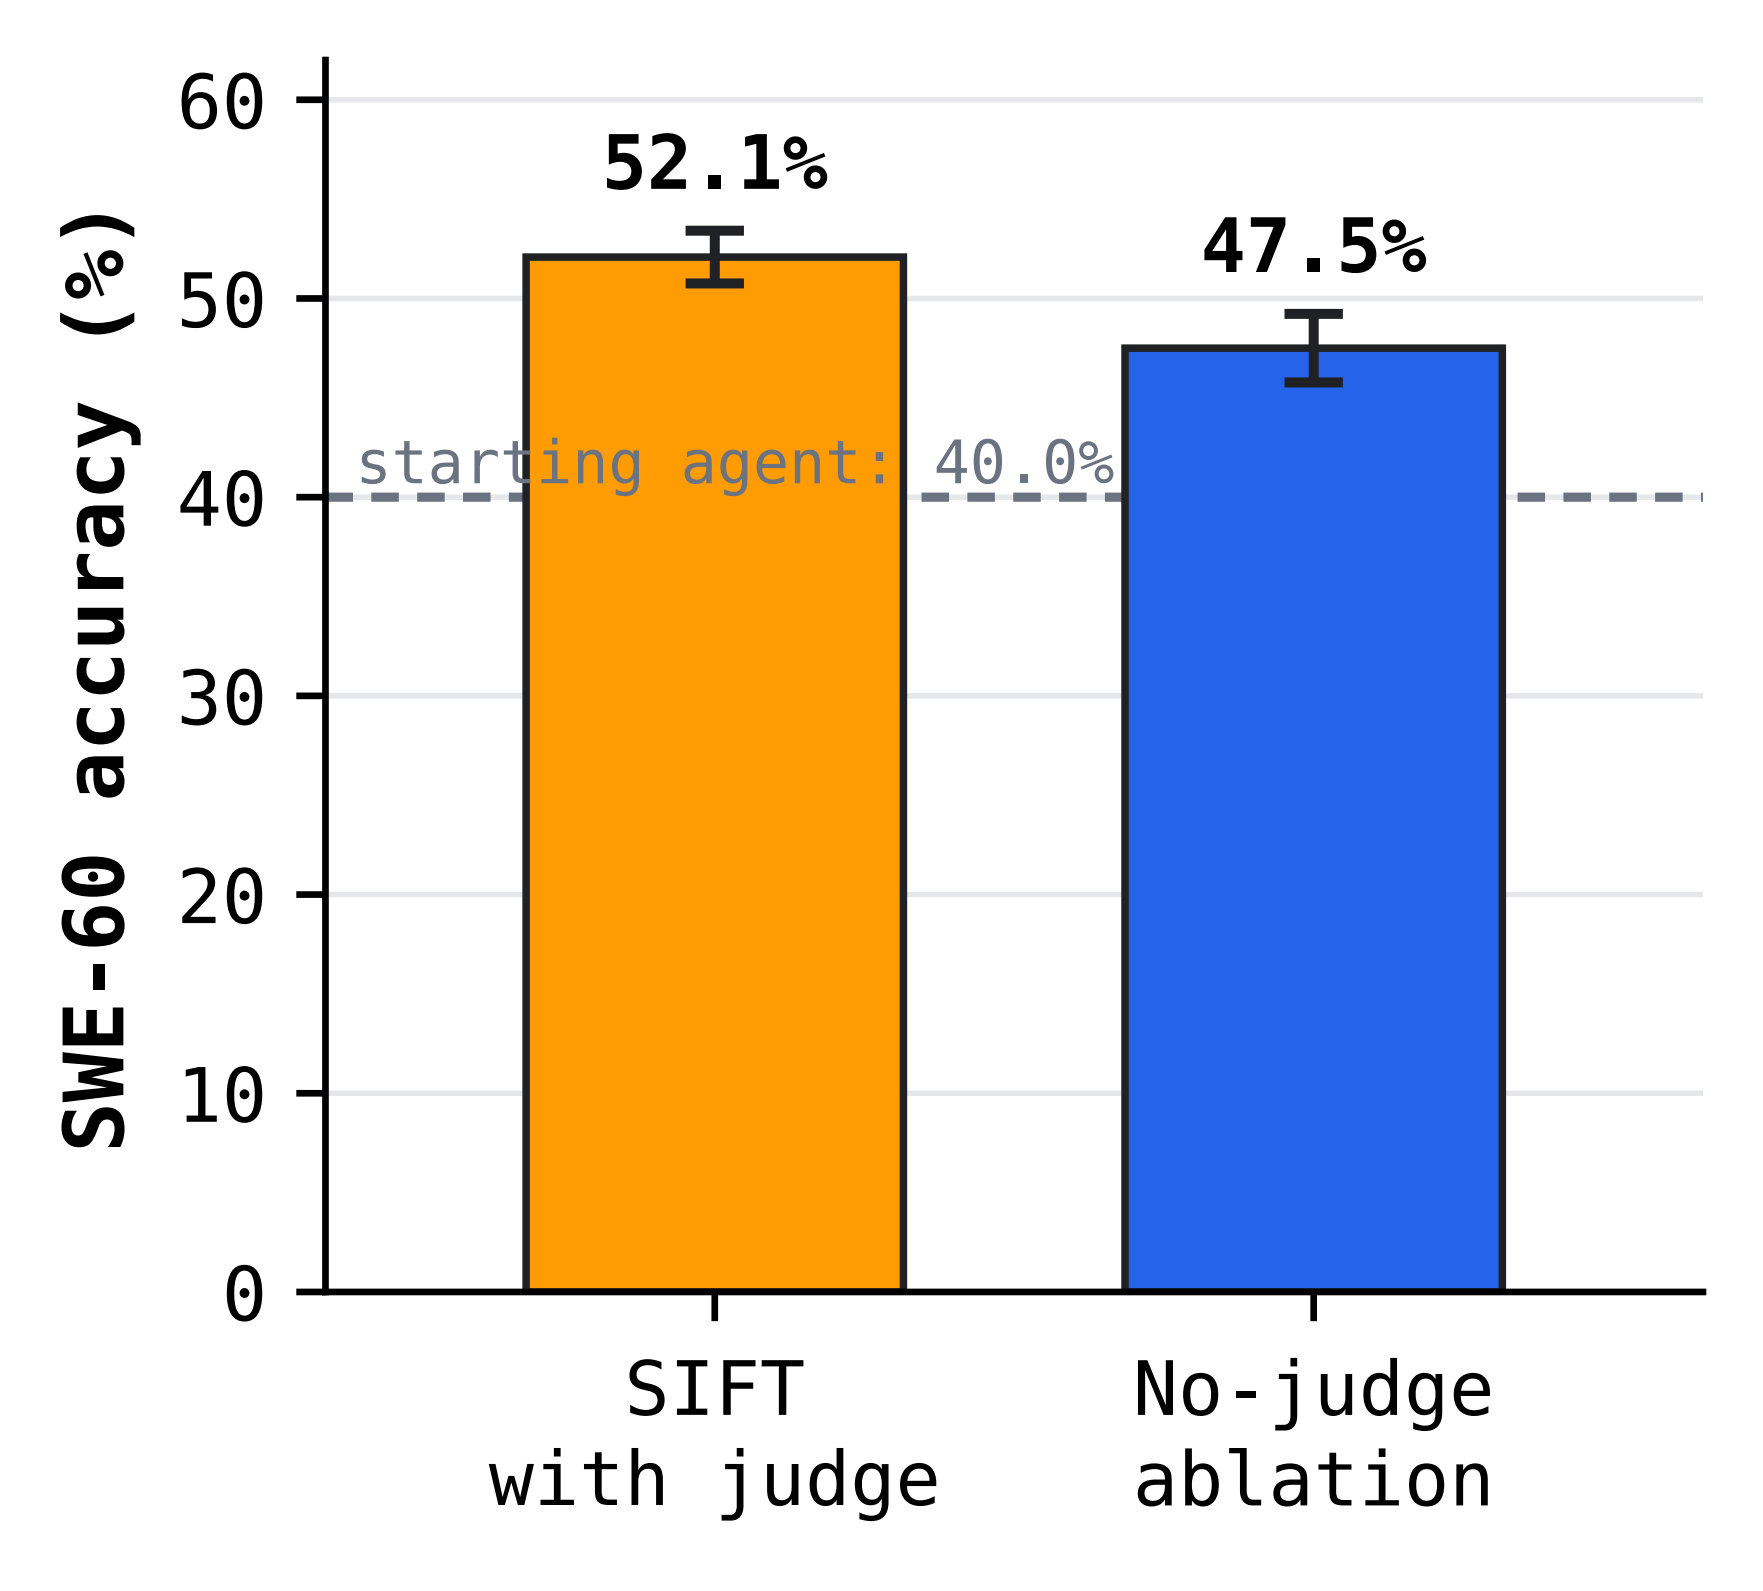
SWE-60 accuracy (%)
60
50
40
30
20
10
0
52.1%
47.5%
starting agent: 40.0%
SIFT
with judge
No-judge
ablation