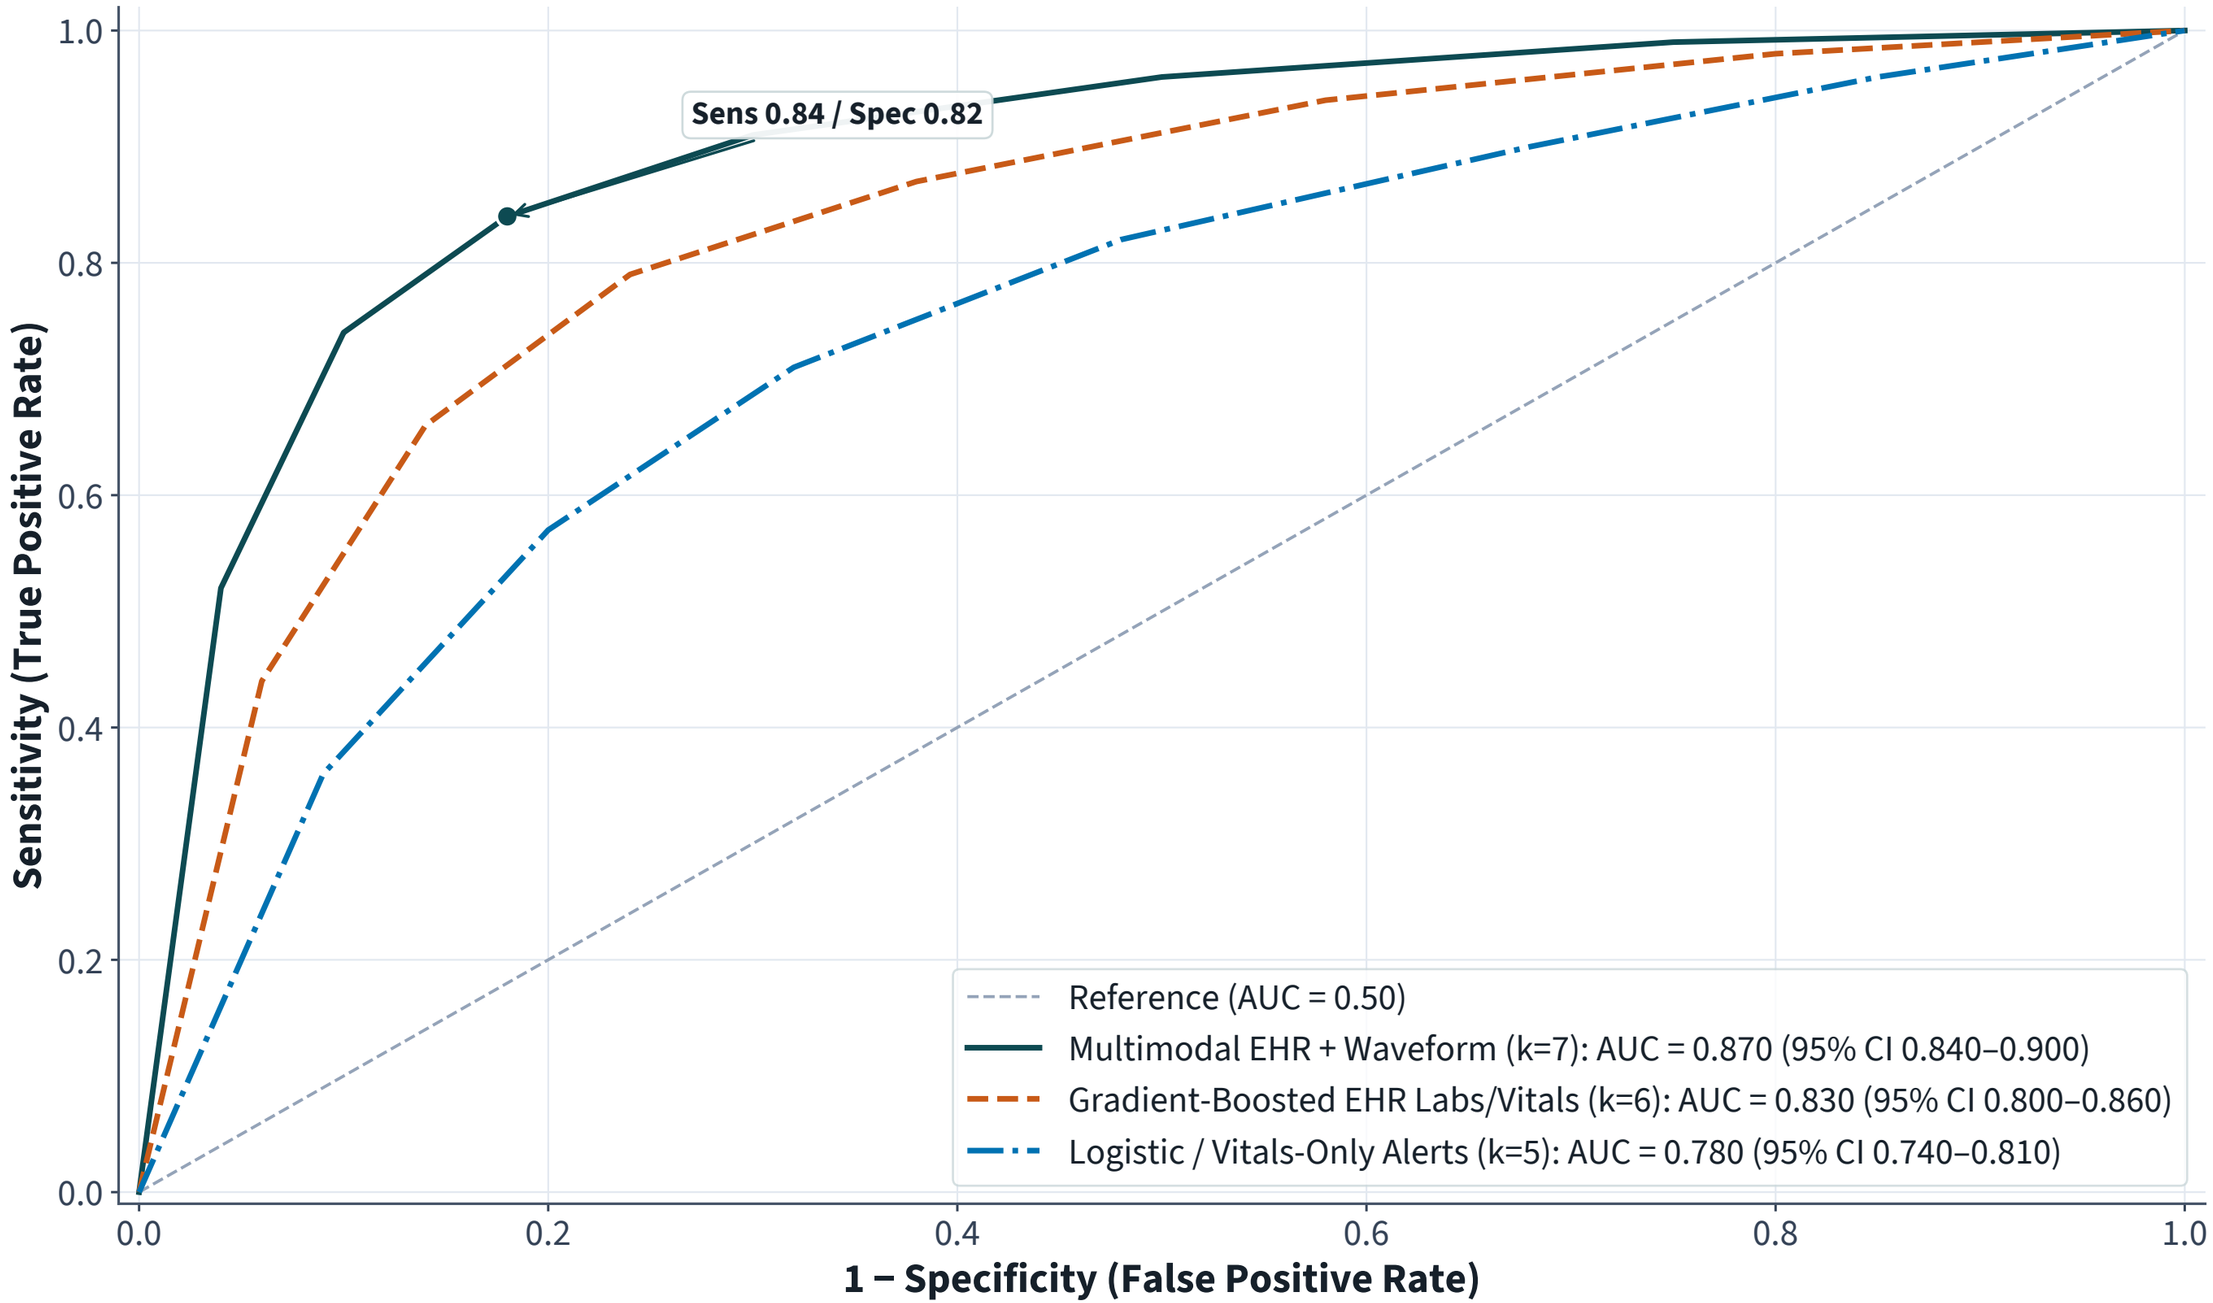
Sens 0.84 / Spec 0.82
Sensitivity (True Positive Rate)
1 − Specificity (False Positive Rate)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Reference (AUC = 0.50)
Multimodal EHR + Waveform (k=7): AUC = 0.870 (95% CI 0.840–0.900)
Gradient-Boosted EHR Labs/Vitals (k=6): AUC = 0.830 (95% CI 0.800–0.860)
Logistic / Vitals-Only Alerts (k=5): AUC = 0.780 (95% CI 0.740–0.810)