GCOOP LAPY V

지쿱 라피 V

· 본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2022 GCOOP All Rights Reserved.

GCOOP

Important Notice

㈜**지쿱은** 지쿱은 모든 회원 분이 과대광고로 인하여, 피해가 가지 않도록 건전한 광고 문화에 힘쓰고 있습니다.
아래의 관련 법률을 참고하시어, 허위 과대광고로 이어지지 않도록 많은 협조 부탁드립니다.

본 자료는 내부 교육을 위한 자료로 외부 반출 및 별도 게시를 할 수 없습니다.

의료기기 과대 광고에 대한 법률

1. 의료기기의 명칭・제조방법・성능 이나 효능 및 효과 또는 그 원리에 관한 거짓 또는 과대광고
2. 법 제6조제2항 또는 법 제15조제2항에 따라 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않은 의료기기의 명칭・제조방법・성능이나 효능 및 효과에 관한 광고
3. 의료기기의 부작용을 전부 부정하는 표현 또는 부당하게 안전성을 강조하는 표현의 광고
4. 허가 받은 의료기기의 효능 및 효과 등과 관련하여 의학적 임상 결과, 임상시험성적서, 관련 논문 또는 학술 자료를 거짓으로 인용하거나 특허 인증을 받은 것처럼 거짓으로 표시한 광고
5. 의사, 치과의사, 한의사, 수의사 또는 그 밖의 자가 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 보증한 것으로 오해할 염려가 있는 기사를 사용한 광고
6. 의사, 치과의사, 한의사, 약사, 한약사, 대학교수 또는 그 밖의 자가 의료기기를 지정・공인・추천・지도 또는 사용하고 있다는 내용 등의 광고. 다만, 국가, 지방자치단체, 그 밖에 공공단체가 국민보건의 목적으로 지정하여 사용하고 있는 내용의 광고의 경우에는 그렇지 않다.
7. 외국 제품을 국내 제품으로 또는 국내 제품을 외국 제품으로 오인하게 할 우려가 있는 광고
8. 사용자의 감사장 또는 체험담을 이용하거나 구입・주문이 쇄도한다거나 그 밖에 이와 유사한 표현을 사용한 광고
9. 효능・효과를 광고할 때에 "이를 확실히 보증한다"라는 내용 등의 광고 또는 "최고", "최상" 등의 절대적 표현을 사용한 광고
10. 의료기기를 의료기기가 아닌 것으로 오인하게 할 우려가 있는 광고
11. 특정 의료기관의 명칭과 진료과목 및 연락처 등을 적시하여 의료기관 등이 추천하고 있는 것처럼 암시하는 광고
12. 의료기기의 성능이나 효능 및 효과를 암시하는 기사, 사진, 도안 또는 그 밖의 암시적 방법을 이용한 광고
13. 효능이나 성능을 광고할 때에 사용 전후의 비교 등으로 그 사용 결과를 표시 또는 암시하는 광고
14. 사실 유무와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방하는 것으로 의심되는 광고
15. 의료기기에 관하여 낙태를 암시하거나 외설적인 문서나 도안을 사용한 광고
16. 의료기기의 효능・효과 또는 사용 목적과 관련되는 병의 증상이나 수술 장면을 위협적으로 표시하는 광고

[발췌] 의료기기법시행규칙 제45조 (의료기기 광고의 범위 등) < 개정 2015.7.29 >



| 라피 V 의미 |

라피(LAPY)는 LASER +THERAPY 의 합성어로
레이저 치료를 의미하고 있음.
V는 로마숫자로 기존 4세대보다 업그레이드된 5세대를 의미하고 있음.

| 지큡 라피 V 개발 배경 |

① 기존 제품의 단점을 보완한 차세대 제품 필요 (저온화상 등)
② 당사 제품으로서 시장에서의 경쟁력 확보 필요 (특허)

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

GCOOP LAPY V



고효율 레이저 18개 + 근적외선 30개 + 기존 동일 360개
= 총 408개 적용

통증 완화 목적 의료용레이저조사기
피부질환 완화 목적 개인용광선조사기
근육통 완화 목적 개인용적외선조사기


한국 의료기기 허가 완료

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

LAPY V

의료용레이저 조사기(3등급)



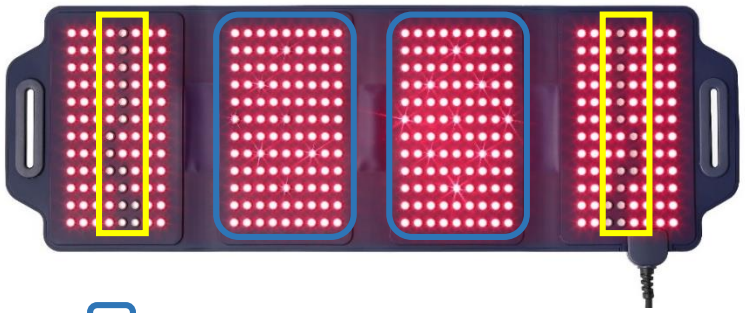

고효율 레이저 18개 탑재

870nm 적외선 파장 30개 탑재
(눈에 보이지 않음)

의료기기 미국 FDA 의료기기 2레벨 등록
의료용레이저조사기 3등급

효능 [1차] 통증완화
[2차] 슬관절 퇴행성 관절염 통증 완화 (임상진행 예정)

제조원 제너럴바이오㈜ (의료기기제조업 GMP 획득 2022. 10. 17.)

품목명/등급	의료용레이저조사기(3등급)
제품명/모델명	LAPY V / GB-KR21001MDR
FDA 등록번호	D469830
사용목적	1. 의료용레이저조사기: 통증완화를 목적으로 방사되는 광에너지(레이저)를 피부에 쬐어 사용하는 기구 2. 개인용 광선조사기: 광선(적색광)을 이용하여 피부질환을 완화하는데 사용하는 기구 3. 개인용 적외선조사기: 적외선 에너지를 인체에 조사하여 근육통 완화에 사용하는 기구
저출력 반도체 소자	408개
안전제어장치	과부하 차단장치, 온도제어장치
정격전압/정격주파수/소비전력	220V / 60Hz / 40VA
광원	Laser diode : 3.0mW ± 20%, 650nm 적색 LED : 12.0mW/cm² ± 20%, 660nm 적외선 LED : 3.0m W/cm² ± 20%, , 870nm
소비전력	12VA
제품중량	1,051g / 1Set
제조번호, 제조일자	제품 컨트롤러 뒷면 참조

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.


종합 경쟁력 우세 | 디자인, Free Voltage, 성능, 편의성, 착용감, 수납성 등


구분	LAPY V	기존제품 (RAPA 402 VIP)	경쟁력
디자인			우세
핵심 부품	광원 408개 (고효율 Laser 18개 + 적외선 30개)	광원 402개	우세
착용밀착성	Flexible 실리콘 : 밀착성 good	Hard 플라스틱 : 밀착성 bad	우세
수납성	4단 접이로 수납 편리	6단 접이로 수납 불편	우세
휴대 사용성	전용 USB 케이블 (보조배터리 20000mAh 12V 출력)	불가	우세
Free Voltage	가능 : 전세계 수출 공용	불가 : 지역별 전원 모델 필요	우세

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

다양한 광원을 복합 적용

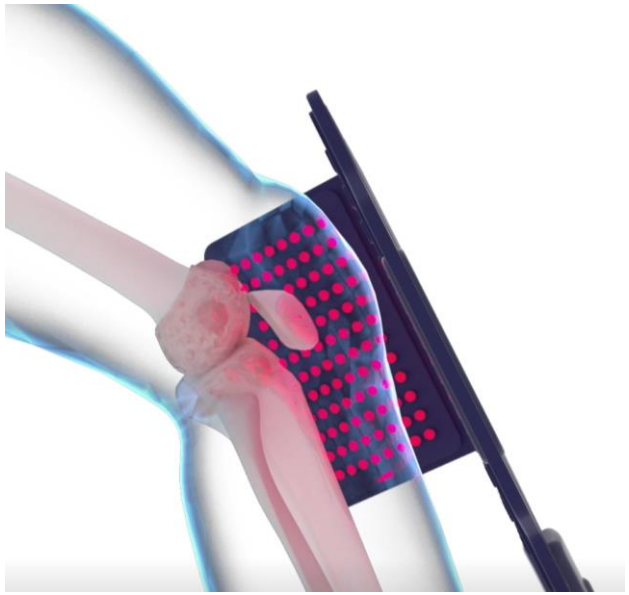


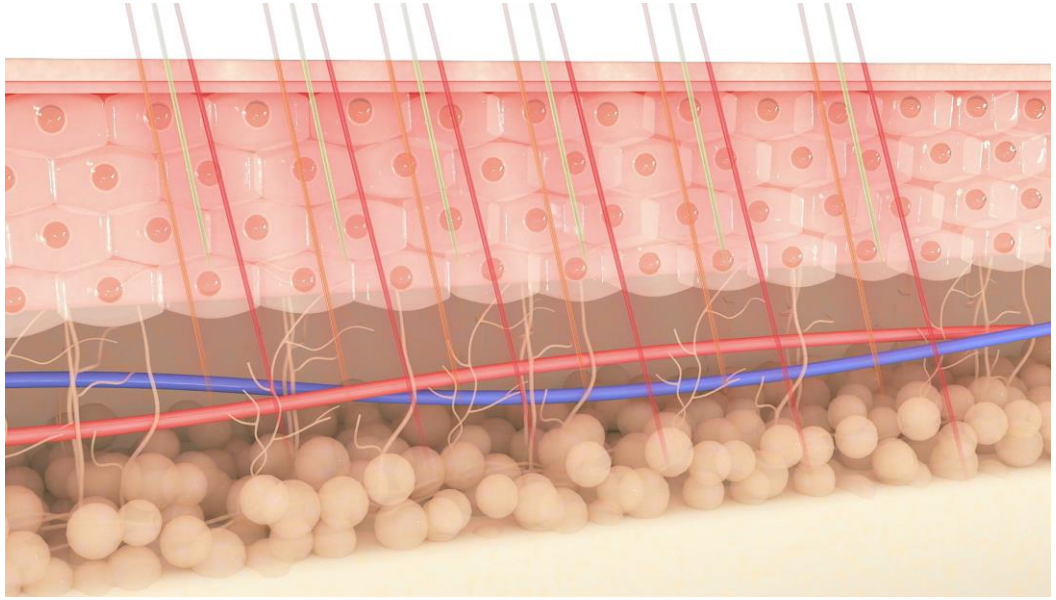

- 고효율 Laser 18개 + 적외선 30개 + 기존 제품 동일 360개 = **총 408개 적용**
- 고효율 Laser가 통증 부위에 효과적으로 집중되어 기존 제품보다 빠르고 효과적으로 통증 케어
- 다양한 광원을 복합적으로 적용하여 다양한 통증 원인을 빠르고 효과적으로 통증 케어
- 다양한 복합 광원이 피부 속 깊은 근육 및 관절 통증까지 케어 가능

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

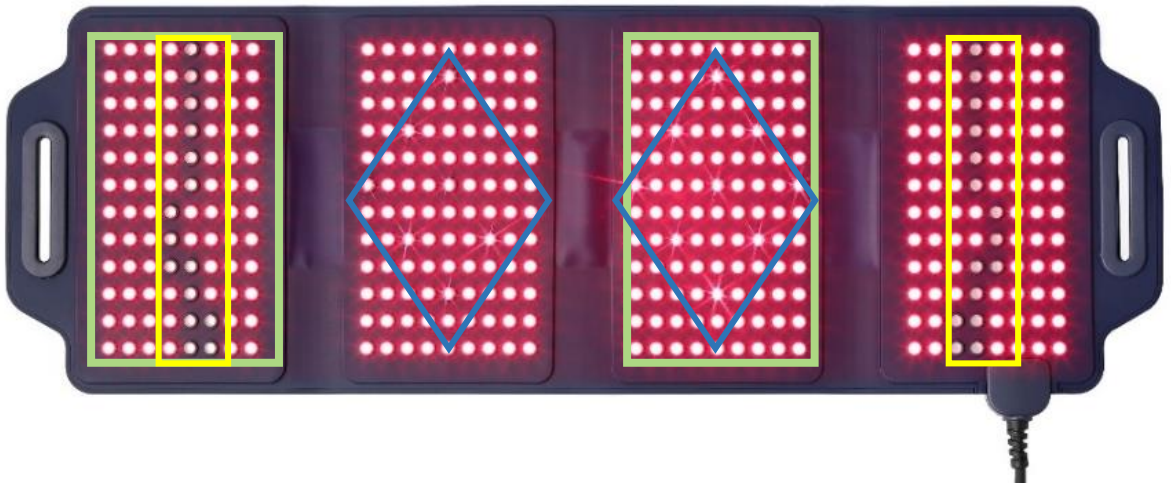

고효율 레이저 18개 탑재

870nm 적외선 파장 30개 탑재 (눈에 보이지 않음)

저온화상 등의 안전을 위해 온도센서 2개 탑재

01. 650nm 고효율 레이저 18개 및 660nm Low-Level LED, 870nm 적외선 LED 총 408개의 광원 적용

02. 친환경 실리콘 재질로 피부에 밀착되는 플렉서블 입체구조로 통증이 있는 관절 부위에 효과적으로 적용

03. 기존 제품보다 방열효과가 좋아 지속적이고 연속적인 통증 완화 효과

04. 저온 화상 예방을 위한 온도센서 2개 설치 (기존라파402VIP 제품 1개)

05. 보조배터리 사용이 가능하여 언제 어디서나 편리하게 사용

06. 프리볼트를 적용하여 해외에서도 사용 가능

07. 특허 등록 [플렉서블 무릎 관절 통합관리 광선조사기]

08. 미국 FDA Class Ⅱ 의료기기 승인 완료(등록번호: D469830)


※의료기기의 저온화상 문제로 인하여 식약처에서 기존 45도에서 41도 법률을 변경하였으며,
본 제품은 의료기기 법률 개정에 따라 41도 적용하여 저온 화상에 더욱 안전한 제품입니다.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

THERAPY Application



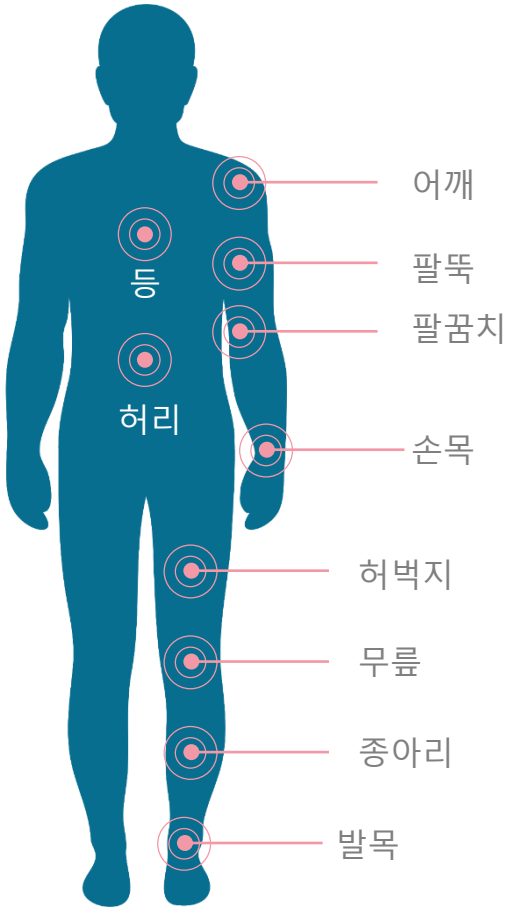

통증 부위에 밀착해서 집중적으로 조사하는 방식의 통증 완화 의료기기

라피는 통증이 있는 신체 다양한 부위에 밀착하여 레이저를 직접 조사하기 때문에 빠른 **통증 완화를 기대할 수 있습니다.**

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

ATP(Adenosine TriPhosphate)

ATP는 근육 수축, 신경 세포에서 흥분의 전도, 물질 합성 등 살아있는 세포에서 다양한 생명 활동을 수행하기 위해 **에너지를 공급하는 유기 화합물이다.**

즉 세포의 에너지 화폐 라고도 불리우며 , RNA 합성에 필요한 단량체 이며 나중에 dATP로 전환되어


DNA 합성에 필요한 단량체가 되기도 하며 많은 생화학적 경로를 조절하기도 한다.

또한 생명 활동 중에서도 세포 바깥에서도 중요한 기능을 수행하는데 이것은 **상처난 세포에서 방출되어 고통을 줄이기도 하고 치유하기도 한다.**

650~660nm

650~660nm 표면 치유 가속화

우리 피부의 멜라닌이 매우 잘 흡수되는 파장인 650~660nm를 한 부위에 조사하면 표면 부위에 많은 양을 투여할 수 있다. 파장은 박테리아를 억제하고 세포 성장을 촉진할 수 있기 때문에, 레이저 치료는 상처 치유와 흉터 조직 조절에 놀라운 결과를 가지고 있다.

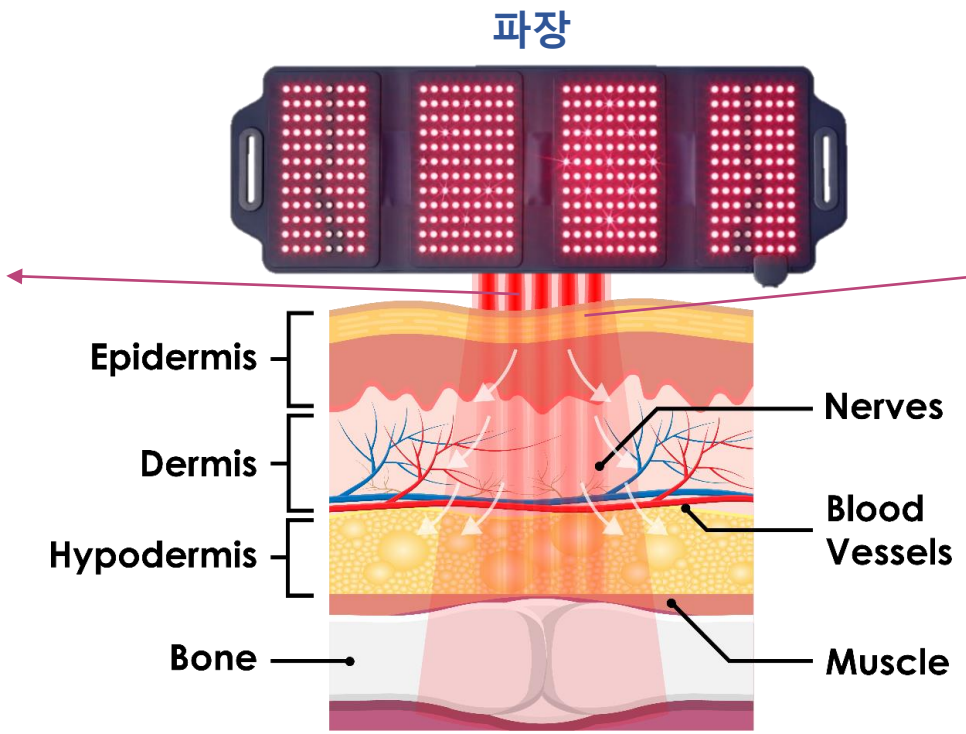

870nm

870nm, ATP 생산량 증가

세포에서 ATP로 얼마나 효율적으로 전환시키는지를 결정하는 효소는 870nm에서 가장 높은 흡수율을 갖는다.
이 것은 효소의 분자 상태에 관계없이, 흡수하는 과정을 가속화하고 세포 ATP 생산을 증가 시킵니다.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

GCOOP

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

염증 치료 원리

| 염증의 발생 |

혈액의 양 감소

혈액의 질 저하

세포 감소

만성 염증 증가

근육 약화

질병 발생

방심하다가는 평생 고생할 수 있는

만성염증 관리



| 염증의 치료 |


- 혈액의 양 증가
- 혈액의 질 상승
- 세포 증가
- 만성 염증 감소
- 근육 강화
- 질병 치료

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

다양한 관절 부위에 적용

▶염증의 발생

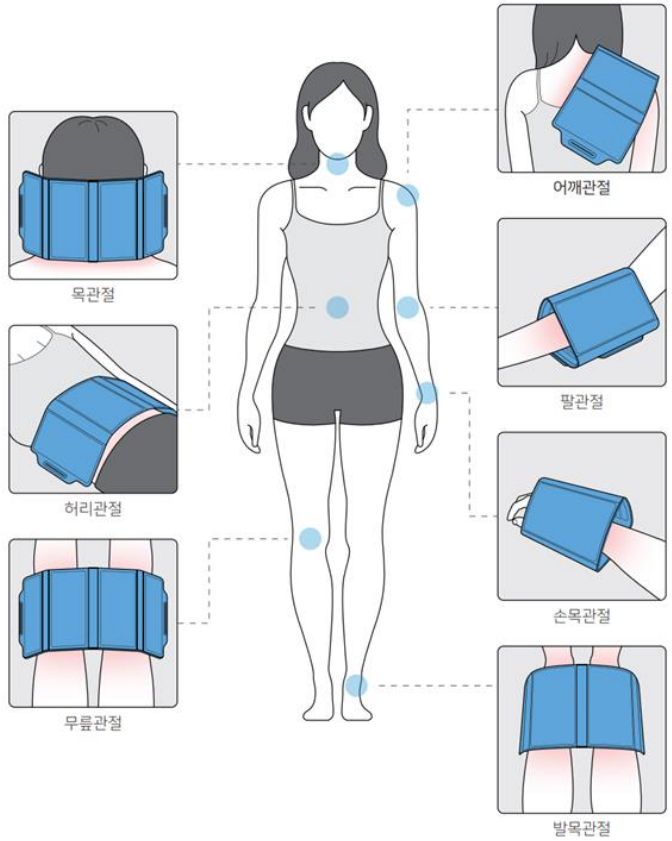

▶유연한(Flexible) 실리콘 및 기판을 적용하여, 다양한 통증 부위에 케어 가능



실제 착용 모습

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.


본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

다양한 관절부위에 적용

▶높은 휴대성과 수납성으로 편리





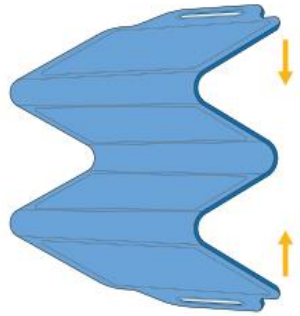



▶4단 접이로 낮은 부피로 인해 수납이 편리

▶부피 작고 크기가 크지 않아 높은 휴대성

▶전용 USB 케이블과 보조배터리만 있으면 언제 어디서나 사용이 가능

(보조배터리 사양 20000mAh DC 12V 출력 1.5A)

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.


제품 구성

① 

③ 

② 

④ 

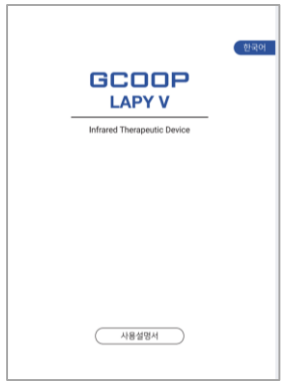⑤ 




보조배터리 연결 트리거 케이블

*보조배터리(개인구매)

① 벨트
② 본체기기 및 컨트롤러
③ 전원 케이블
④ 파워어댑터
⑤ 제품설명서

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

컨트롤러 사용 방법

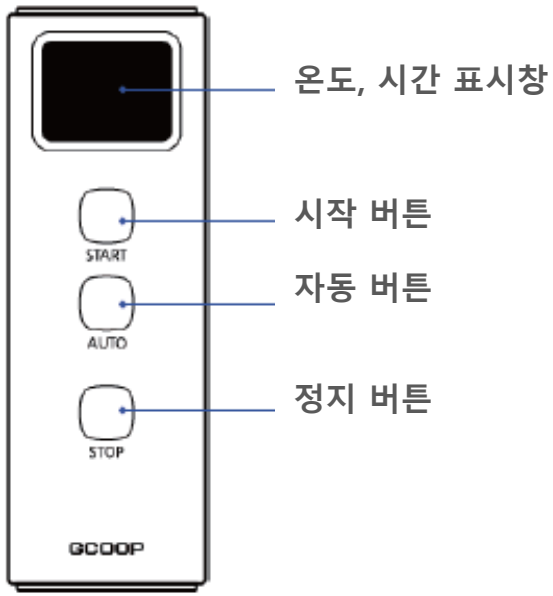

Controller

01. 파워 어댑터의 전원 플러그를 상용 전원 콘센트에 연결한다.

02. 파워 어댑터의 연결 커넥터를 컨트롤러와 연결한다.

03. 케어가 필요한 부위에 본체 기기를 적용한다.

04. 원하는 케어 부위에 따라 동작 버튼 또는 자동 버튼을 누른다.

- **시작 버튼** : 30분 운전 , 10분 정지

(온도 설정에 의해 OFF 되는 경우 운전 시간에 포함되지 않으며, 멜로디 소리도 나지 않습니다.)

- **자동 버튼** : 30분 운전 후 정지

(온도 설정에 의해 OFF 되는 경우 운전 시간에 포함되지 않으며, 멜로디 소리도 나지 않습니다.)

05. 운전을 정지하고자 하는 경우 정지버튼을 누른다.

06. 사용이 완료되면 파워 어댑터의 전원 플러그를 콘센트에서 분리한다.

※ **41도에서 OFF 되기 때문에 표시창에는 40도까지만 표현됩니다.**

※ 더 자세한 사항은 지큡 라피 V 올바른 사용방법을 참고.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

지큡 라피 V 올바른 사용방법

01. 케어를 원하는 부위에 라피 V를 잘 감싼 후 제품과 함께 제공된 밴드로 가볍게 고정 한 후 플러그를 연결해 주십시오 (옷 위에 사용하시면 효과가 반감됩니다).
밴드를 강하게 조일 경우 통증이 있을 수 있으니 가볍게 고정시켜 주십시오.

02. 동작 버튼을 누르면 레이저가 환부에 직접 조사됩니다. 이때, 가능한 맨 살에 사용해 주십시오. 단 뜨겁게 느껴지거나 땀이 나는 경우 반드시 흰색 내의 위에 사용하십시오.

03. 동작 버튼만 누르고 사용할 경우 표시창에 온도가 표시되며 41도가 표기되면 일시적으로 가동이 멈추게 되고 표시창에 38도가 표기되면 다시 가동됩니다. (온도 설정에 의해 OFF 되는 경우 가동 시간에 포함되지 않으며, 멜로디 소리도 나지 않습니다.)
가동 누적 시간이 30분이 경과되면 사용자의 안전을 위해 10분간 휴식 후 다시 조사 됩니다.

04. 자동 버튼을 누르고 사용할 경우 표시창에 시간이 표시되며, 표시창 30은 30분 가동 시간 표현합니다.
가동 중에 온도 설정에 의해 41도가 되면 일시적으로 가동이 멈추게 되고 다시 가동될 때까지 시간은 감소하지 않습니다.
(온도 설정에 의해 OFF 되는 경우 가동 시간에 포함되지 않으며, 멜로디 소리도 나지 않습니다.)
가동 누적 시간이 30분이 경과되면 자동으로 OFF 되며, 다시 동작버튼이나 오토 버튼을 누르지 않으면 동작하지 않습니다.

05. 광선 조사 중에 중단을 원하실 경우 정지 버튼을 눌러주십시오.

06. 레이저 조사가 끝나면 신호음과 함께 표시 창에서 숫자가 사라집니다.

07. 사용 완료 후 정지버튼을 누르고 전원 플러그를 제거하십시오.


08. 1일 1~2회 사용을 권장합니다.

※ 더 자세한 사항은 지큡 라피 V 올바른 사용방법을 참고해 주세요.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.


COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

라피 V 벨트 구성

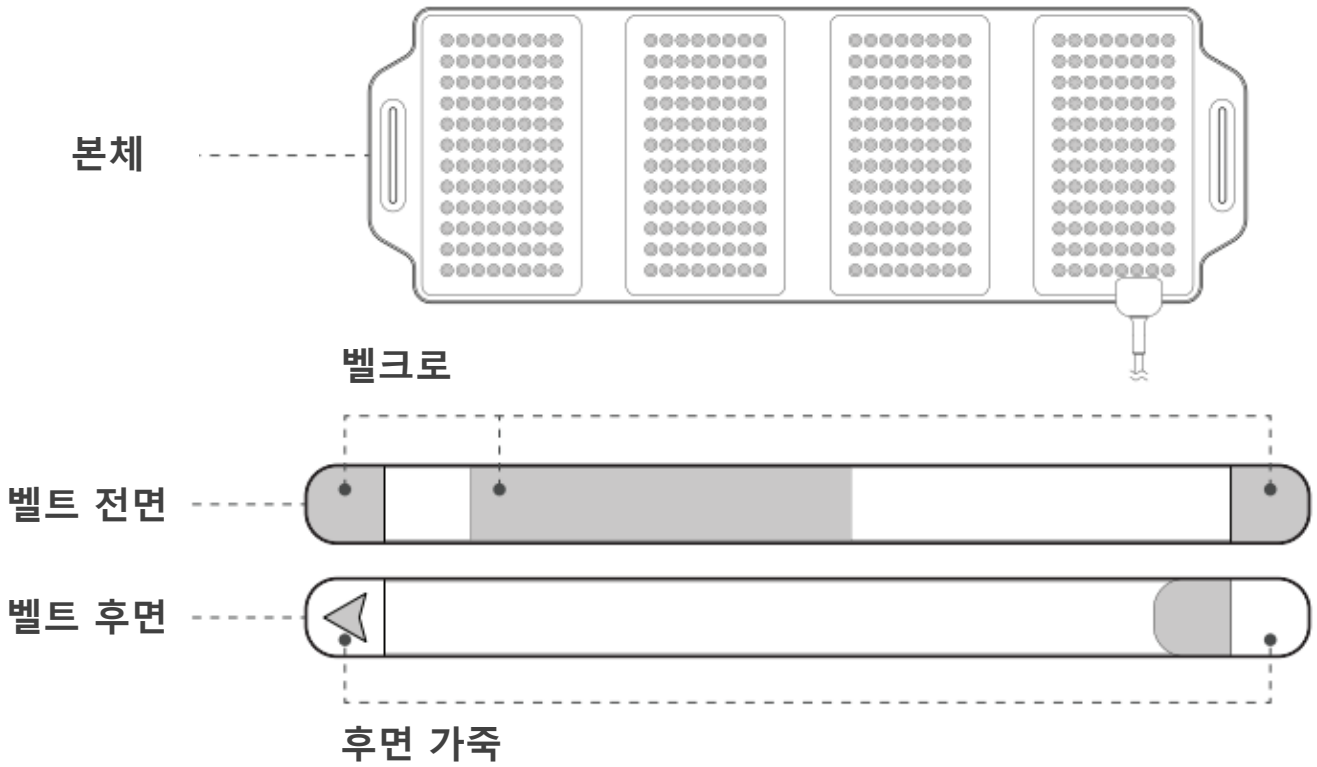


본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.
GCOOP
COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.


착용 순서 : 팔 또는 무릎에 찰 경우

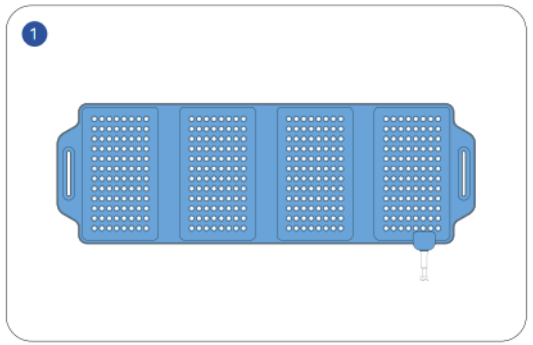


본체의 광원부위가
보이도록 위치합니다.

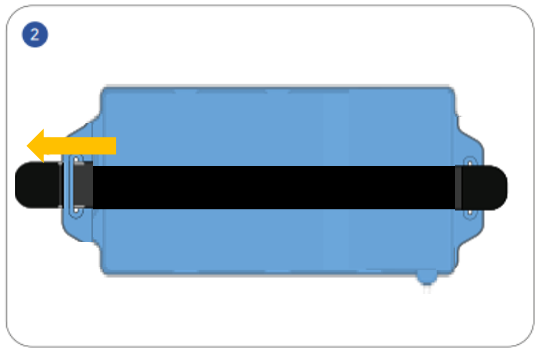

벨트의 전면 부위가
보이도록 위치합니다.

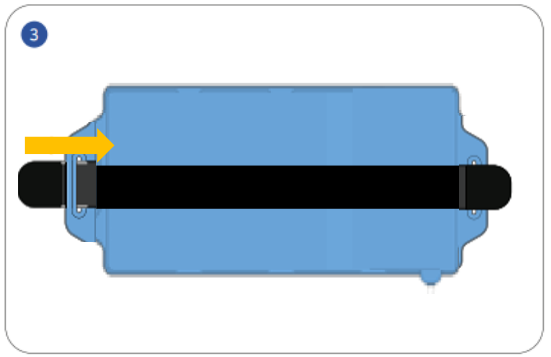

벨트 전면의 좌측 부분을
의료기기 좌측 구멍에
끼워 굽힌 후
벨크로를 붙입니다.

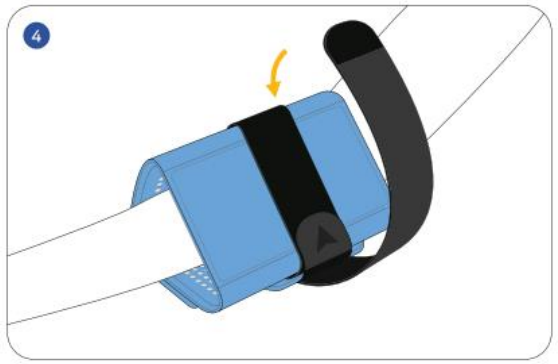


의료기기의 광원부가 환부를
향하도록 부착하고 벨트를
의료기기 본체에 둘러
벨크로를 붙입니다.


COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.


착용 순서 : 허리에 찰 경우

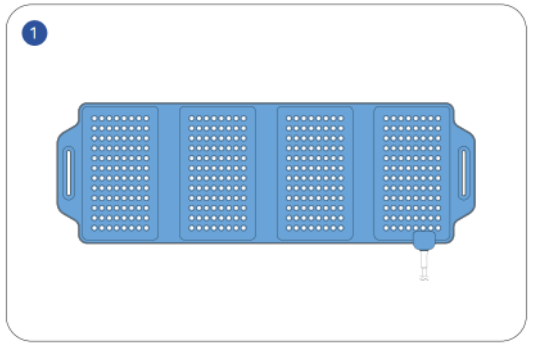


의료기기의 광원부위가
보이도록 위치합니다.

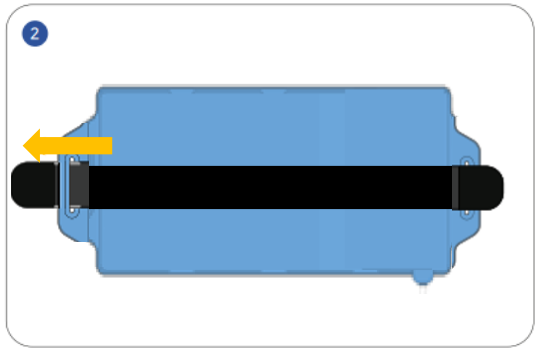


벨트의 전면 부위가
보이도록 위치합니다.

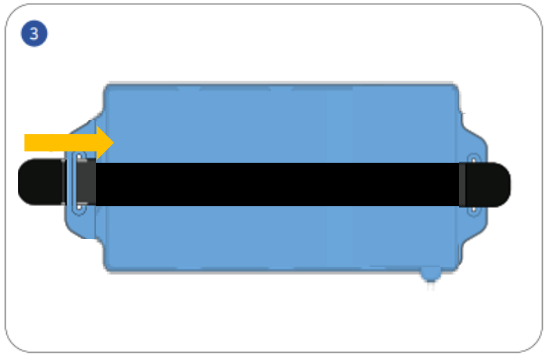

벨트 전면의 좌측 부분을 본체 기기의
좌측 구멍에 끼워 굽힌 후 벨크로를 붙입니다.

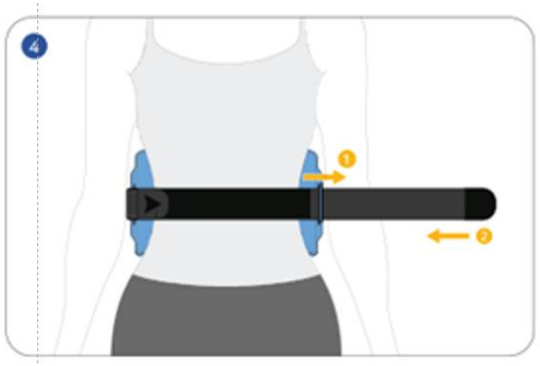

의료기기 본체를 배 또는 등에 부착한 뒤 벨트의 고정되지
않은 부분을 의료기기 우측 구멍에 끼워서 굽힌다.

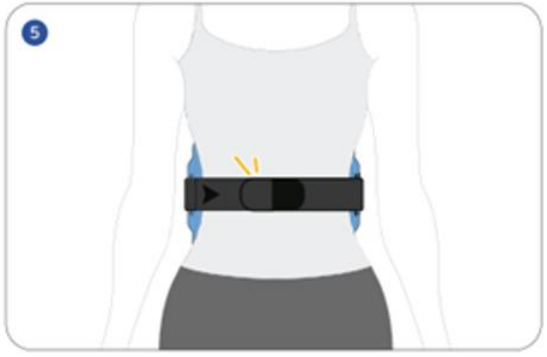


굽혀진 벨트를 원하는 곳에 위치한 후
벨크로로 고정합니다.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

GCOOP

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.


제품 보관방법

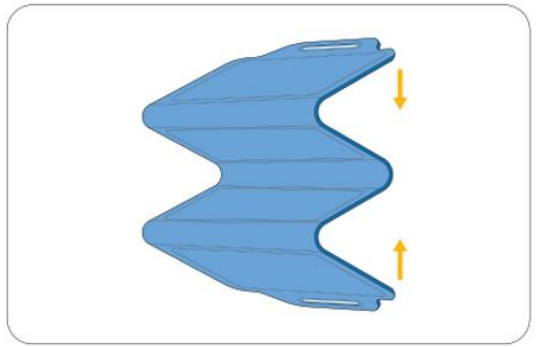

의료기기 본체를 그림과 같이
접어 보관합니다.



벨트를 먼저 반으로 접은 뒤
지그재그 형태로 접습니다.

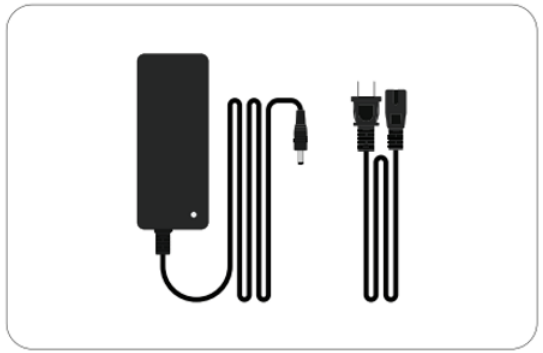

파워어댑터와 전원 케이블을
정리합니다.



파워어댑터와 전원케이블을 ①에 넣고
그 위에 의료기기 본체를 올립니다.
그 다음 컨트롤러와 벨트를 자리에
맞게 보관합니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

사용환경과 보관조건

01. 제품을 사용하는 환경에 따라 기온이 낮은 경우 30분 작동시 41도 도달하기 전에 동작이 정지할 수 있습니다. 효과적으로 온열을 느끼기 위해서는 아래와 같이 사용하세요.

① 주변 온도가 낮지 않은 공간에서 사용하여 주세요.

② 제품 사용시 옷이나 타월, 이불 등으로 감싸고 보온하여 사용하여 주세요.

③ Start Button(동작 버튼) 작동하여 41도에 도달하지 못하고 30분에 정지한 경우에는 Stop Button(정지 버튼)을 누른 후 다시 Start Button(동작 버튼)을 눌러 바로 동작시키면 이전 정지된 온도에서 바로 시작할 수 있습니다. (재동작을 위해10분을 기다리는 동안 온도가 떨어지기 때문에 위와 같이하여 주세요.)

④ 추운 겨울이나 온도가 낮은 곳에서는 난방이 되는 곳에서 옷이나 타월, 이불 등으로 감싸고 사용하여 주세요.

02. 물기가 없는 곳, 실온에서 보관한다.

03. 화학약품 등의 제품이나 가스가 발생하는 곳을 피해서 보관한다.

04. 사용 후 본체기기 전면부(광원)를 마른 걸레 등으로 닦는다.

05. 본체기기 전면부(광원)에 이물질이 있는 경우 면봉으로 가볍게 닦아낸다.

06. 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관한다.

07. 사용하신 후에 다음의 순서로 하여 보관한다.

① 파워 어댑터의 전원 플러그를 콘센트에서 분리한다.

② 컨트롤러에 연결된 파워어댑터의 잭을 분리한다.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

이런분들께 추천드립니다



- 다양한 부위에 통증 완화를 원하시는 분
- 일상의 통증으로부터 통증 완화를 원하는 분
- 운동 후 통증이 있는 분
- 장시간 앉아 있는 학생 및 회사원
- 육아와 집안일에 통증을 자주 느끼는 분
- 나이가 들면서 관절에 통증이 있으신 분

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

제품 주의사항 및 안전상의 경고

01. 피부가 민감하거나 약하신 분, 연세가 많으신 분은 저온 화상의 우려가 있을 수 있으므로 반드시 얇은 흰색 면 수건이나, 흰색 내의 위에 조사하십시오. 또한 뜨거우시면 즉시 사용을 중단하십시오.

02. 사용 시, 땀이 날 경우 반드시 흰색 면 수건이나 흰색 내의 위에서 조사하십시오. 제품은 마른 수건으로 깨끗이 닦아주시고, 피부는 깨끗이 씻어주십시오.
(주의: 피부를 씻지 않은 경우, 피부가 검게 물들 수 있음)

03. 눈과 얼굴에는 사용하지 마십시오. (관절 부위 이외의 사용을 권하지 않음).

04. 고온의 전기장판, 매트 등에서 사용하지 마십시오. 외부열로 인해 제품 표면이 변경되거나 열의 충격을 받을 수 있습니다. (고장 시 소비자과실로 유상 수리).

05. 기기 사용 시 두꺼운 이불이나 담요 등으로 덮어 놓지 마십시오. 온도센서가 오작동 할 수 있습니다.
단, 부득이하게 이불을 덮는 경우 정확한 온도센서 작동을 위해 조절기는(컨트롤러) 반드시 이불 밖으로 놓고 사용하십시오.

06. 관절 관련 파스, 크림, 기타 약품과 함께 사용하지 마십시오. 함께 사용 시 심각한 고장 및 제품 의 변형, 파손의 원인이 됩니다. (고장 시 소비자 과실로 유상 수리).

07. 본체를 허리 밑이나 엉덩이로 깔고 절대 사용하지 마십시오. (치료효과를 보기 어렵습니다. 고장 시 소비자과실로 유상 수리 됩니다.)

08. 습도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.

09. 고장 발생시 임의로 분해하지 마십시오.
임의로 분해 시 A/S는 불가하며, 추후 발생되는 어떠한 문제에도 책임지지 않습니다.

10. 취급 시 떨어뜨리거나 무리한 충격을 주지 마십시오.

11. 본체와 연결되는 전선부위에는 무리한 힘을 가하지 마십시오.
① 접촉 고장 현상(조절기 숫자 오작동 레이저 불 깜박임)발생 시 즉시 사용 중단 후 구입처로 연락 바랍니다.
② 상기와 같은 고장 상태로 장기간 사용할 경우 제품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

12. 물이 묻은 손으로 본체나 콘센트, 컨트롤러를 만지지 마십시오.

※ 본 제품은 광원이 탑재된 제품으로 직접 눈으로 보거나 다른 사람 눈을 향하여 사용하지 마십시오. 시력에 장해가 발생할 수 있습니다.

※ 소비자 부주의로 인해 발생되는 문제는 당사에서 책임 지지 않습니다.

※ 사용설명서의 '사용 시 경고 및 주의사항'을 참고해 주시기 바랍니다.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

사용시 주의사항

1. 사용 전 가능하면 편안한 복장으로 갈아 입으십시오.
2. 피부염 또는 상처 부위에 절대 사용하지 마십시오.
3. 다음의 사람은 반드시 의사의 처방과 지도하에 사용하십시오.
    1) 급성 질환이 있는 사람
    2) 악성 종양이 있는 사람
    3) 심전계 등 정착용 전자의료기기를 사용하는 사람
    4) 임산부 및 유아
    5) 고혈압 환자

※ 소비자 부주의로 인해 발생되는 문제는 당사에서 책임 지지 않습니다.
※ 사용설명서의 '사용 시 주의사항'을 참고해 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

특허증



특허증
CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-2401416 호

출원번호 제 10-2021-0130878 호
출원일 2021년 10월 01일
등록일 2022년 05월 19일

발명의 명칭 생체이물 무종 관찰 통합관리 광선조사기

특허권자
퓨리글로벌 주식회사(135811-*******)
경기도 화성시 봉담읍 와우안길 17, 1012호(수원대학교, 창업보육센터)

발명자
정연남(590419-*******)
경기도 성남시 분당구 내정로 185, 210동 1503호(수내동, 양지마을)

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.

2022년 05월 19일

특허청
Korean Intellectual Property Office

특허청장
COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김 용 래

한국 의료기기 GMP

제너럴바이오㈜ 제조업



인정번호(No.) : KTR-AABA-15597

의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서
(Certificate of GMP)

GMP

■ 업소명/허가번호 (Company name of Applicant / License No.)
퓨리글로벌 주식회사
Puri-Global Co., Ltd.

■ 업소 소재지 (Company address of Applicant)
경기도 수원시 영통구 봉영로 1620 대우 월드마크 영통 , 101동 2층 201호 (영통동, 대우 월드마크 영통)
2Fl.he, 2F, 101, 1620 Bongyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea

■ 제조소명 (Name of Manufacturer)
제조허가자 : 퓨리글로벌(주)(Puri-Global Co., Ltd.)
제 조 자 : 제너럴바이오(주)(General Bio Co., Ltd.)

■ 제조소 소재지 (Address of Manufacturer)
제조허가자 : 경기도 수원시 영통구 봉영로 1620, 101동 2층 201호 (영통동, 대우 월드마크 영통)
2Fl.he, 2F, 101, 1620 Bongyeong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
제 조 자 : 전라북도 남원시 송동면 원부산로 254
254 Yongtusan-ro, Songdong-myeon, Namwon-si, Jeollabuk-do, Korea

■ 품목군 (Category)
별첨참조 (See attached list)

의료기기 제조 및 품질관리기준에 적합함을 인정합니다.
(We hereby certify that the above manufacturer complies with Korea Good Manufacturing Practices of Medical Devices for the product group listed above)

발행일자(Date of Issue) : 2022. 10. 17
유효기간(Date of Expiration) : 2025. 10. 16

경인지방식품의약품안전청장
GYEONGIN REGIONAL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
KTR
한국화학융합시험연구원장
KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

미국 FDA 의료기기 2레벨



FDA U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION
Follow FDA | En Español

Home | Food | Drugs | Medical Devices | Radiation-Emitting Products | Vaccines, Blood & Biologics | Animal & Veterinary | Cosmetics


Establishment Registration & Device Listing
FDA Home > Medical Devices > Databases

New Search | Back To Search Results

Proprietary Name:	GCOOP LAPY V
Classification Name:	LAMP, INFRARED, THERAPEUTIC HEATING
Product Code:	ILY
Device Class:	2
Regulation Number:	890.5500
Medical Specialty:	Physical Medicine
Registered Establishment Name:	GENERAL BIO CO., LTD.
Registered Establishment Number:	3011108368
Owner/Operator:	General Bio Co., Ltd.
Owner/Operator Number:	10058516
Establishment Operations:	Manufacturer

Page Last Updated: 04/18/2022

CE 인증

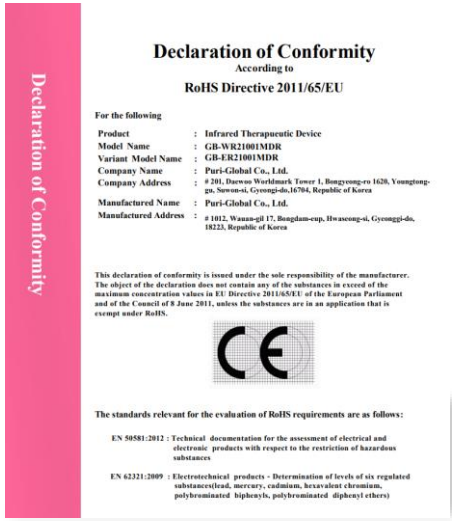

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity
According to
RoHS Directive 2011/65/EU

For the following

Product	:	Infrared Therapeutic Device
Model Name	:	GB-WR21001MDR
Variant Model Name	:	GB-ER21001MDR
Company Name	:	Puri-Global Co., Ltd.
Company Address	:	# 201, Daewoo Worldmark Tower 1, Bongyeong-ro 1620, Youngtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,16704, Republic of Korea
Manufactured Name	:	Puri-Global Co., Ltd.
Manufactured Address	:	# 1012, Wausa-gil 17, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18223, Republic of Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration does not contain any of the substances in exceed of the maximum concentration values in EU Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011, unless the substances are in an application that is exempt under RoHS.

CE

The standards relevant for the evaluation of RoHS requirements are as follows:

EN 50581:2012 : Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

EN 62321:2009 : Electrotechnical products - Determination of levels of six regulated substances(lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)

일본 PSE 전파인증



【写し Authorized Valid Copy】

適合同等証明書
Equivalent of the Certificate of Conformity

TÜVRheinland

証明書番号 Certificate No. JD 50509166 ページ Page 1

申請者番号 Applicant Reference 15823189 検査機関照会番号 Our Reference 01-YAUYUK0_60439372 001 発行年月日 Date of Issue 2021 年 06 月 25 日

申請者 Applicant
GUANGDONG HUACHUANGXING POWER SUPPLY CO., LTD
NO. 27 FUDONG ROAD, DONGFENG VILLAGE, LELIU STREET, SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY GUANGDONG PROVINCE 528000, P. R. China

製造工場 Manufacturing Plant
GUANGDONG HUACHUANGXING POWER SUPPLY CO., LTD
NO. 27 FUDONG ROAD, DONGFENG VILLAGE, LELIU STREET, SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY GUANGDONG PROVINCE 528000, P. R. China

検査の方法 Inspection Method
・技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二：J61558-1(2019), J61558-2-16(H26), J55014-1(H27), J30009(H25)
Interpretation on Ministerial Ordinance establishing Technical Requirements Appendix 12: J61558-1(2019), J61558-2-16(H26), J55014-1(H27), J30009(H25)
・施行規則別表第四（交流用電気機械器具）
Appendix 4 of the Enforcement Regulations (AC Electrical Appliances)

特定電気用品名 Name of Specified Electrical Appliance and Material: 直流電源装置 DC Power Supply Unit

型式の区分 Type Classification: 1（別付1.0）参照 (Refer to "Attachment 1.0")

証明書の有効期間 Validity of Certificate: 本証明書は、施行令で規定された期間である 2026 年 06 月 27 日まで有効です。
This certificate is effective until 27. 06. 2026 being the period stipulated by the Enforcement Ordinance.

This is to certify that the above-mentioned Specified Electrical Appliances and Materials complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 9 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (hereinafter referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 8 for Inspection of the Act).

NOTE: This Authorized Valid Copy is issued by receiving an application from the above applicant in accordance with Article 13, Item 1 of the Enforcement Regulations of Electrical Appliance and Materials Safety Act. The importer receiving this Authorized Valid Copy from the applicant shall comply with the requirements of the Act.

チュフ ラインランド 香港リミテッド TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.
普通新界青山公路 10-16 富華工業大廈 3,4 樓
3-4/F, Fou Wah Industrial Building, 10-16 Pun Shan Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

発行者 Issued by
作名 Name Thomas

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

참고자료

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

GCOOP

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

"만성 염증 있는 곳에 질병 있다"



관절염

여러 가지 원인으로 관절에 염증이 생긴 것으로, 관절과 관 절을 둘러싸고 있는 주위 조직을 침범하는 질환과 상태들을 말합니다.



손목터널증후군

손가락 또는 손목이 아프고 저릿저릿하다.열이 오르는 듯한 느낌, 타는듯한 느낌이 난다. 심각한 경우 손의 근력이 떨어진다.




전골간신경포착증후군

정상의 경우 엄지와 검지로 동그라미를 만들 수 있지만, 전골간신경포차 증후군을 앓고 있는 경우 동그라미를 만들 수 없다.



팔꿈치터널증후군

팔꿈치 안쪽에 뻐근한 통증이 나타난다. 팔꿈치에 저릿저릿한 증상이 나타나며, 어깨나 목쪽으로 뻗치면서 발생되기도 한다. 약지, 새끼손가락의 감각이상이 나타난다.



오십견

관절을 감싸고 있는 관절낭에 염증이 발생하면서 주변조직들이 점점 딱딱해지고 어깨가 굳어져 운동범위가 줄어드는 질환



디스크&허리통증

허리 통증은 순간적으로 허리에 무리가 가서 생기지만, 척추 구조, 염증, 추간판이나 척추를 지탱하는 근육에 문제가 생겼을 때, 복부 대동맥 파열, 요로결석, 내과 질환, 부인과질환으로 나타난다.



복재포착증후군

허벅지와 무릎, 다리에서 찌릿한 통증이 나타난다. 무릎과 종아리쪽에는 타는듯한 느낌이 오래 서있거나, 걸었을 때, 계단을 오르내릴 때 증상이 심해진다.



복재포착증후군

발등, 종아리 등이 저린다. 발에 힘이 잘 들어가지 않고, 발끝을 들어올리기 힘들다. 발등, 종아리에 압박되는 압통이 발생되기도 한다. 발등, 종아리쪽에 감각이 잘 느껴지지 않거나 이상하다.



발목터널증후군

발바닥이 화끈거리고 열이 나는 것만 같다. 실제로 만져보면 열이 발생되지 않는다. 증상이 밤이 되면 더욱 심해진다. 감각이 이상하고, 쿡쿡 쑤시는 느낌을 받기도 한다.



폐쇄포착증후군

임신 / 출산 교통사고 후에 후유증으로 발생되기도 한다. 허리쪽에 강한 압박이 발생되기도한다. 사타구니 안쪽 또는 허벅지 안쪽, 고관절쪽 통증이 나타나기도하고 무릎 관절 위쪽 증상을 호소하는 경우도 있다.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

관절염이란?



관절염은 여러 가지 원인으로 관절에 염증이 생긴 것으로,
관절과 관절을 둘러싸고 있는 주위 조직을 침범하는 질환과 상태들을 말합니다.

가장 흔한 것은 퇴행성 관절염 과 류마티스 관절염입니다.
퇴행성 관절염은 관절을 보호하고 있는 연골의 손상 또는 퇴행성 변화에 따라
관절을 이루는 뼈와 인대 등에 손상이 일어나고 염증과 통증이 생기는 질환입니다.


과거에는 단순히 나이가 들어서 발생하는 노화 현상으로 생각하여
퇴행성 관절 이라고 도 하였으나, 현재는 여러 가지 원인으로 인해
퇴행성 관절염이 늘어 나고 있습니다.

류마티스 관절염은 자가면역질환으로 다발성 관절염을 특징으로 하는 만성 염증성 질환입니다.
주로 손 관절과 발 관절 같은 작은 관절에 좌우 대칭적으로 활막염이 생기며
주위 연골과 뼈까지 침범하여 관절이 파괴되고 변형이 나타납니다.


COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.


본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다. GCOOP


퇴행성 관절염 진행과정

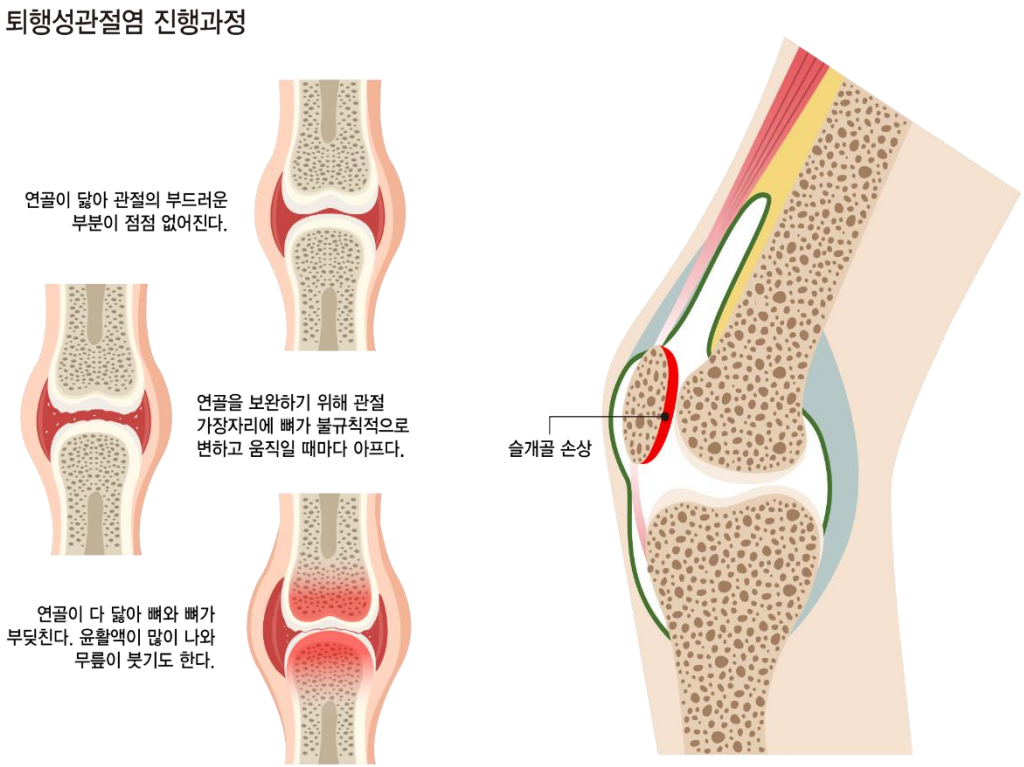

퇴행성 관절염 환자 비율

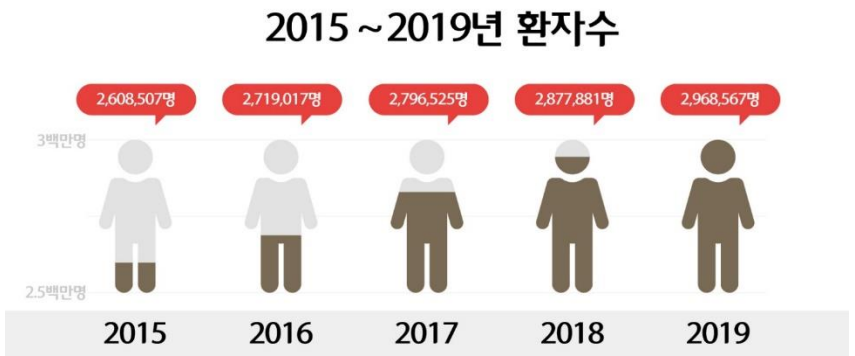

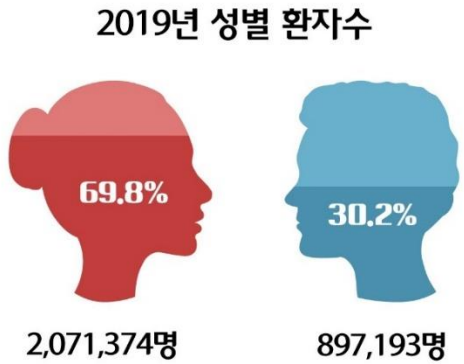

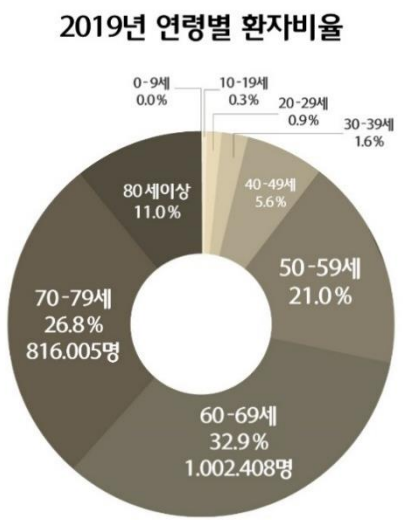

*출처 : 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

퇴행성 관절(비만)


비만은 관절염을 발생,악화시키는
중요한 위험요인입니다.

고도비만(30kg/m2이상)이면,과체중과 정상 체중보다
관절염의 발생 위험이 **여자는 4배,남자는 4.8배
이상 증가합니다.**

비만인 사람이 체중을 약 5kg감량 할 경우,
감량하지 않는 경우보다 관절염의 위험이
절반으로 줄어듭니다.


[출처] 대한가정의학회,보건복지부,질병관리본부

비만할수록 관절염에 걸릴 위험이 높습니다.

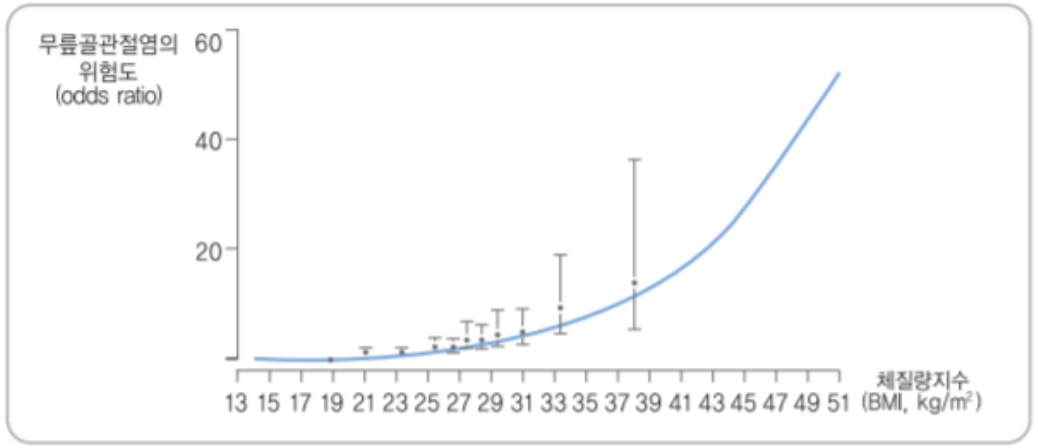

[출처] Int J Obes. 2001;25(5):622-7.

관절염이 있는 사람 중 비만할수록 활동장애를 가진 사람이 많습니다.

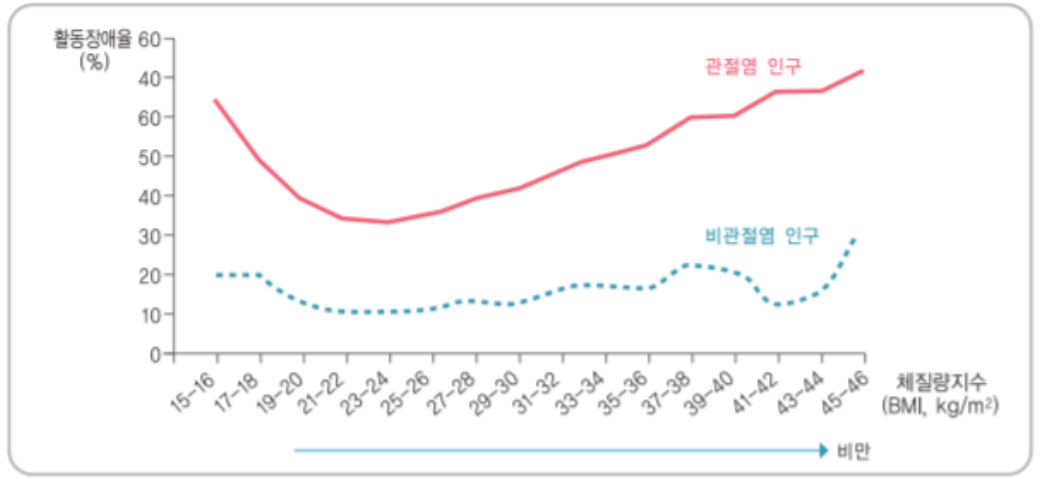

[출처] Obes Res. 2004;12(5):854-61.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.


퇴행성 관절염(흡연)

흡연자는 비흡연자보다 류마티스
관절염에 걸릴 위험이 2배 정도 높습니다.

흡연을 하면 류마티스 관절염이 악화됩니다.

금연을 한지 10년이 지나야 류마티스
관절염 발생 위험이 비흡연자와 같은 정도로 감소합니다.
그러므로 일찍 금연하는 것이 중요합니다.

흡연자는 비흡연자보다 류마티스 관절염에 걸릴 위험이 2배 정도 높습니다.

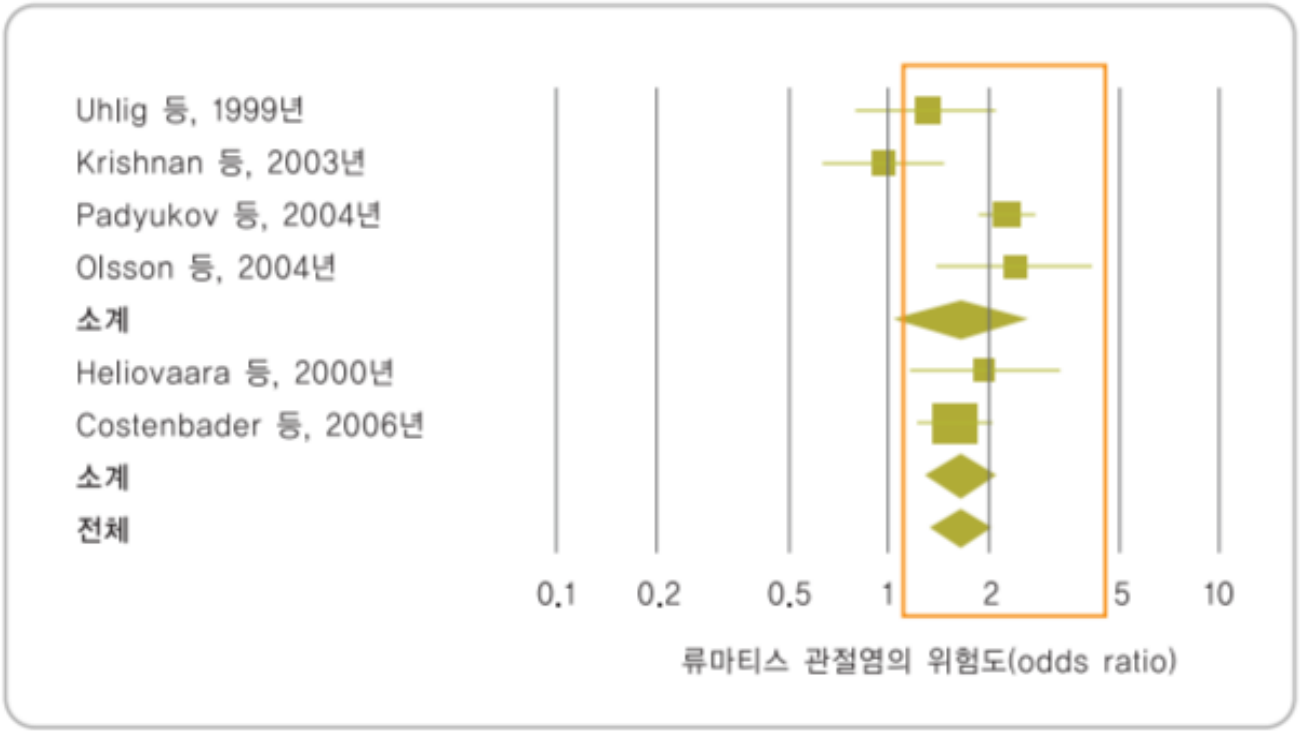

[출처] Ann Rheum Dis. 2010;69(1):70-81.


[출처] 대한가정의학회,보건복지부,질병관리본부

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다. GCOOP

퇴행성 관절염(관절 손상과 조기진단)

관절 손상이 있는 사람은 관절염 발생률이 높습니다.

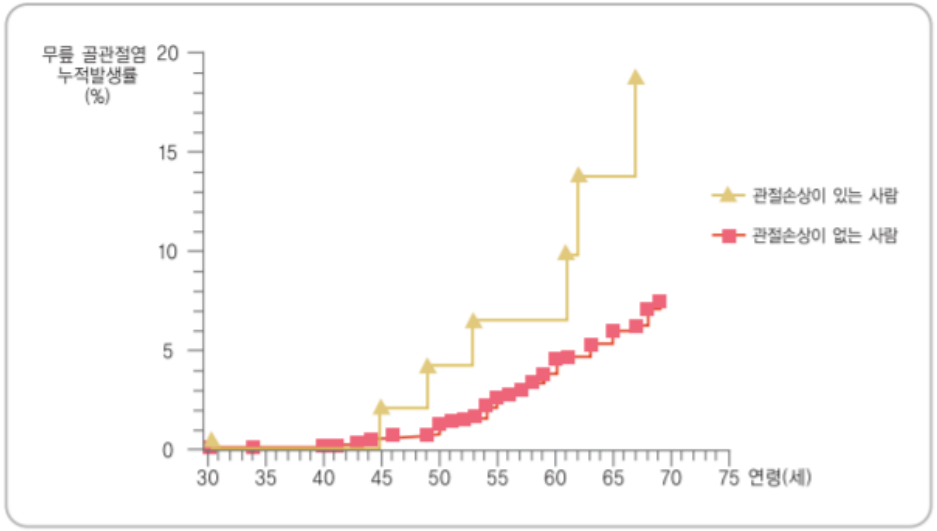

[출처] Ann Intern Med. 2000;133(5):321-8.

관절 손상은 관절염의 중요한 위험 요인입니다.
반복적으로 관절에 무리가 가는 일을 하는 사람들은 관절염의 위험이 큽니다.

같은 자세를 오랫동안 취하지 않고, **무게를 여러 관절에 분산시키면 관절염을 예방하는 데 도움이 됩니다.** 예를 들면, 물건을 들때 허리만 구부리지 말고 무릎을 함께 구부려서 다리와 허리 힘을 이용합니다.

최근 스포츠를 즐기는 사람들이 늘어나면서 관절 손상을 입는 경우가 늘어나고 있습니다.
운동하기 전에는 충분히 준비운동을 하고, 운동할 때에는 알맞은 보호 장비를 착용합니다.

조기 진단과 알맞은 치료는 관절염의 관리에 있어 매우 중요합니다.
골관절염과 류마티스 관절염은 치료와 관리가 다르므로 이 둘을 감별 진단 하는 것도 중요합니다.

조기 진단을 통한 알맞은 약물 투여와 생활 습관 교정은 통증을 경감하고 질병의 경과를 좋게 합니다.


특히 류마티스 관절염의 경우,병의 진행을 늦출 수 있는 치료를 하면 관절의 손상과 변형을 최소화할 수 있습니다.

[출처] 대한가정의학회,보건복지부,질병관리본부

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다. GCOOP
COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

퇴행성 관절염(레이저 치료)

꾸준히 재활운동을 하면 관절 기능 회복에 도움이 됩니다.

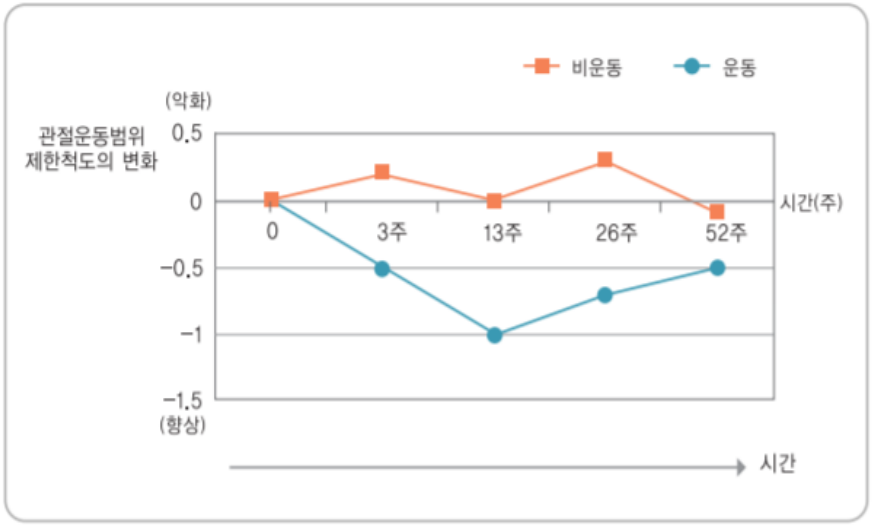

[주] 관절운동범위 제한척도(EPM-ROM) : 낮을수록 좋습니다.

[출처] Rheumatology. 2007;46(11):1712-7.

관절염 환자에서 **체중조절과 물리치료(레이저 치료)** 은
관절의 무리를 줄이고 통증을 감소시키며 질병의 진행을 늦출 수 있습니다.

규칙적인 운동과 레이저 치료는 통증을 줄이고 우울감과 불안감을 개선합니다.

꾸준한 재활과 물리치료(레이저 치료)은 남아 있는 관절 기능을 보존하고,
손실된 운동기능의 회복과 통증 완화에 도움을 줍니다.

단,무리한 재활 운동은 오히려 관절염을 악화시킬 수 있습니다.
따라서 관절의 염증 정도,근육의 상태에 따라 물리치료(레이저 치료)와 운동을 조화롭게 하셔야 치료에 도움을 줍니다.

[출처] 대한가정의학회,보건복지부,질병관리본부

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

본 자료는 내부 교육용 자료 입니다. 외부 유출을 금하여 주시기 바랍니다. GCOOP

Thank you.

COPYRIGHT © 2023 GCOOP All Rights Reserved.

GCOOP