

One pump, one latent space

12 pumps · 32 dimensions · selected by validation reconstruction · colors = cluster


PUMP-01 · PCA
validation 0.138 / test 30.2

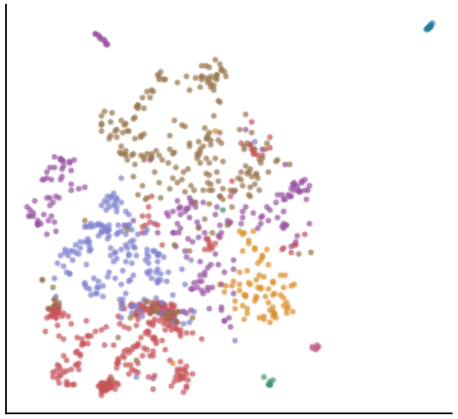


PUMP-02 · PCA
validation 3.74 / test 0.645

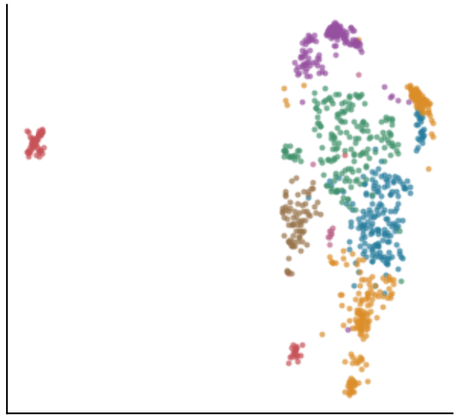


PUMP-03 · PCA
validation 0.00477 / test 0.00322

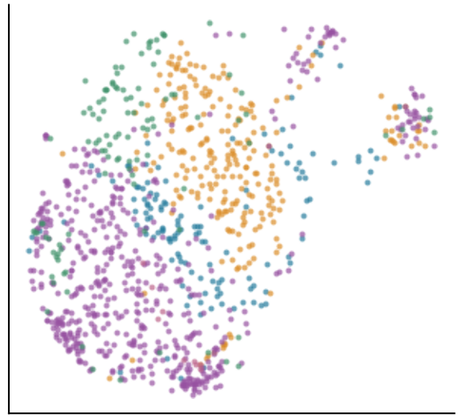


PUMP-04 · PCA
validation 2.18 / test 1.86

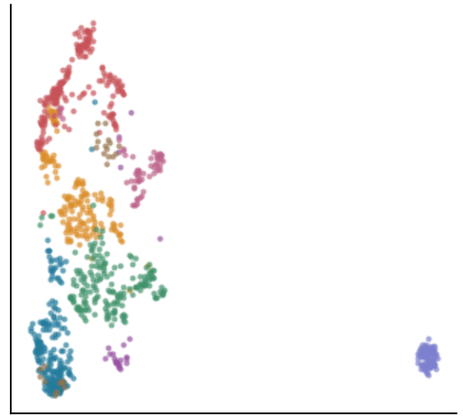


PUMP-05 · PCA
validation 0.0285 / test 0.000947

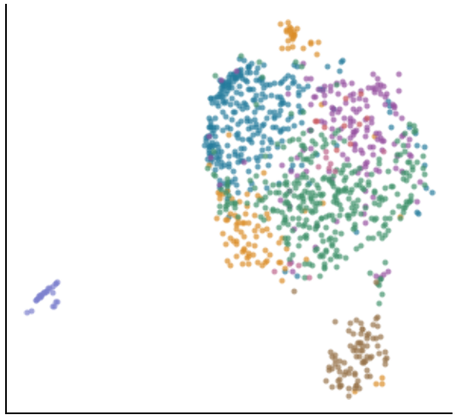


PUMP-06 · PCA
validation 77.2 / test 0.748

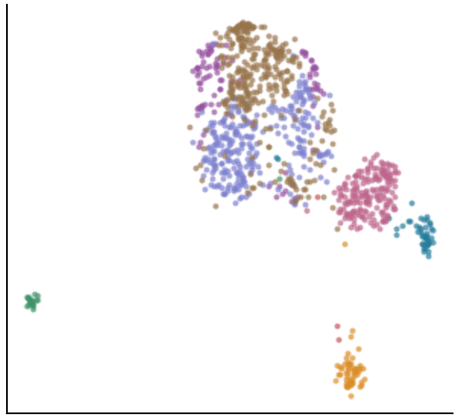


PUMP-07 · PCA
validation 0.306 / test 45.1

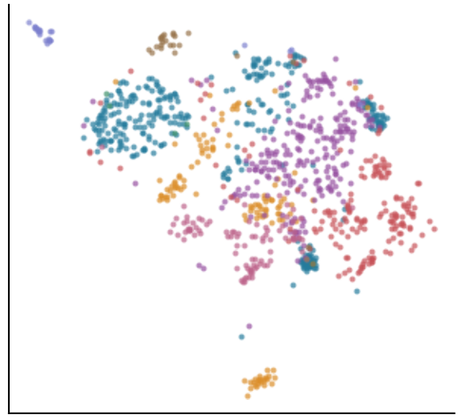


PUMP-08 · Autoencoder
validation 65.4 / test 290

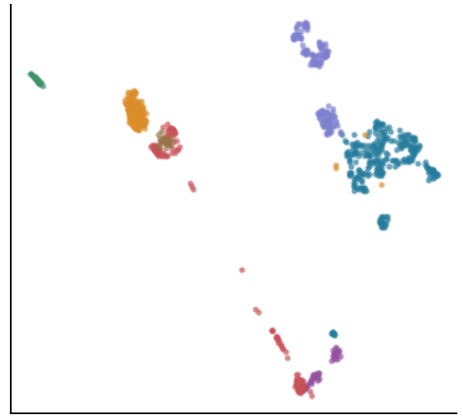


PUMP-09 · PCA
validation 1.27 / test 4.87

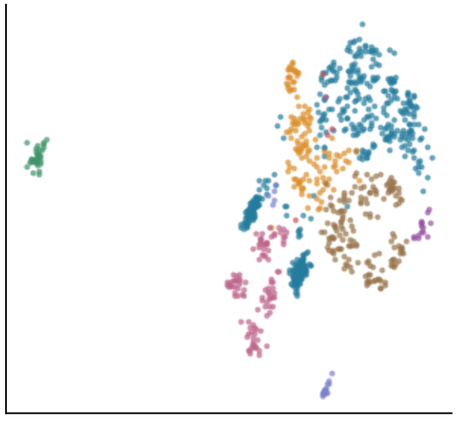


PUMP-10 · PCA
validation 0.358 / test 311

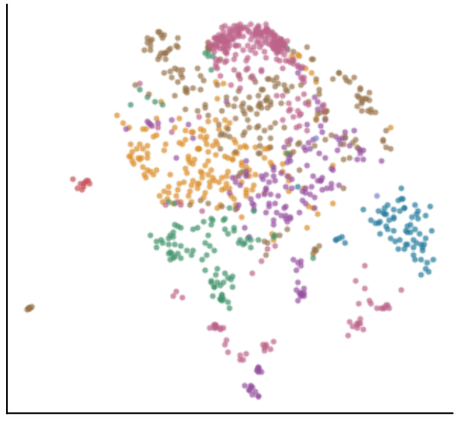

PUMP-11 · PCA
validation 0.0273 / test 0.0736

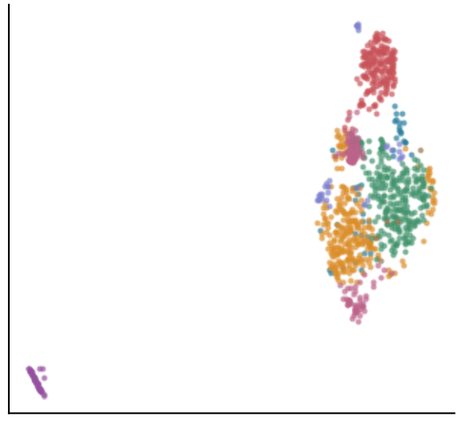

PUMP-12 · PCA
validation 0.342 / test 123

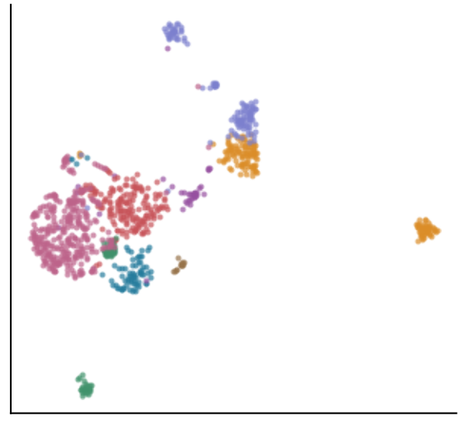

0 1 2 3 4 5 6 7

UMAP fitted to training minutes; held-out minutes transformed. Axes and cluster numbers are local to each pump. Clusters are not fault labels.