


# 体重測定用紙

体重計の表示：73.5kg  
服装（風袋）：1.0kg

DWと【前】体重は**裸の体重**  
(風袋分は予め登録してあり自動で引かれる)

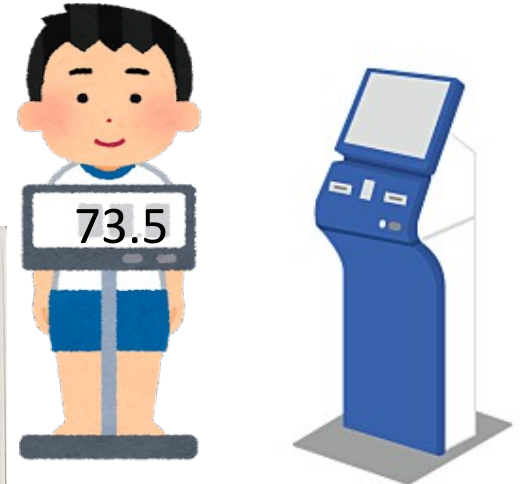

2024/02/17 (土) 18:46:21  
日機装 太郎 様  
ベッドNo : 06  
透析時間 : 4時間00分  
DW : 70.0 kg  
【前】体重 : 72.5 kg  
除水目標値 : 2.7 kg  
引き残し : 0.0 kg

除水目標値=除水量設定



透析経過時間 0:47

| 静脈圧 | 透析液圧 | 除水量積算 | 除水量設定 | 除水速度 |
|-----|------|-------|-------|------|
| 77  | 97   | 0.58  | 2.70  | 0.75 |

IP速度 2.0 [20mL] mL/h

透析液温度 36.0 °C

透析液濃度 14.2 mS/cm

透析液流量 500 mL/min

血流量 180 mL/min

| 測定時刻    | 最高  | 最低 | 平均  | 脈拍 |
|---------|-----|----|-----|----|
| 2 13:51 | 159 | 71 | 102 | 55 |
| 3 14:02 | 180 | 79 | 117 | 58 |
| 4 14:11 | 162 | 75 | 108 | 57 |
| 5 14:21 | 160 | 77 | 105 | 58 |
| 6 14:31 | 145 | 73 | 111 | 54 |

自動測定待ち ( 3 分 )

連続測定

自動測定 10分間隔

開始

設定

IP

計算

D-FAS

3 min

タイマ

工程

緊急補液 0.00L

返血 (D-FAS)

# みたきのルール

## 除水量制限

一回の透析にて血圧低下を防ぐため除水量制限（当日除水量の最大値）を設定している

除水量制限は医師指示で患者によって異なる

**除水量制限<今日の除水量 の場合、引き残しとして表示される**

## リンス

リンスとは透析中に体に入る余分な水のこと

リンス=0.2kg（200ml）

同時脱血はA側・V側両方合わせて約100mlの除水（脱血）を行う  
返血はA側・V側両方合わせて約300ml体内に入る  
→返血時のほうが200ml多い（=**体内へ200ml入る**）

そのため200ml余分にリンス分として除水を行う



# 測定用紙の一例

全て除水量制限3.2kg

DWからの増加量+リンス=除水目標値+引き残し

↳ 【前】 体重 - DW

2024/02/17 (土) 18:46:21

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】 体重 : 72.5 kg

除水目標値 : 2.7 kg

引き残し : 0.0 kg

読み方

$$72.5\text{kg} - 70.0\text{kg} = 2.5\text{kg}$$

【前】 体重                      DW                      DWからの増加量

$$2.5\text{kg} + 0.2\text{kg} = 2.7\text{kg} + 0.0\text{kg}$$

DWからの増加量      リンス                      除水目標値                      引き残し

除水量制限 > 除水目標値 のため引き残し0.0kg

2024/02/17 (土) 18:45:56

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】 体重 : 73.3 kg

除水目標値 : 3.2 kg

引き残し : 0.3 kg

$$73.3\text{kg} - 70.0\text{kg} = 3.3\text{kg}$$

【前】 体重                      DW                      DWからの増加量

$$3.3\text{kg} + 0.2\text{kg} = 3.2\text{kg} + 0.3\text{kg}$$

DWからの増加量      リンス                      除水目標値                      引き残し

除水量制限 < 除水目標値 のため引き残し0.3kg

※この患者は3.5kg除水すればDWまで達する

2024/02/17 (土) 18:46:44

日機装 太郎 様

ベッドNo : 06

透析時間 : 4時間00分

DW : 70.0 kg

【前】 体重 : 69.5 kg

除水目標値 : 0.0 kg

引き残し : 0.0 kg

## コンソールの設定上の注意点

増加量にリンス分(0.2kg)を足した除水目標値が  
0.1kg以上の場合は0.2kgが自動で加算  
除水目標値が0.0kg以下の場合は0.2kg加算されない

$$69.5\text{kg} - 70.0\text{kg} = -0.5\text{kg}$$

【前】 体重                      DW                      DWからの増加量

【前】 体重 < DW のため除水目標値0.0kg

リンス(0.2kg)は加算されていない