

ナフアモスタット

医師からは、  
「ヘパリン初回〇〇単位、持続〇〇単位、カット無し」  
「ナファモスタット〇〇mg/hr」という指示が出る。

しかし、コンソールでは〇〇ml/hrという設定。


※IP：infusion pump → 薬液注入ポンプ



みたきのヘパリン 青:250単位/1ml  
→初回1000単位の指示であれば4ml入れればよい。  
ヘパリンは液体のため、  
そのままコンソールのIPにシリンジをセットできる。


対して、ナファモスタットは粉末。  
→自分で溶かして液体にしなければ  
コンソールにセットできない。

溶かすバイアル数により濃度が変わる。

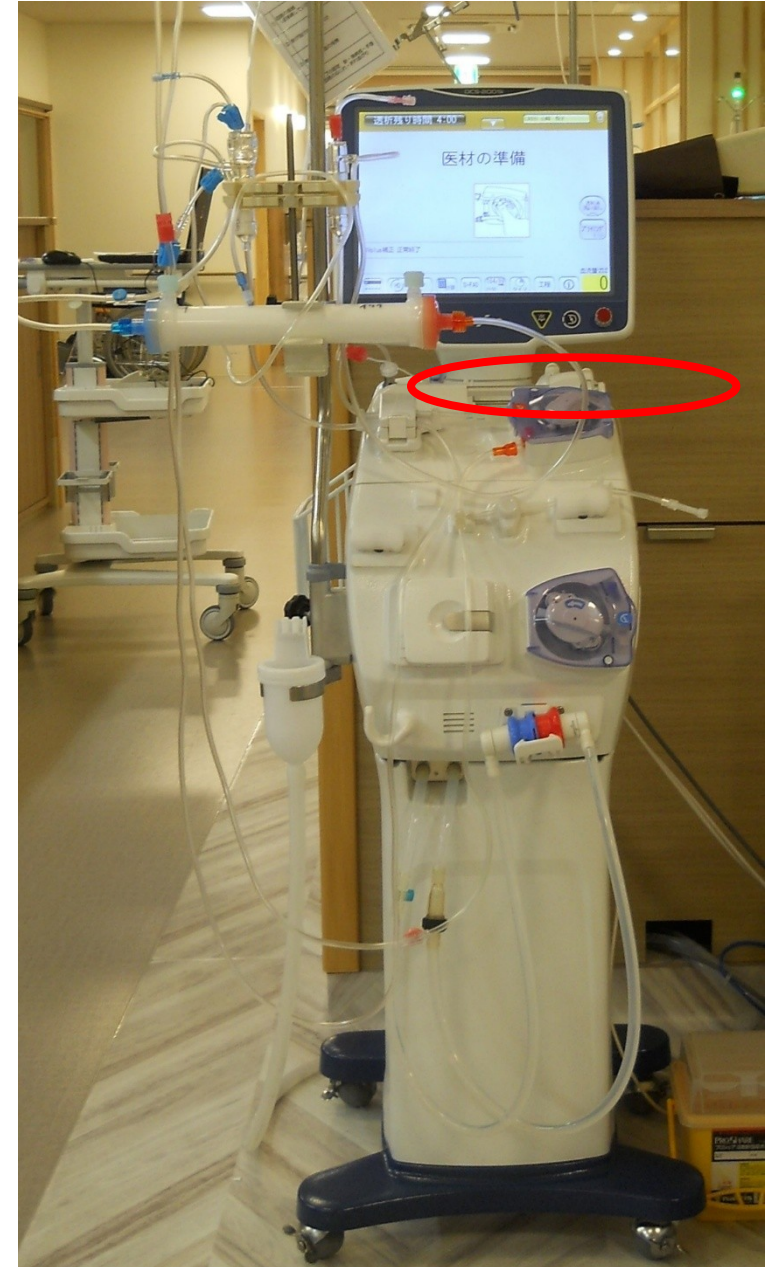

みたきでは

**ナファモスタットの  
バイアル数に関わらず  
20mlブドウ糖液で溶解**する。

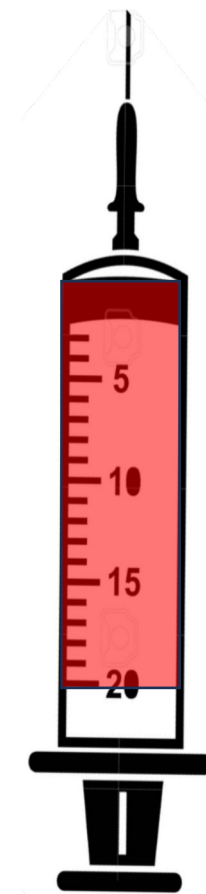



透析時間に応じたバイアル数の準備が必要  
1 バイアルは50mg

例 医師指示「ナファモスタット40mg/hr」

3時間透析→ $3 \times 40 = 120\text{mg}$  → 3 V(150mg)

4時間透析→ $4 \times 40 = 160\text{mg}$  → 4 V(200mg)



# 計算

4 V(200mg)を20mlで溶解


$200\text{mg} \div 20\text{ml} = 10\text{mg/ml}$

1mlあたり10mg溶解

医師指示

「ナファモスタット40mg/hr」

一時間に4ml投与の設定にすればよい

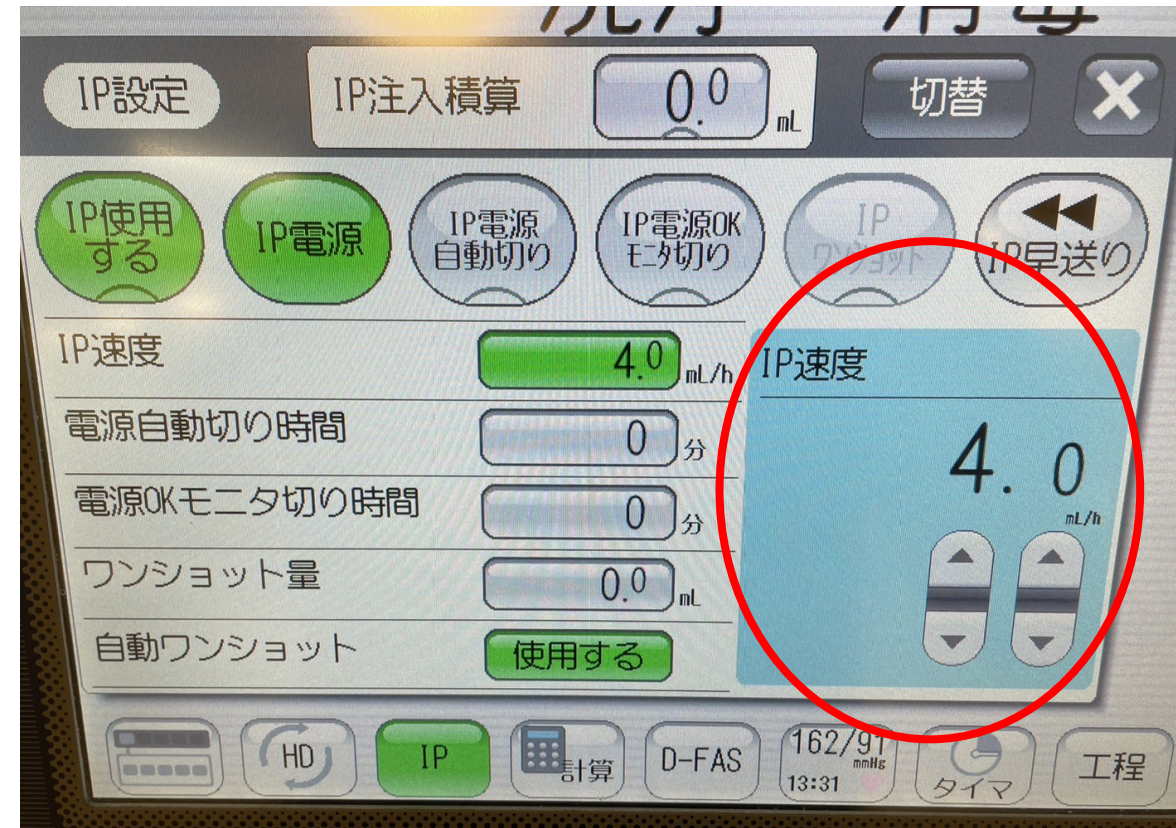

## ポイント！！！！

まず1mlあたり何mgなのか？を計算。



医師指示の〇〇mgを入れるためには  
何ml/hrでIP設定すればよいか？を計算。

# 単位の計算で考える

3V(150mg)を20mlで溶解

$150\text{mg} \div 20\text{ml} = 7.5\text{mg/ml}$  1mlあたり7.5mg溶解

$40\text{mg/hr} \div 7.5\text{mg/ml} = 5.333333 \div 5.3\text{ml/hr}$



# 比で考える

$$150(\text{mg}) : 20(\text{ml}) = X(\text{mg}) : 1(\text{ml})$$

$$20X = 150$$

$$X = 7.5$$

1mlに7.5mg !

$$X(\text{ml}) : 40(\text{mg}) = 1(\text{ml}) : 7.5(\text{mg})$$


$$7.5X = 40$$

$$X = 5.3$$

5.3mlに40mg !

|               |
|---------------|
| 内 × 内 = 外 × 外 |
|---------------|

絵(比の図示)で考える

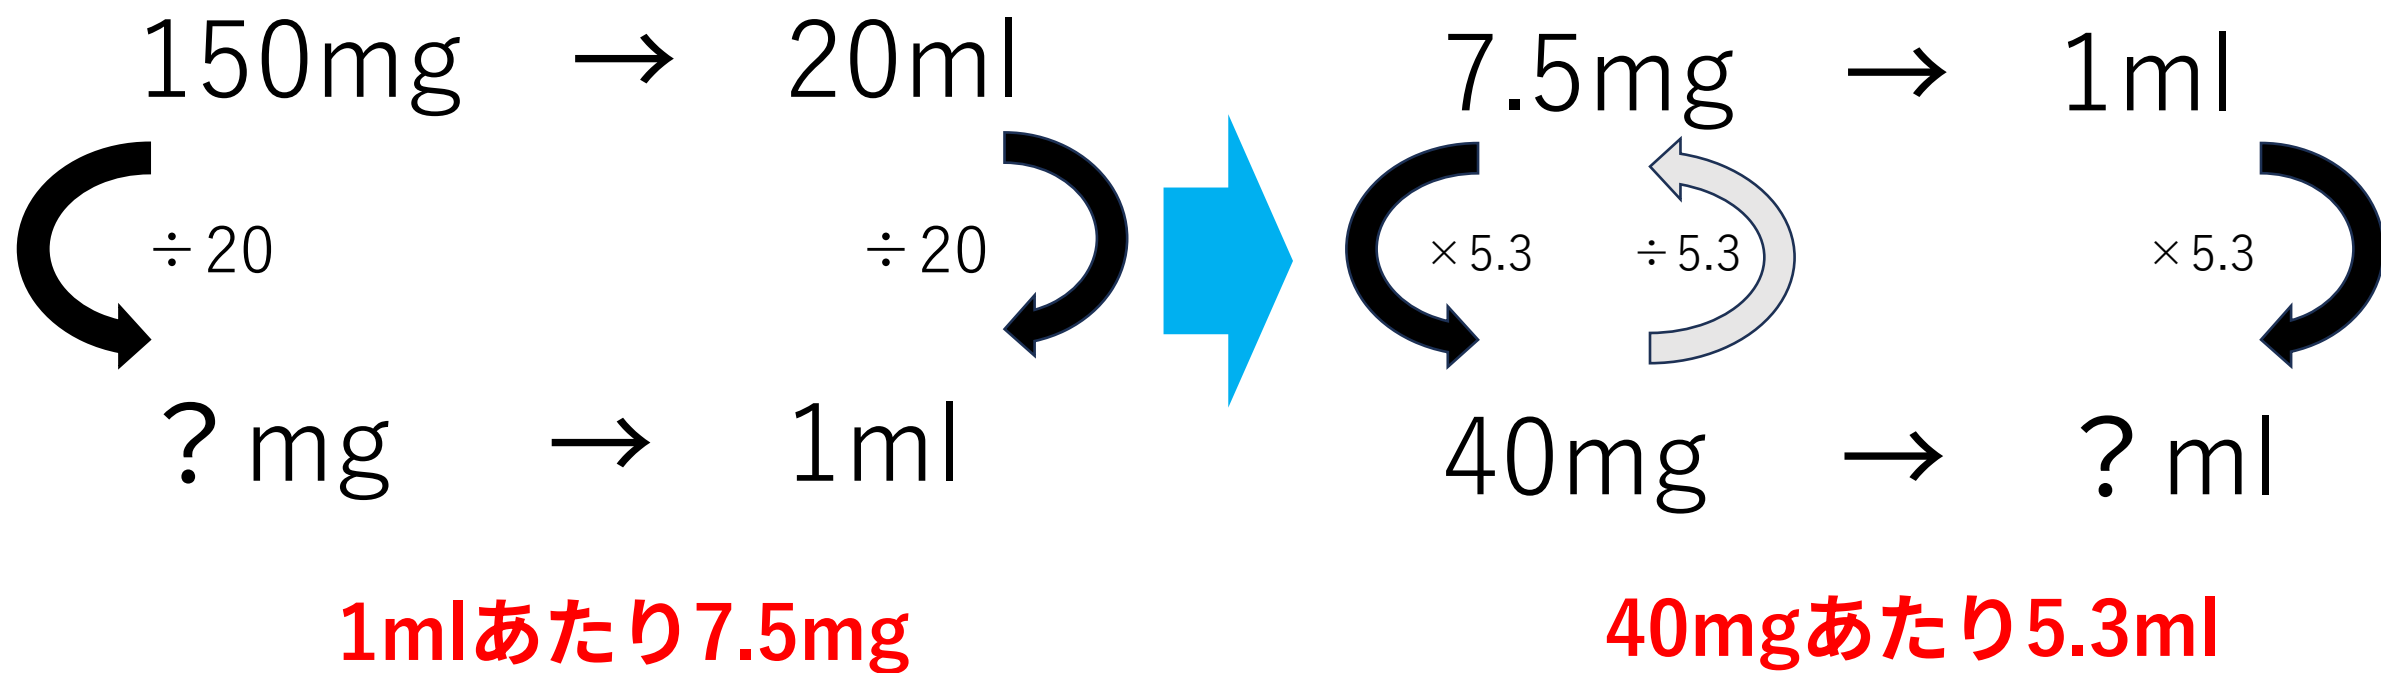

ml/hrで指示受けすると、  
緑ヘパリン（500単位/ml）と青ヘパリン（青250単位/ml）  
どちらを使うかによって体内に入る量が変わったり  
ナファモスタットであれば溶解する液量によって濃度が変わる。  
→ミスの少ない指示は、単位もしくはmg。

コンソールを操作するのは看護師とME。  
医師の指示通りにIP設定を行わなければならない。