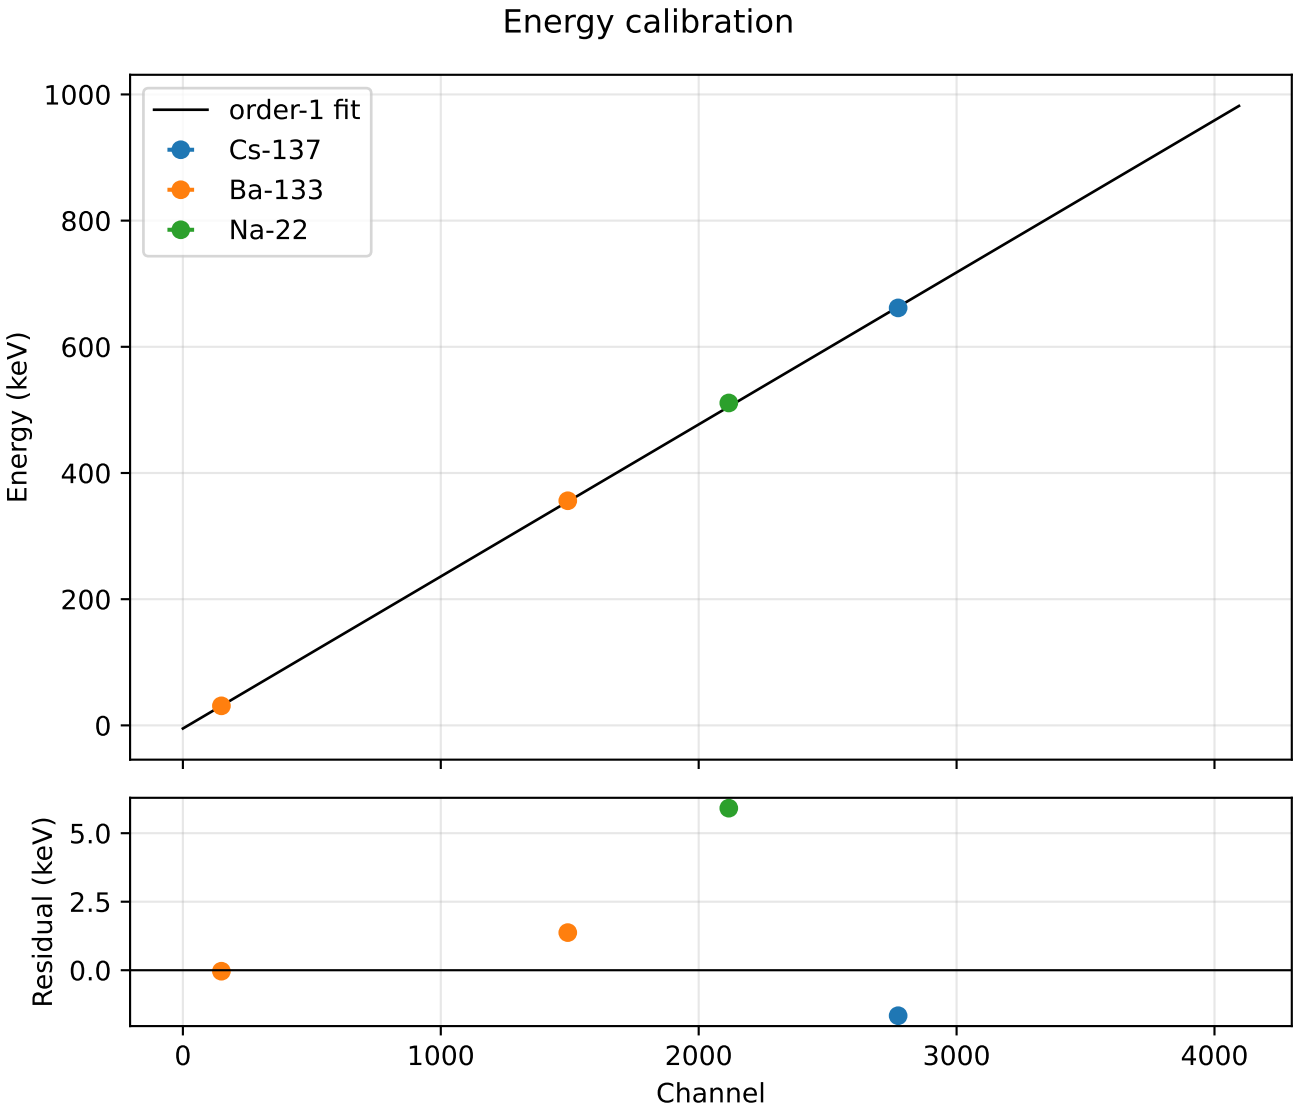
Energy calibration
order-1 fit
Cs-137
Ba-133
Na-22
Energy (keV)
1000
800
600
400
200
0
Residual (keV)
5.0
2.5
0.0
0
1000
2000
3000
4000
Channel