



Field Coincidence QA: Scan_1.dcm
Machine: TrueBeam | Energy: 6x [MV], 600 [MU/min] ☐
Model: Highres ☐
Mode Type : Single ☐
Offset Corr. : true ☐
Gain Corr. : true ☐
Pixel Corr. : true ☐
Averaging : true ☐
Integration : false ☐
Reset Frames : 2

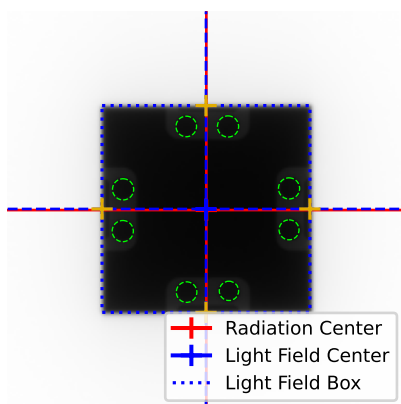

Edge	LF→E (mm)	Rad→E (mm)	Δ (mm)	Result
Top Edge	111.54	112.74	1.20	PASS
Bottom Edge	111.54	110.34	1.20	PASS
Left Edge	112.13	112.53	0.40	PASS
Right Edge	112.13	111.74	0.39	PASS

Field Coincidence QA: Scan_2.dcm
Machine: TrueBeam | Energy: 6x [MV], 600 [MU/min] ☐
Model: Highres ☐
Mode Type : Single ☐
Offset Corr. : true ☐
Gain Corr. : true ☐
Pixel Corr. : true ☐
Averaging : true ☐
Integration : false ☐
Reset Frames : 2

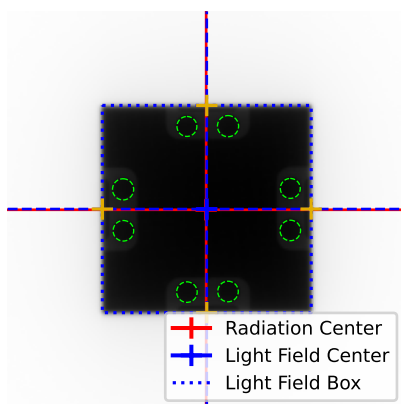

Edge	LF→E (mm)	Rad→E (mm)	Δ (mm)	Result
Top Edge	111.79	112.59	0.79	PASS
Bottom Edge	111.79	111.00	0.79	PASS
Left Edge	112.63	111.98	0.65	PASS
Right Edge	112.63	113.29	0.66	PASS