


Field Coincidence QA: 1-10x10.dcm
Machine: | Energy: 6 [MV], 600 [MU/min]
Acquisition Mode : Highres
XI Acquisition Notes:
Mode Type : Single
Offset Corr. : true
Gain Corr. : true
Pixel Corr. : true
Averaging : true
Integration : false
Reset Frames : 2


Gantry: 360.0° | Couch: 0.0° | Pixel Spacing: 0.336 mm (X), 0.336 mm (Y)

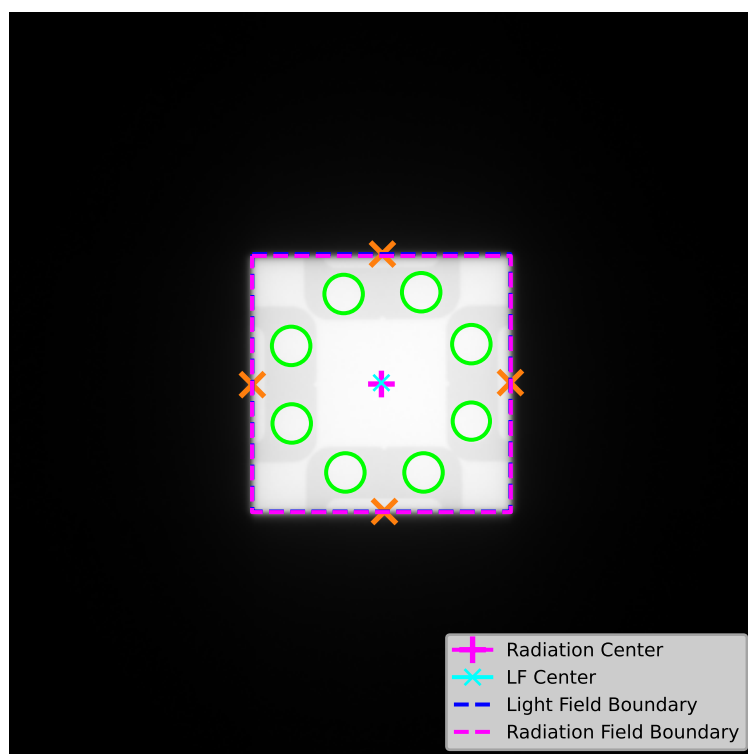

Edge	LF→LF-Center (mm)	RF→CAX (mm)	Δ (mm)	Result
Top	49.44	49.20	0.24	PASS
Bottom	49.45	49.20	0.25	PASS
Left	49.56	49.70	0.15	PASS
Right	49.55	49.70	0.15	PASS
Center Δ	0.48	-	-	PASS

Field Coincidence QA: 2-10x10_45_couch.dcm
Machine: | Energy: 6 [MV], 600 [MU/min]
Acquisition Mode : Highres
XI Acquisition Notes:
Mode Type : Single
Offset Corr. : true
Gain Corr. : true
Pixel Corr. : true
Averaging : true
Integration : false
Reset Frames : 2


Gantry: 360.0° | Couch: 45.0° | Pixel Spacing: 0.336 mm (X), 0.336 mm (Y)

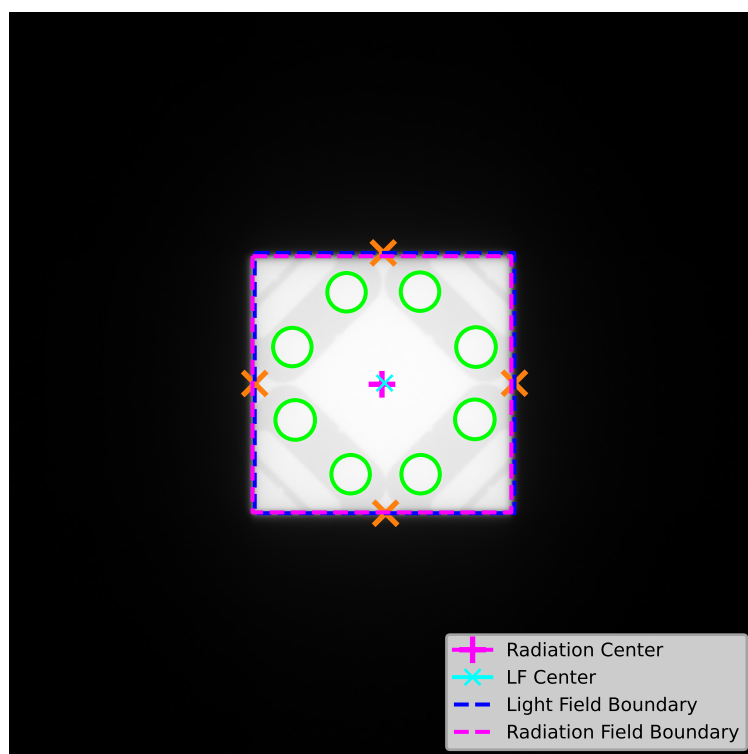

Edge	LF→LF-Center (mm)	RF→CAX (mm)	Δ (mm)	Result
Top	50.00	49.20	0.80	PASS
Bottom	50.00	49.20	0.80	PASS
Left	49.89	49.70	0.19	PASS
Right	49.89	49.70	0.18	PASS
Center Δ	1.12	-	-	PASS

Field Coincidence QA: 3-10x10_90_couch.dcm
Machine: | Energy: 6 [MV], 600 [MU/min]
Acquisition Mode : Highres
XI Acquisition Notes:
Mode Type : Single
Offset Corr. : true
Gain Corr. : true
Pixel Corr. : true
Averaging : true
Integration : false
Reset Frames : 2


Gantry: 360.0° | Couch: 90.0° | Pixel Spacing: 0.336 mm (X), 0.336 mm (Y)

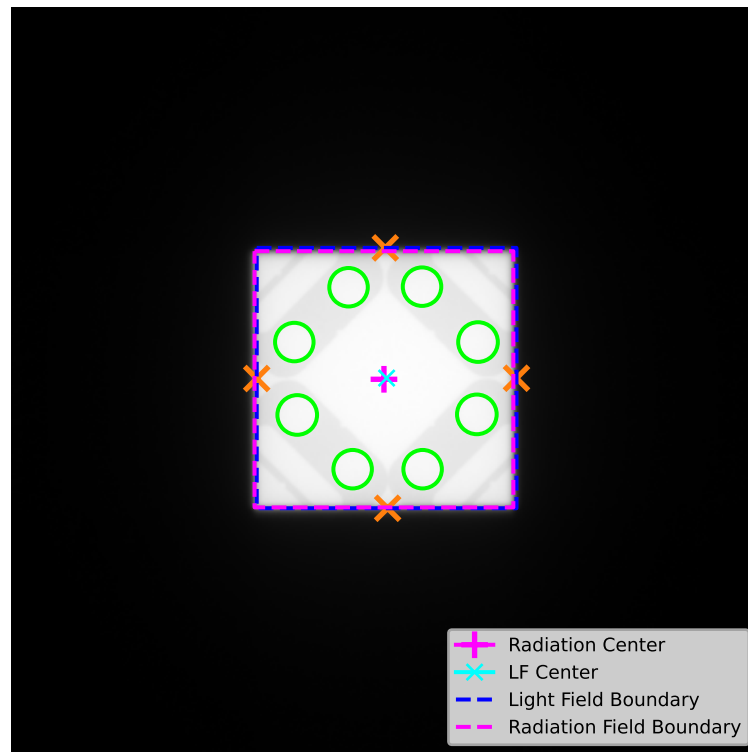

Edge	LF→LF-Center (mm)	RF→CAX (mm)	Δ (mm)	Result
Top	50.00	49.20	0.80	PASS
Bottom	50.00	49.20	0.80	PASS
Left	49.89	49.70	0.19	PASS
Right	49.89	49.70	0.18	PASS
Center Δ	1.12	-	-	PASS

Field Coincidence QA: 4-10x10_45m_couch.dcm
Machine: | Energy: 6 [MV], 600 [MU/min]
Acquisition Mode : Highres
XI Acquisition Notes:
Mode Type : Single
Offset Corr. : true
Gain Corr. : true
Pixel Corr. : true
Averaging : true
Integration : false
Reset Frames : 2


Gantry: 360.0° | Couch: -45.0° | Pixel Spacing: 0.336 mm (X), 0.336 mm (Y)

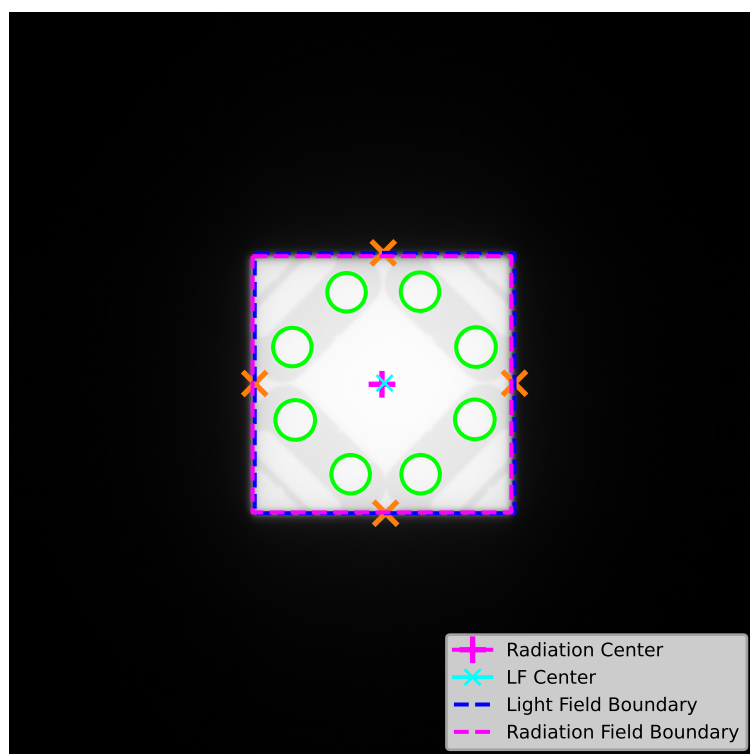

Edge	LF→LF-Center (mm)	RF→CAX (mm)	Δ (mm)	Result
Top	50.00	49.20	0.80	PASS
Bottom	50.00	49.20	0.80	PASS
Left	49.89	49.70	0.19	PASS
Right	49.89	49.70	0.18	PASS
Center Δ	1.12	-	-	PASS

Field Coincidence QA: 5-10x10_90m_couch.dcm
Machine: | Energy: 6 [MV], 600 [MU/min]
Acquisition Mode : Highres
XI Acquisition Notes:
Mode Type : Single
Offset Corr. : true
Gain Corr. : true
Pixel Corr. : true
Averaging : true
Integration : false
Reset Frames : 2


Gantry: 360.0° | Couch: -90.0° | Pixel Spacing: 0.336 mm (X), 0.336 mm (Y)

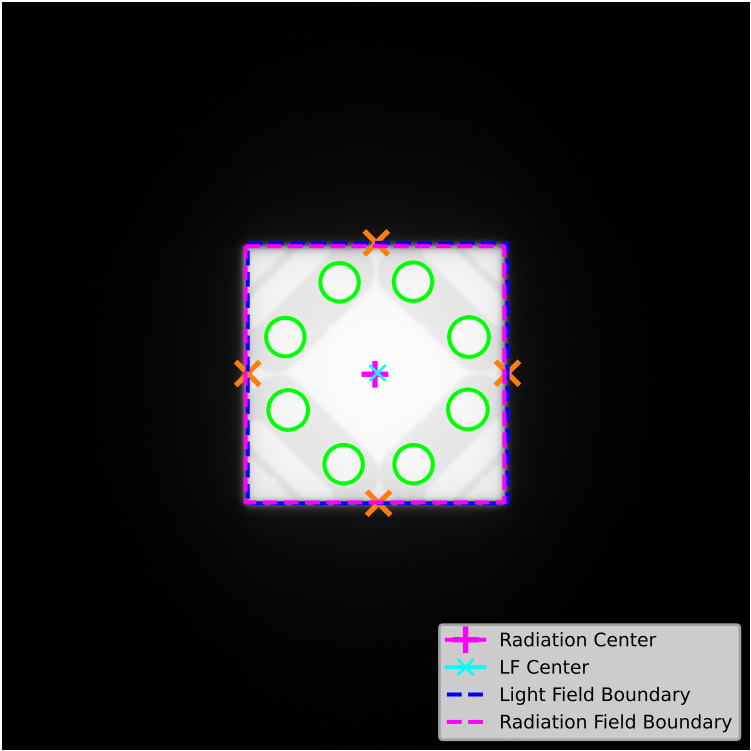

Edge	LF→LF-Center (mm)	RF→CAX (mm)	Δ (mm)	Result
Top	50.00	49.20	0.80	PASS
Bottom	50.00	49.20	0.80	PASS
Left	49.89	49.70	0.19	PASS
Right	49.89	49.70	0.18	PASS
Center Δ	1.12	-	-	PASS

Field Coincidence QA: Face_Phantom_6MeV_Scan.dcm
Machine: TrueBeam | Energy: 6x [MV], 600 [MU/min] ☐
Model: Highres ☐
Mode Type : Single ☐
Offset Corr. : true ☐
Gain Corr. : true ☐
Pixel Corr. : true ☐
Averaging : true ☐
Integration : false ☐
Reset Frames : 2

Gantry: 0.0° | Couch: 0.0° | Pixel Spacing: 0.336 mm (X), 0.336 mm (Y)

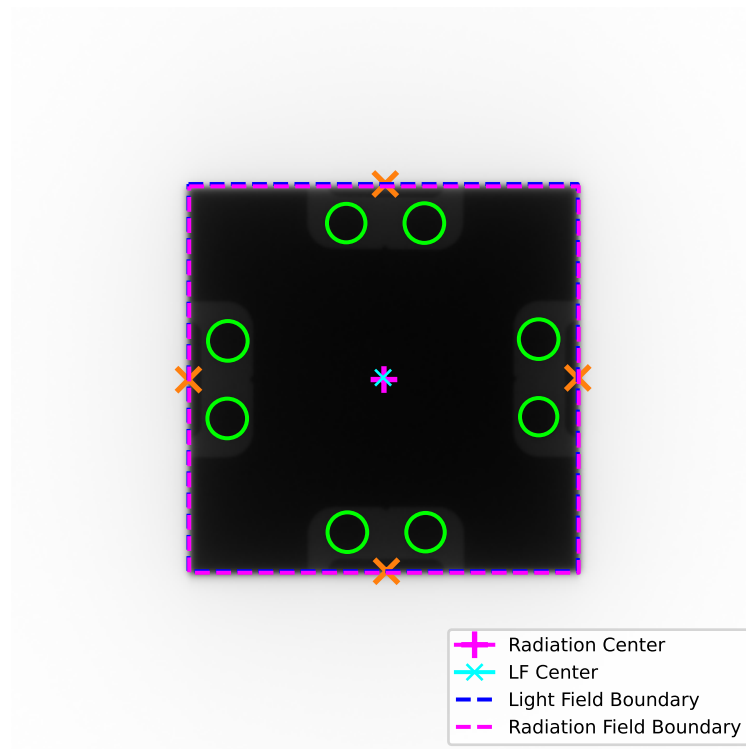

Edge	LF→LF-Center (mm)	RF→CAX (mm)	Δ (mm)	Result
Top	74.36	74.20	0.16	PASS
Bottom	74.37	74.20	0.17	PASS
Left	74.75	74.80	0.05	PASS
Right	74.75	74.80	0.05	PASS
Center Δ	0.80	-	-	PASS