

1) Dados do Cliente

Cliente:	FILIVALE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS	C.N.P.J.:	39.043.344/0001-13	Estado:	SP
Endereço:	RUA BACABAL, N:1460	Cidade:	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Unidade:	-
Responsável:	ROGERIO				

2) Informações Técnicas

Tipo de Balança	Marca	Modelo	Número de Série	Faixa de Indicação	d	e	Unidade
Balança Semi-Analítica	MARTE	AD 2000	123456	1ª 2.000	0,5	0,5	g
Local da Calibração	Etiqueta IPEM	TAG	Tipo de Plataforma	2ª	3ª		
CLIENTE	10.000.793-0	123456	Retangular ou Quadrada	--	--	--	--


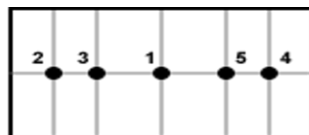
3) Condições Ambientais (Durante a calibração)

Temperatura:	23,0 °C ± 0,5	Umidade Relativa:	55 % ± 3	Pressão Atmosférica:	1017 hPA ± 2	Massa específica do ar:	1,19 kg/m³
Termo-baro-higrômetro:	BRM-137	Certificado número:	LV08071-10249-25-R0	Data da Calibração:	25/04/2025	Data de Validade:	25/04/2027
		Certificado número:	LV08071-10250-25-R0	Data da Calibração:	05/05/2025	Data de Validade:	05/05/2027

4) Padrões de Referência

Número do Certificado	Data de Calibração	Data de Validade	Rastreabilidade	Número do Certificado	Data de Calibração	Data de Validade	Rastreabilidade
533/2024	18/07/2024	18/07/2026	CAL 0529	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5) Ensaio de Excentricidade

Erros		Tipos de Plataforma			
Antes do Ajuste	Resultados	Local na plataforma onde foi aplicado a carga			
1	1.000,0 g	1.000,0 g	 Plataforma Retangular ou Quadrada		
2	1.000,0 g	1.000,0 g		 Plataforma Redonda	
3	1.000,0 g	1.000,0 g			 Plataforma Rodoviária
4	1.000,0 g	1.000,0 g			
5	1.000,0 g	1.000,0 g			

6) Ensaio de Repetibilidade

Resultados Obtidos Antes do Ajuste		
Valor de Referência	Leitura 01	Erro de Indicação
10,0 g	10,0 g	0,0 g
100,0 g	100,5 g	0,5 g
400,0 g	399,0 g	-1,0 g
1.000,0 g	999,5 g	-0,5 g
1.400,0 g	1400,5 g	0,5 g
2.000,0 g	1999,0 g	-1,0 g
-----	-----	-----

Resultados Obtidos					
Valor de Referência	Média das Leituras	Erro de Indicação	Incerteza Expandida	Veff	k
10,0 g	10,5 g	0,5 g	1,0 g	6	2,52
100,0 g	100,0 g	0,0 g	1,0 g	6	2,52
400,0 g	400,5 g	0,5 g	2,0 g	3	4,53
1.000,0 g	999,5 g	-0,5 g	1,0 g	6	2,52
1.400,0 g	1401,0 g	1,0 g	2,5 g	2	4,53
2.000,0 g	1999,5 g	-0,5 g	2,0 g	3	4,53
-----	-----	-----	-----	-----	-----


Guilherme Rodrigues
SIGNATÁRIO

Data da calibração: 07/07/2026
Data da emissão do Certificado: 07/07/2026

7) Observação:

- 1 - A calibração foi realizada nas instalações do Cliente. Este certificado é válido apenas para a balança calibrada. Uma cópia deste certificado será arquivada por cinco anos.
- 2 - Este certificado só poderá ser usado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela Filivale - Balanças e Equipamentos.
- 3 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. A calibração foi realizada utilizando peso padrão de propriedade da Filivale - Balanças e Equipamentos rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades.
- 4 - A calibração foi realizada pelo método de comparação direta, conforme procedimento interno: PR-7.2 Calibração de Balanças Rev.: 02
- 5 - Esta calibração não isenta a balança do controle estabelecido da Regulamentação Metrológica.
- 6 - O ajuste do equipamento, quando realizado, não faz parte do escopo acreditado do laboratório.

"Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0846."

Filivale - Balanças e Equipamentos
Tel.: (12) 3931-4833 - E-mail: contato@filivale.com.br
Avenida Cabacal, 1460 - Parque Industrial - CEP 12235-680 - São José dos Campos - SP

