

## El uso de termopares

Hoja técnica WIKA IN 00.23

En la instrumentación eléctrica de temperatura en el sector industrial se utilizan principalmente dos grupos de sensores:

- Termorresistencia (RTD)
- Termopares (TC)

Ambos tipos de sensores tienen sus ventajas y desventajas. El punto fuerte de las termorresistencias -mayormente Pt100- se encuentra en el rango de temperatura inferior hasta medio (-200 ... +600 °C). Los termopares, por el contrario, tienen sus ventajas (con solo algunas excepciones) en el rango de temperaturas (hasta 1600 °C). Algunos termopares pueden registrar temperaturas aún más elevadas (tungsteno-renio, oro-platino o platino-paladio). Estos termopares, muy especiales, no se describen en el presente documento.

Mientras que en Europa se utilizan preferentemente sensores Pt100 para la medición de temperaturas bajas y medias, en América del Norte se constata una mayor preponderancia del uso de termopares. Sin embargo, no es posible efectuar una división general de campos de aplicación, dado que, por ejemplo, una refinería construida en Europa es dotada con tecnología de medición de temperatura apoyada en estándares norteamericanos, si la planta ha sido proyectada en los EE.UU. Lo mismo vale por supuesto en la dirección inversa.


Otro criterio para decidirse por un termopar es el diámetro lo más reducido posible de un termopar con revestimiento (véase el capítulo "Termopares con revestimiento"). Los diámetros de 0,25 mm, 0,5 mm o 1 mm tienen tiempos de respuesta asombrosamente reducidos.

¡En general, los termopares reaccionan más rápido que las termorresistencias!

Si se monta el termómetro en una vaina, los tiempos de respuesta de ambos grupos de sensores se aproximan. La masa de la vaina, la disipación de calor y los tramos de aislamiento entre medio y sensor relativizan aquí la ventaja de velocidad del termopar. Si bien ésta puede aún medirse, es frecuentemente irrelevante, dado que, por ejemplo, en vainas de material sólido el margen de tiempo puede moverse enteramente en un intervalo de minuto de dos dígitos.



**Termopar recto con vaina de metal**

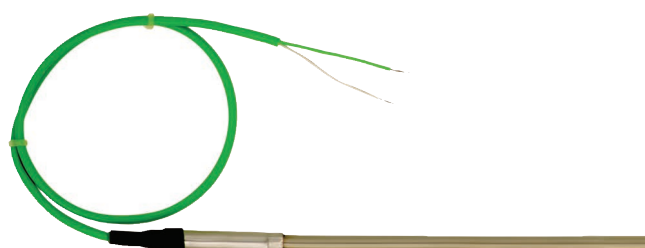


**Termopar de cable, modelo TC40  
(Estructura: cable con cubierta (cable MI))**



**Ejemplos de vainas**


## Principios básicos

Un termopar consta de dos filamentos de materiales diferentes, unidos en un extremo para formar un termopar, constituyendo el nodo de unión el punto de medición.

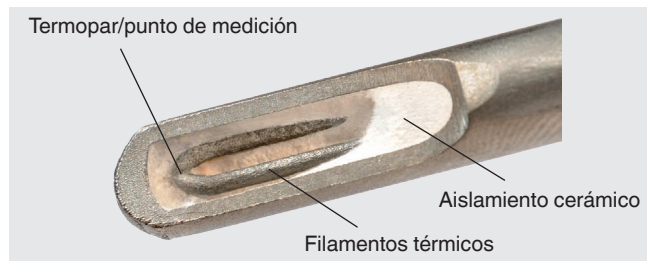

Al calentarse el punto de medición, se mide en los extremos de los filamentos (zona fría) una tensión que es aproximadamente proporcional a la temperatura del punto de medición.

(efecto termoeléctrico = efecto de Seebeck)

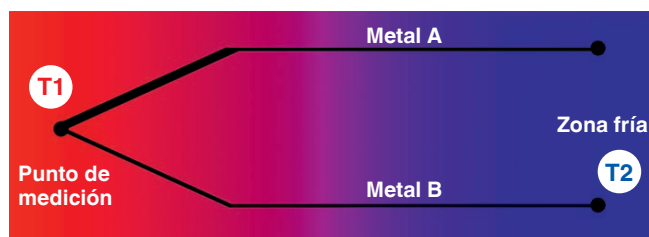

Dicha tensión (FEM = fuerza electro-motriz) se produce por un lado debido a la diferente densidad de electrones de ambos materiales metálicos (diferentes) utilizados en los filamentos, y por otro lado debido a la diferencia de temperatura entre el punto de medición y la zona fría.

Esto significa que un termopar no mide la temperatura absoluta, sino la temperatura diferencial entre el

- **T1**: punto de medición (hot junction)  
y la
- **T2**: zona fría (cold junction)

Dado que la medición de la tensión se realiza frecuentemente a temperatura ambiente, la tensión indicada sería inferior en un valor equivalente a la tensión de la temperatura ambiente. Para obtener el valor absoluto de la temperatura del punto de medición se aplica la llamada "compensación de la zona fría".

Ello se logró en el pasado (y aún hoy en día en el laboratorio de calibración) mediante un baño de hielo, al cual se sometía la toma del instrumento medidor de la tensión en la zona fría del termopar.

Los instrumentos actuales con entrada para termopar (p. ej. transmisores, medidores manuales o dispositivos para montaje en paneles, etc.) llevan incorporada una compensación electrónica de zona fría en su circuito.

Cada metal tiene una electronegatividad específica del material. (electronegatividad = tendencia de los átomos a desprenderse de o a absorber preferentemente electrones)

Para lograr tensiones térmicas lo más elevadas posibles, se emplean combinaciones especiales de materiales para formar termopares, cuyas electronegatividades individuales sean lo más diferentes posibles. Estas combinaciones de materiales tienen obviamente límites -por ejemplo debido a la temperatura máxima de utilización del termopar.

### Las siguientes normas definen los termopares

- IEC 60584-1: Termopares: Valores básicos de las tensiones térmicas
- IEC 60584-2: Termopares: Tolerancias de las tensiones térmicas
- IEC 60584-3: Termopares: Cables de extensión y cables de compensación

### ASTM E230:

Tablas con especificaciones estándar y fuerza electro-motriz (FEM) para termopares estandarizados.

## Tensiones térmicas

Temperatura de referencia: 0 °C

Temperatura en °C	Termopares							
	Tipo K	Tipo J	Tipo N	Tipo E	Tipo T	Tipo S	Tipo R	Tipo B
-200					-5,603			
-180					-5,261			
-160					-4,865			
-140					-4,419			
-120					-3,923			
-100					-3,379			
-80					-2,788			
-60					-2,153			
-40	-1,527	-1,961	-1,023	-2,255	-1,475			
-20	-0,777	-0,995	-0,518	-1,152	-0,757			
0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	0,798	1,019	0,525	1,192	0,790	0,113	0,111	
40	1,612	2,059	1,065	2,420	1,612	0,235	0,232	
60	2,436	3,116	1,619	3,685	2,467	0,365	0,363	
80	3,267	4,187	2,189	4,985	3,358	0,502	0,501	
100	4,096	5,269	2,774	6,319	4,279	0,646	0,647	
150	6,138	8,010	4,302	9,789	6,704	1,029	1,041	
200	8,138	10,779	5,913	13,421	9,288	1,441	1,469	
250	10,153	13,555	7,597	17,181	12,013	1,874	1,923	
300	12,209	16,327	9,341	21,036	14,862	2,323	2,401	
350	14,293	19,090	11,136	24,964	17,819	2,786	2,896	
370	15,133	20,194	11,867	26,552	19,030	2,974	3,099	
400	16,397	21,848	12,974	28,946		3,259	3,408	
450	18,516	24,610	14,846	32,965		3,742	3,933	
500	20,644	27,393	16,748	37,005		4,233	4,471	
550	22,776	30,216	18,672	41,053		4,732	5,021	
600	24,905	33,102	20,613	45,093		5,239	5,583	1,792
650	27,025	36,071	22,566	49,116		5,753	6,041	2,101
700	29,129	39,132	24,527	53,112		6,275	6,743	2,431
750	31,213	42,281	26,491	57,080		6,806	7,340	2,782
760	31,628	42,919	26,883	57,970		6,913	7,461	2,854
800	33,275		28,455	61,017		7,345	7,950	3,154
850	35,313		30,416	64,922		7,893	8,571	3,546
870	36,121		31,199	66,473		8,114	8,823	3,708
900	37,326		32,371	68,787		8,449	9,205	3,957
950	39,314		34,319			9,014	9,850	4,387
1000	41,276		36,256			9,587	10,506	4,834
1050	43,211		38,179			10,168	11,173	5,299
1100	45,119		40,087			10,757	11,850	5,780
1150	46,995		41,976			11,351	12,535	6,276
1200	48,838		43,846			11,951	13,228	6,786
1250	50,644		45,694			12,554	13,926	7,311
1260	51,000		46,060			12,675	14,066	7,417
1300						13,159	14,629	7,848
1350						13,766	15,334	8,397
1400						14,373	16,040	8,956
1450						14,978	16,746	9,524
1480						15,341	17,169	9,868
1500						15,582	17,451	10,099
1550						16,182	18,152	10,679
1600						16,777	18,849	11,263
1650								11,850
1700								12,430

### Leyenda:


Negro: IEC 60584-1 y ASTM E230

Azul: solo IEC 60584-1


Rojo: solo ASTM E230

## Curvas de tensión térmica

■ IEC 60584-2

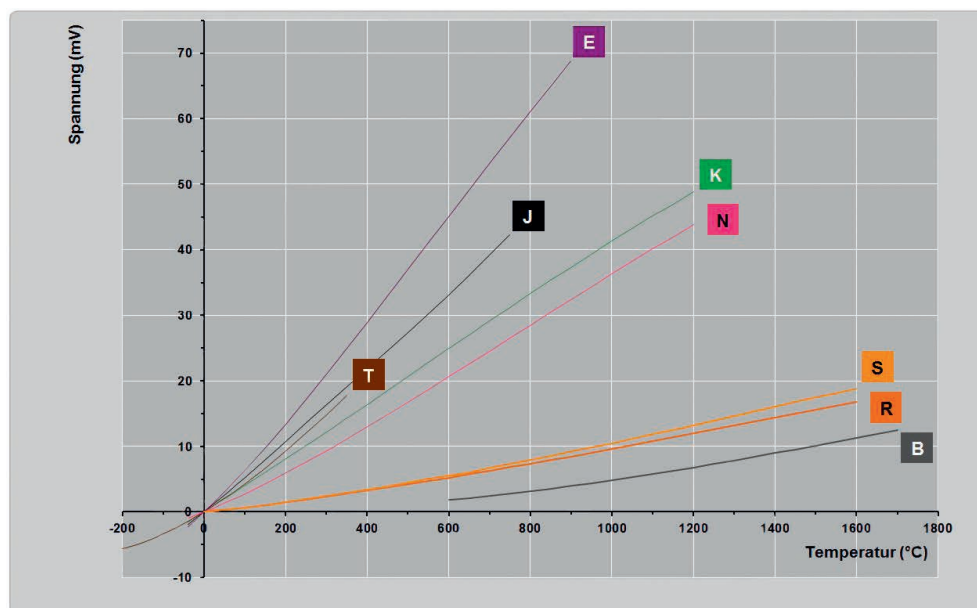

■ ASTM E230

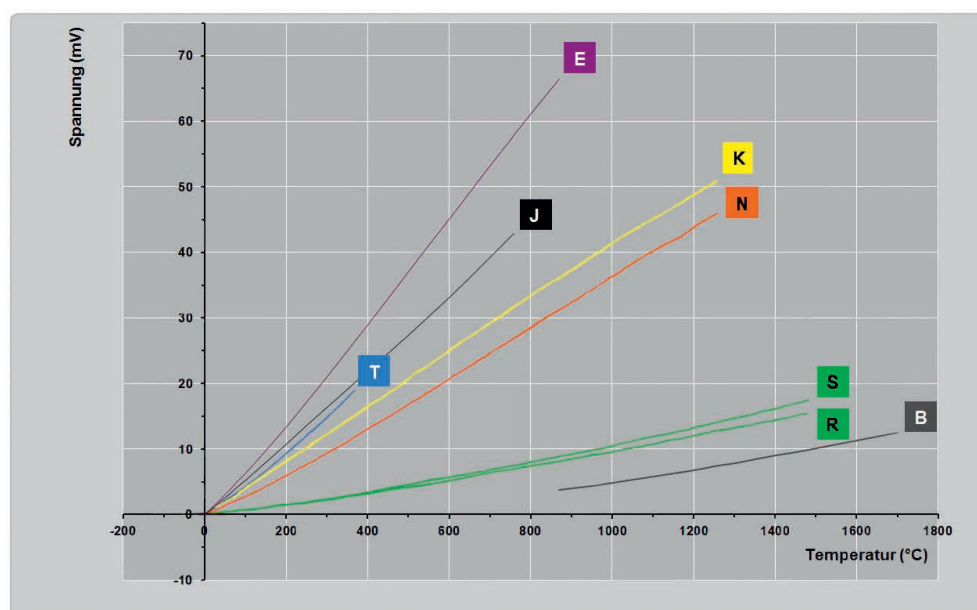

Las curvas representadas corresponden a los respectivos rangos de temperatura de la norma IEC 60584-2 / ASTM E230. Fuera de dichos rangos, la desviación límite no está estandarizada.

## Límites de uso y exactitudes los termopares (IEC 60584, ASTM E230)

La siguiente tabla contiene las desviaciones límite admisibles de la norma IEC 60584-2, incl. las tolerancias de la ASTM E230 aplicable en el ámbito norteamericano.

### Desviaciones límite de los termopares conforme a IEC 60584-2 / ASTM E230 (temperatura de referencia 0 °C)

Modelo	Termopar	Desviación límite según	Clase	Rango de temperatura	Desviación límite
K N	NiCr-Ni (NiCr-NiAl)	IEC 60584 parte 2	1	-40 ... +1000 °C	±1,5 °C o 0,0040 ·  t  <sup>1) 2)</sup>
			2	-40 ... +1200 °C	±2,5 °C o 0,0075 ·  t
	NiCrSi-NiSi	ASTM E230	Especial	0 ... +1260 °C	±1,1 °C o ±0,4 %
			Estándar	0 ... +1260 °C	±2,2 °C o ±0,75 %
J	Fe-CuNi	IEC 60584 parte 2	1	-40 ... +750 °C	±1,5 °C o 0,0040 ·  t
			2	-40 ... +750 °C	±2,5 °C o 0,0075 ·  t
		ASTM E230	Especial	0 ... +760 °C	±1,1 °C o ±0,4 %
			Estándar	0 ... +760 °C	±2,2 °C o ±0,75 %
E	NiCr-CuNi	IEC 60584 parte 2	1	-40 ... +800 °C	±1,5 °C o 0,0040 ·  t
			2	-40 ... +900 °C	±2,5 °C o 0,0075 ·  t
		ASTM E230	Especial	0 ... +870 °C	±1,0 °C o ±0,4 %
			Estándar	0 ... +870 °C	±1,7 °C o ±0,5 %
T	Cu-CuNi	IEC 60584 parte 2	1	-40 ... +350 °C	±0,5 °C o 0,0040 ·  t
			2	-40 ... +350 °C	±1,0 °C o 0,0075 ·  t
			3	-200 ... +40 °C	±1,0 °C o 0,015 ·  t
		ASTM E230	Especial	0 ... +370 °C	±0,5 °C o ±0,4 %
			Estándar	-200 ... 0 °C	±1,0 °C o ±1,5 %
			Estándar	0 ... +370 °C	±1,0 °C o ±0,75 %
R S	Pt13%Rh-Pt	IEC 60584 parte 2	1	0 ... +1600 °C	±1,0 °C o ±[1 + 0,003 (t - 1100)] °C
			2	0 ... +1600 °C	±1,5 °C o ±0,0025 ·  t
	Pt10%Rh-Pt	ASTM E230	Especial	0 ... +1480 °C	±0,6 °C o ±0,1 %
			Estándar	0 ... +1480 °C	±1,5 °C o ±0,25 %
B	Pt30%Rh-Pt6%Rh	IEC 60584 parte 2	2	+600... +1700 °C	±0,0025 ·  t
			3	+600... +1700 °C	±4,0 °C o ±0,005 ·  t
		ASTM E230	Especial	-	-
			Estándar	+870... +1700 °C	±0,5 %

1) |t| es el valor numérico de la temperatura en °C sin considerar el signo.

2) El valor más grande es válido


En Europa y América del Norte hay diferentes formas de escribir los termopares tipo K:

Europa: NiCr-Ni o NiCr-NiAl

América del Norte: Ni-Cr / Ni-Al

No hay ninguna diferencia importante, los dos nombres son históricos.

La desviación límite del termopar se mide con la comparación de la punta fría a 0 °C. En caso de aplicar un cable de compensación o un cable de extensión hay que considerar un error de medición adicional.

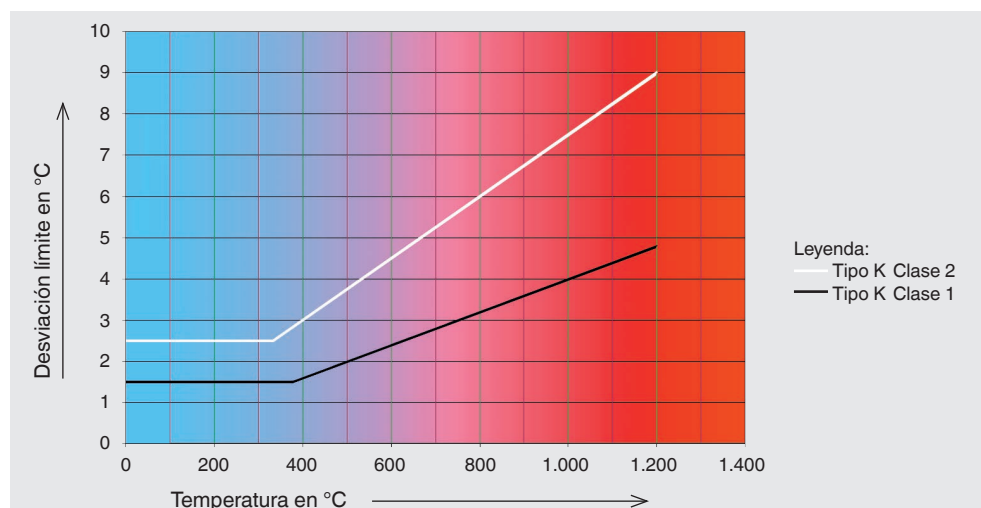

Ejemplo:  
Límite de desviación de las clases de exactitud 1 y 2 del termopar tipo K

# Información sobre la utilización de termopares

## ■ Termopares comunes

### Tipo K

Pierna +	Pierna -
NiCr	- NiAl
Cromo-níquel	- Aluminio-níquel (magnético)

Los termopares de NiCr-NiAl son ideales para utilización en atmósferas oxidantes o de gas inerte hasta 1200 °C (ASTM E230: 1260 °C) con el máximo espesor de filamento. Proteger los termopares de atmósferas que contengan azufre. Dado que su susceptibilidad a la oxidación es menor que la de termopares de otro material, se utilizan mayormente para temperaturas superiores a 550 °C.

### Tipo J

Pierna +	Pierna -
Fe	- CuNi
Hierro (magnético)	- Cobre-níquel

Los termopares de Fe-CuNi son ideales para el uso en vacío, en atmósferas oxidantes y reductoras o atmósferas de gas inerte. Se utilizan para mediciones de temperatura hasta 750 °C (ASTM E230: 760 °C) con el máximo espesor de filamento.

### Tipo N

Pierna +	Pierna -
NiCrSi	- NiSi
Cromo-níquel-silicio	- Níquel-silicio

Los termopares de NiCrSi-NiSi son ideales para su utilización en atmósferas oxidantes, en atmósferas de gas inerte o en atmósferas reductoras hasta 1200 °C (ASTM E230: 1260 °C). Deben protegerse de atmósferas con contenido de azufre. Son muy exactos a temperaturas elevadas. La tensión de fuente (EMF) y el rango de temperatura son prácticamente iguales a los del tipo K. Se utilizan en aplicaciones en las cuales se requiere una prolongada vida útil y una mayor estabilidad.

### Tipo E

Pierna +	Pierna -
NiCr	- CuNi
Cromo-níquel	- Cobre-níquel

Los termopares de NiCr-CuNi son ideales para utilización en atmósferas oxidantes o de gas inerte hasta 900 °C (ASTM E230: 870 °C) con el máximo espesor de filamento. Los termopares de tipo E desarrollan, entre todos los termopares utilizados, normalmente la máxima tensión de fuente (EMF) por °C.

### Tipo T

Pierna +	Pierna -
Cu	- CuNi
Cobre	- Cobre-níquel

Los termopares de Cu-CuNi son ideales para temperaturas bajo 0 °C con un límite máximo de temperatura de 350 °C (ASTM E230: 370 °C) y pueden utilizarse en atmósferas oxidantes, reductoras o de gas inerte. No se oxidan en atmósferas húmedas.

## ■ Termopares de metales nobles

### Tipo S

Pierna +	Pierna -
Pt10%Rh	- Pt
Platino-10 % rodio	- Platino

Los termopares tipo S son ideales para el uso continuo en atmósferas oxidantes o de gas inerte con temperaturas de hasta 1600 °C. No pueden introducirse en una vaina metálica. Tener en cuenta la fragilidad causada por la contaminación.

### Tipo R

Pierna +	Pierna -
Pt13%Rh	- Pt
Platino-13 % rodio	- Platino

Los termopares tipo R son ideales para el uso continuo en atmósferas oxidantes o de gas inerte con temperaturas de hasta 1600 °C. No pueden introducirse en una vaina metálica. Tener en cuenta la fragilidad causada por la contaminación.

### Tipo B

Pierna +	Pierna -
Pt30%Rh	- Pt6%Rh
Platino-30 % rodio	- Platino-6 % rodio

Los termopares tipo B son ideales para el uso continuo en atmósferas oxidantes o de gas inerte, y para una utilización breve en entorno de vacío a temperaturas de hasta 1600 °C. No pueden introducirse en una vaina metálica. Tener en cuenta la fragilidad causada por la contaminación.

Los termopares tipo R, S y B contienen normalmente una vaina de cerámica cerrada unilateralmente. Si se utiliza una vaina metálica, se requiere un tubo interior de cerámica cerrado de un lado. Los termopares de metales nobles son susceptibles de contaminación. Por ello es recomendable revestirlos con material cerámico.

## Límite superior de temperatura recomendado

(uso constante)

- Termopar con revestimiento (véase también la tabla "Tensiones térmicas según IEC 60584-1")

Termopar modelo	Límite superior de temperatura recomendado en °C							
	Para diámetro del revestimiento en mm							
	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4,5	6,0	8,0
K	700	700	920	920	1070	1100	1100	1100
J	260	260	440	440	520	620	720	720
N	700	700	920	920	1070	1100	1100	1100
E	300	300	510	510	650	730	820	820
T	260	260	260	260	315	350	350	350

Material del revestimiento: Inconel 2.4816 (Inconel 600)

Información considerando condiciones óptimas de laboratorio (en cuanto al aire, no contaminado con gases nocivos). Pueden obtenerse otros materiales, pero tienen como consecuencia otros límites de temperatura.

- Termopar recto (véase también la tabla "Tensiones térmicas según IEC 60584-1")

Termopar modelo	Límite superior de temperatura recomendado en °C			
	Para diámetro de filamento en mm			
	0,35	0,5	1,0	3,0
K	700	700	800	1000
J	400	400	600	700
N	700	700	800	1000
E	400	400	600	700
T	200	200	300	350
S	1300	1300	-	-
R	1300	1300	-	-
B	1500	1500	-	-

Información considerando condiciones óptimas de laboratorio (en cuanto al aire, no contaminado con gases nocivos).

- Termopar protegido (véase también la tabla "Límites superiores de temperatura recomendados para termopares con revestimiento" según ASTM E230)

Termopar modelo	Límite superior de temperatura para diferentes espesores de conductor en °C					
	Instrumento de medición N° 8 3,25 mm [0,128 pulg]	Instrumento de medición N° 14 1,63 mm [0,064 pulg]	Instrumento de medición N° 20 0,81 mm [0,032 pulg]	Instrumento de medición N° 24 0,51 mm [0,20 pulg]	Instrumento N° 28 0,33 mm [0,013 pulg]	Instrumento N° 30 0,25 mm [0,010 pulg]
T		370	260	200	200	150
J	760	590	480	370	370	320
E	870	650	540	430	430	370
K y N	1260	1090	980	870	870	760
R y S				1480		
B				1700		

### Nota:

Las temperaturas máximas de uso indicadas se aplican al termopar en condiciones de óptimo funcionamiento. ¡La temperatura máxima de uso para la vaina se sitúa a menudo claramente por debajo de la del termopar!

- Termopar con revestimiento (véase también la tabla "Límites superiores de temperatura recomendados para termopares con revestimiento" según ASTM E608/E608M)

Diámetro nominal del revestimiento		Límite superior de temperatura para diferentes diámetros de revestimiento en °C			
		Tipo de termopar			
		T	J	E	K y N
0,5	0,020	260	260	300	700
	0,032	260	260	300	700
1,0	0,040	260	260	300	700
1,5	0,062	260	440	510	920
2,0		260	440	510	920
	0,093	260	480	580	1000
3,0	0,125	315	520	650	1070
4,5	0,188	370	620	730	1150
6,0	0,250	370	720	820	1150
8,0	0,375	370	720	820	1150

**Nota:**

Las temperaturas máximas de uso indicadas se aplican al termopar en condiciones de óptimo funcionamiento. ¡La temperatura máxima de uso para la vaina se sitúa a menudo claramente por debajo de la del termopar!



# Incertidumbres potenciales de medición

## Factores importantes que contrarrestan la estabilidad a largo plazo de termopares

### Envejecimiento/contaminaciones

- Los procesos de oxidación provocan distorsiones de las curvas características en termopares sin protección adecuada (conductores térmicos “pelados”)
- Los átomos de impurezas entradas por difusión (contaminación) producen modificaciones en las aleaciones originales, distorsionando por lo tanto la curva característica.
- La influencia de hidrógeno conduce a la fragilización de los termopares.

Los termopares “no nobles” envejecen y cambian por ello su curva característica de tensión térmica y temperatura. Los termopares “nobles” PtRh-Pt tipos R y S prácticamente no presentan ningún envejecimiento hasta 1400 °C. Sin embargo, son muy sensibles frente a las impurezas. El silicio y el fósforo destruyen el platino muy rápidamente. En presencia del platino, el silicio puede liberarse de la cerámica de aislamiento ya en una atmósfera débilmente reductora. La reducción de SiO<sub>2</sub> a Si lleva a una contaminación de la pierna Pt del termopar, provocando ya en cantidades de silicio de pocos ppm errores de medición de 10 °C y más.

Condicionado por la mejor proporción del volumen total de material con respecto a la superficie sensible a la intoxicación, la estabilidad a largo plazo de los termopares de metal noble aumenta a medida que aumenta el diámetro del filamento térmico. Por eso, los sensores tipos S, R y B están disponibles con diámetro de filamento térmico Ø 0,35 mm o Ø 0,5 mm (0,015" o 0,020"). Pero los filamentos térmicos con Ø 0,5 mm (0,020") poseen la doble superficie de sección que los filamentos con Ø 0,35 mm (0,015") -y son, por ende, también el doble de caros. No obstante, ello puede redituarse, ya que una vida útil sustancialmente más prolongada puede compensar los costes de mantenimiento eventualmente elevados (inactividad de la instalación).

La pierna de níquel del termopar tipo K se daña frecuentemente debido al azufre, presente por ejemplo, en los gases de combustión. Los termopares tipos J y T envejecen poco, debido a que primero se oxida la pierna de metal puro.

En general, el envejecimiento aumenta a medida que sube la temperatura.

### Moho verde

En termopares tipo K pueden producirse modificaciones significativas en la tensión térmica cuando se usan en temperaturas de aproximadamente 800 °C a 1050 °C. La causa de esto es un empobrecimiento del cromo o la oxidación del cromo en la pierna de NiCr (pierna +). Esto requiere una baja concentración de oxígeno o vapor de agua en la proximidad directa del termopar. La pierna de níquel no resulta afectada. La consecuencia de este efecto es una

desviación del valor medido por la disminución de tensión térmica. En caso de escasez de oxígeno, este efecto se acelera aún más, dado que no se pueden formar películas de óxido completas en la superficie del termopar, que podrían contrarrestar una oxidación continuada del cromo.

Con el tiempo, el termopar queda destruido por este proceso. El nombre moho verde procede de la coloración verdosa brillante en el punto de ruptura del conductor.

En comparación, el termopar tipo N (NiCrSi-NiSi) se encuentra en ventaja debido a su contenido de silicio. Aquí, en las mismas condiciones, se forma una capa protectora de óxido en su superficie.

### Efecto K

La pierna de NiCr de un termopar tipo K posee, con respecto a la orientación en la red cristalina, por debajo de aproximadamente 400 °C una alineación ordenada. Si se lo sigue calentando, hasta un rango de temperatura entre aproximadamente 400 °C y 600 °C esta variación genera una transición a un estado desordenado. Por encima de los 600 °C se forma nuevamente una red cristalina ordenada. Si el enfriamiento de estos termopares se produce demasiado rápido (más rápido que 100 °C por hora), se vuelve a formar durante el enfriamiento una red cristalina desordenada no deseada en el rango de aproximadamente 600 °C a aproximadamente 400 °C. En la curva característica del tipo K se presupone, sin embargo, una alineación ordenada de forma continua con sus valores respectivos. Como consecuencia se produce un error de voltaje del termopar de hasta 0,8 mV (aprox. 5 °C) en este rango. El efecto K es reversible y se reduce casi completamente haciendo recocer a más de 700 °C y enfriar lentamente.

Los termopares finos con revestimiento reaccionan de manera particularmente sensible. Un enfriamiento mínimo en contacto con el aire estático puede provocar ya una diferencia de más de 1 °C.

En los termopares tipo N (NiCrSi-NiSi), se consiguió reducir este efecto de orden de corto alcance al alea las dos piernas con silicio.

## Diseños estándar de termopares

### Termopares con revestimiento

Los termopares con revestimiento constan de un encamisado de acero inoxidable, en el cual los conductores interiores están encapsulados en una masa de cerámica altamente compactada (llamado cable con aislamiento mineral o también cable MI).

Los termopares con revestimiento son flexibles y pueden curvarse hasta un radio mínimo equivalente a 5 veces el diámetro del revestimiento. Pueden utilizarse en puntos de difícil acceso gracias a esta flexibilidad.

La extrema resistencia a las vibraciones habla también a favor del uso de termopares con revestimiento.



### Diámetro de revestimiento disponibles

- 0,5 mm
- 1,0 mm
- 1,5 mm
- 3,0 mm
- 4,5 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm

### Materiales de revestimiento

- Aleación de níquel 2.4816 (Inconel 600)
  - hasta 1200 °C (aire)
  - Material estándar para aplicaciones con riesgo a corrosión a altas temperaturas, resistente a fisuración inducida por corrosión y corrosión por picaduras en medios con contenido de cloruro
  - No hay corrosión por amoníaco en soluciones acuosas con todas las temperaturas y concentraciones
  - Altamente resistente a halógenos, cloro, cloruro de hidrógeno
- Acero inoxidable 316
  - hasta 850 °C (aire)
  - Buena resistencia a medios agresivos así como a vapores y gases de combustión en medios químicos
- Otros materiales a consultar

### Diseño del punto de medición

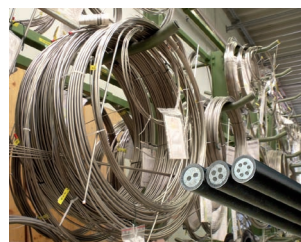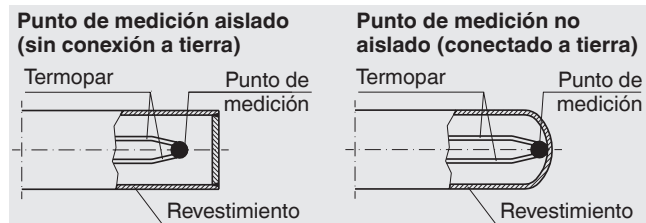


Materia prima del cable MI

### Termopares rectos con vaina de metal o cerámica



Diferentes diseños, modelo TC80

### Estructura interior del termopar en versión recta

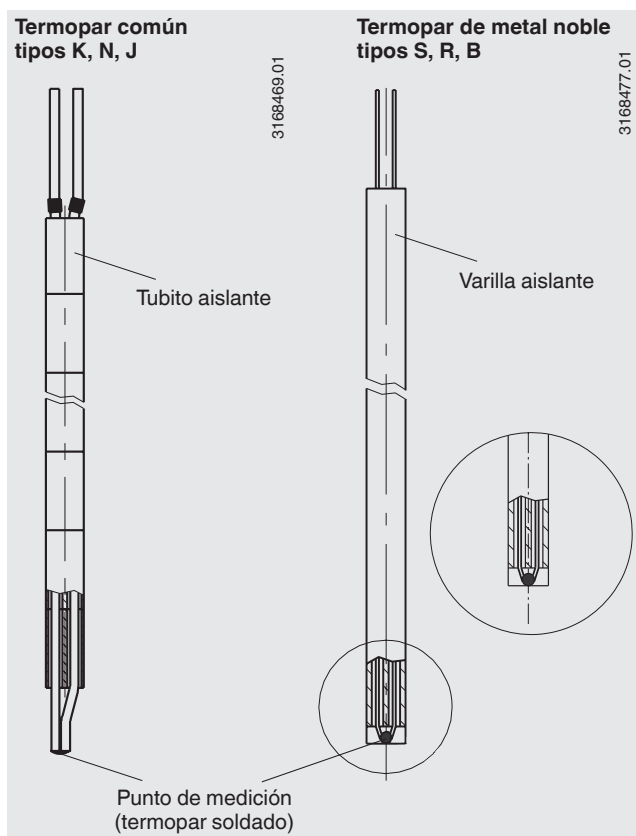

### Termopar de metal noble tipos S, R, B

Filamento térmico: Ø 0,35 mm o Ø 0,5 mm

Aislamiento: Varilla aislante, cerámica C 799 / óxido de aluminio

### Termopar común tipos K, N, J

Filamento térmico: Ø 1 mm o Ø 3 mm

Aislamiento: Tubito aislante, cerámica C 610 / Mullit

## Cables de conexión para termopares

Para cubrir la distancia entre termopar y unidad de evaluación, deben utilizarse cables especiales.

Se diferencia aquí entre **cables de extensión** (el material del conductor corresponde a los materiales originales del termopar) y los llamados **cables de compensación**.

En los cables de compensación, el material del conductor corresponde, en un rango de temperatura restringido, a las características termoeléctricas del termopar original. Esos límites de temperatura están realizados según IEC 60584-3 o ASTM E230. Allí están disponibles también informaciones sobre las clases de exactitud de los cables.

La utilización de estos materiales especiales de conductores es necesario para evitar “elementos parásitos” en los puntos de conexión termopar-cable de conexión.



Cable de conexión

### ■ Cable de extensión

Los conductores del cable de extensión están fabricados del material original del termopar (por razones de costes, no disponibles para termopares nobles).

Los cables pueden obtenerse en las clases de exactitud 1 y 2.

### ■ Cable de compensación

Los conductores internos del cable de compensación están fabricados de materiales que corresponden a las características termoeléctricas del termopar original. Esto vale en un rango de temperatura definido en la norma IEC 60584 / ASTM E230 en la zona de transición cable-termopar, así como en todo el trayecto del cable.

Disponible solamente en la clase de exactitud 2.

En termopares de tipo B está permitido el uso de conductores interiores de cobre.

Errores esperados (ejemplo):  $40 \mu\text{V} / 3,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Esto se aplica dentro de un rango de temperatura de  $0 \dots 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$  en la unión de termopar y cable de compensación. En este ejemplo, la temperatura del punto de medición es de  $1400 \text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### Nota:

¡Los errores potenciales de termopar y cable de conexión se suman!

Código de colores de los cables de extensión y de los cables de compensación

	ASTM E230 Cable térmico	ASTM E230 Cable de compensación	BS 1843	DIN 43714	ISC1610-198	NF C42-323	IEC 60584-3	IEC 60584-3 Seguridad intrínseca
N								
J								
K								
E								
T								
R								
S								
B								

© 2014 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos los derechos reservados.  
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.  
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.



Instrumentos WIKA, S.A.U.  
C/Josep Carner, 11-17  
08205 Sabadell (Barcelona)/España  
Tel. +34 933 9386-30  
Fax +34 933 9386-66  
info@wika.es  
www.wika.es