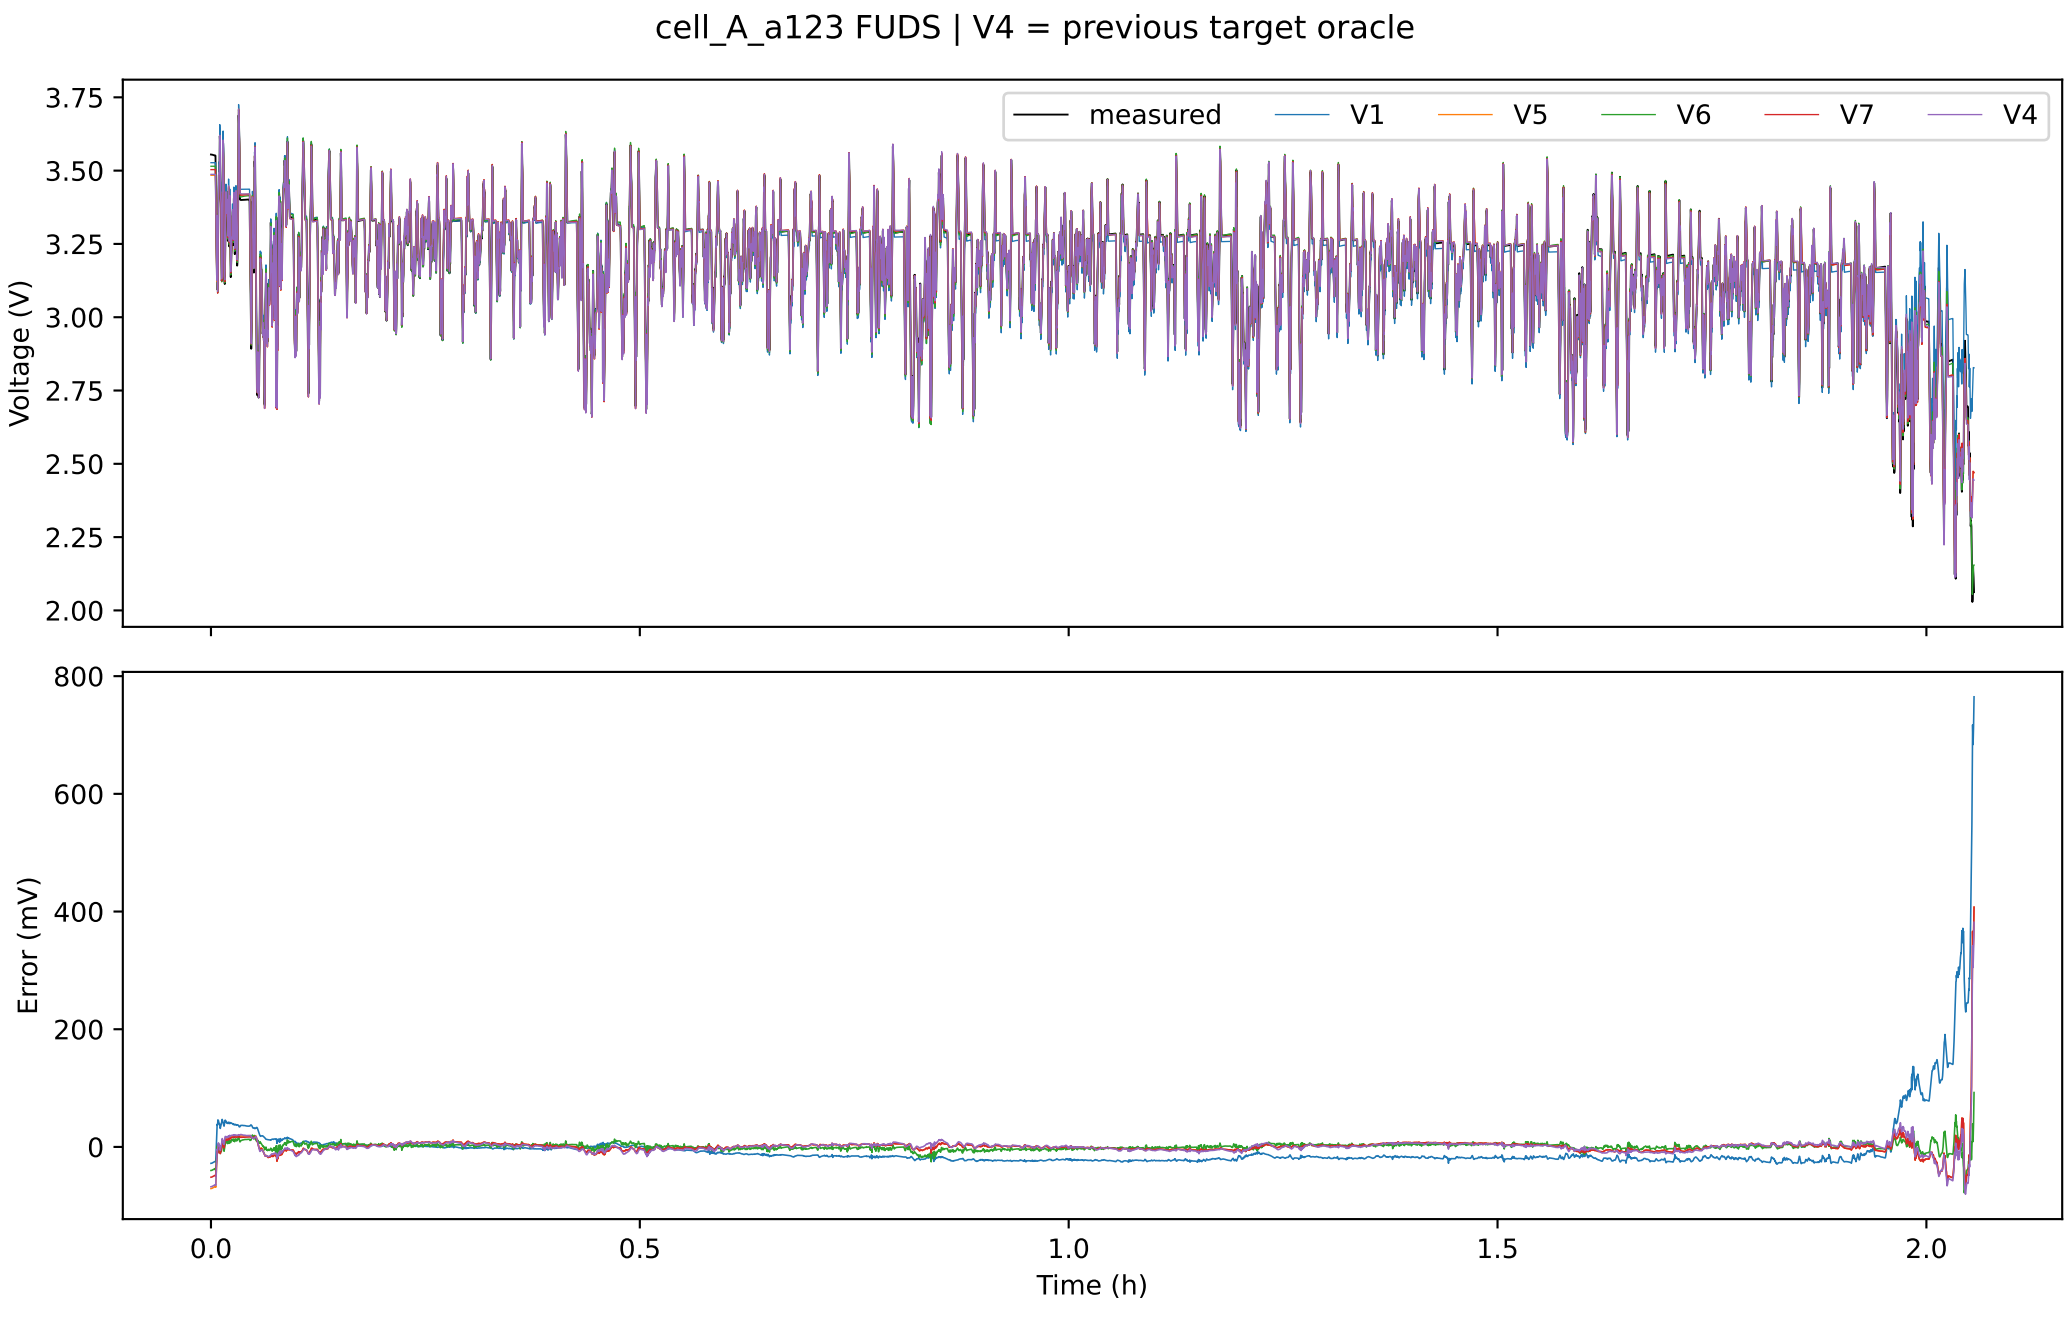

cell_A_a123 FUDS | V4 = previous target oracle
measured
V1
V5
V6
V7
V4
Voltage (V)
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
Error (mV)
800
600
400
200
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Time (h)