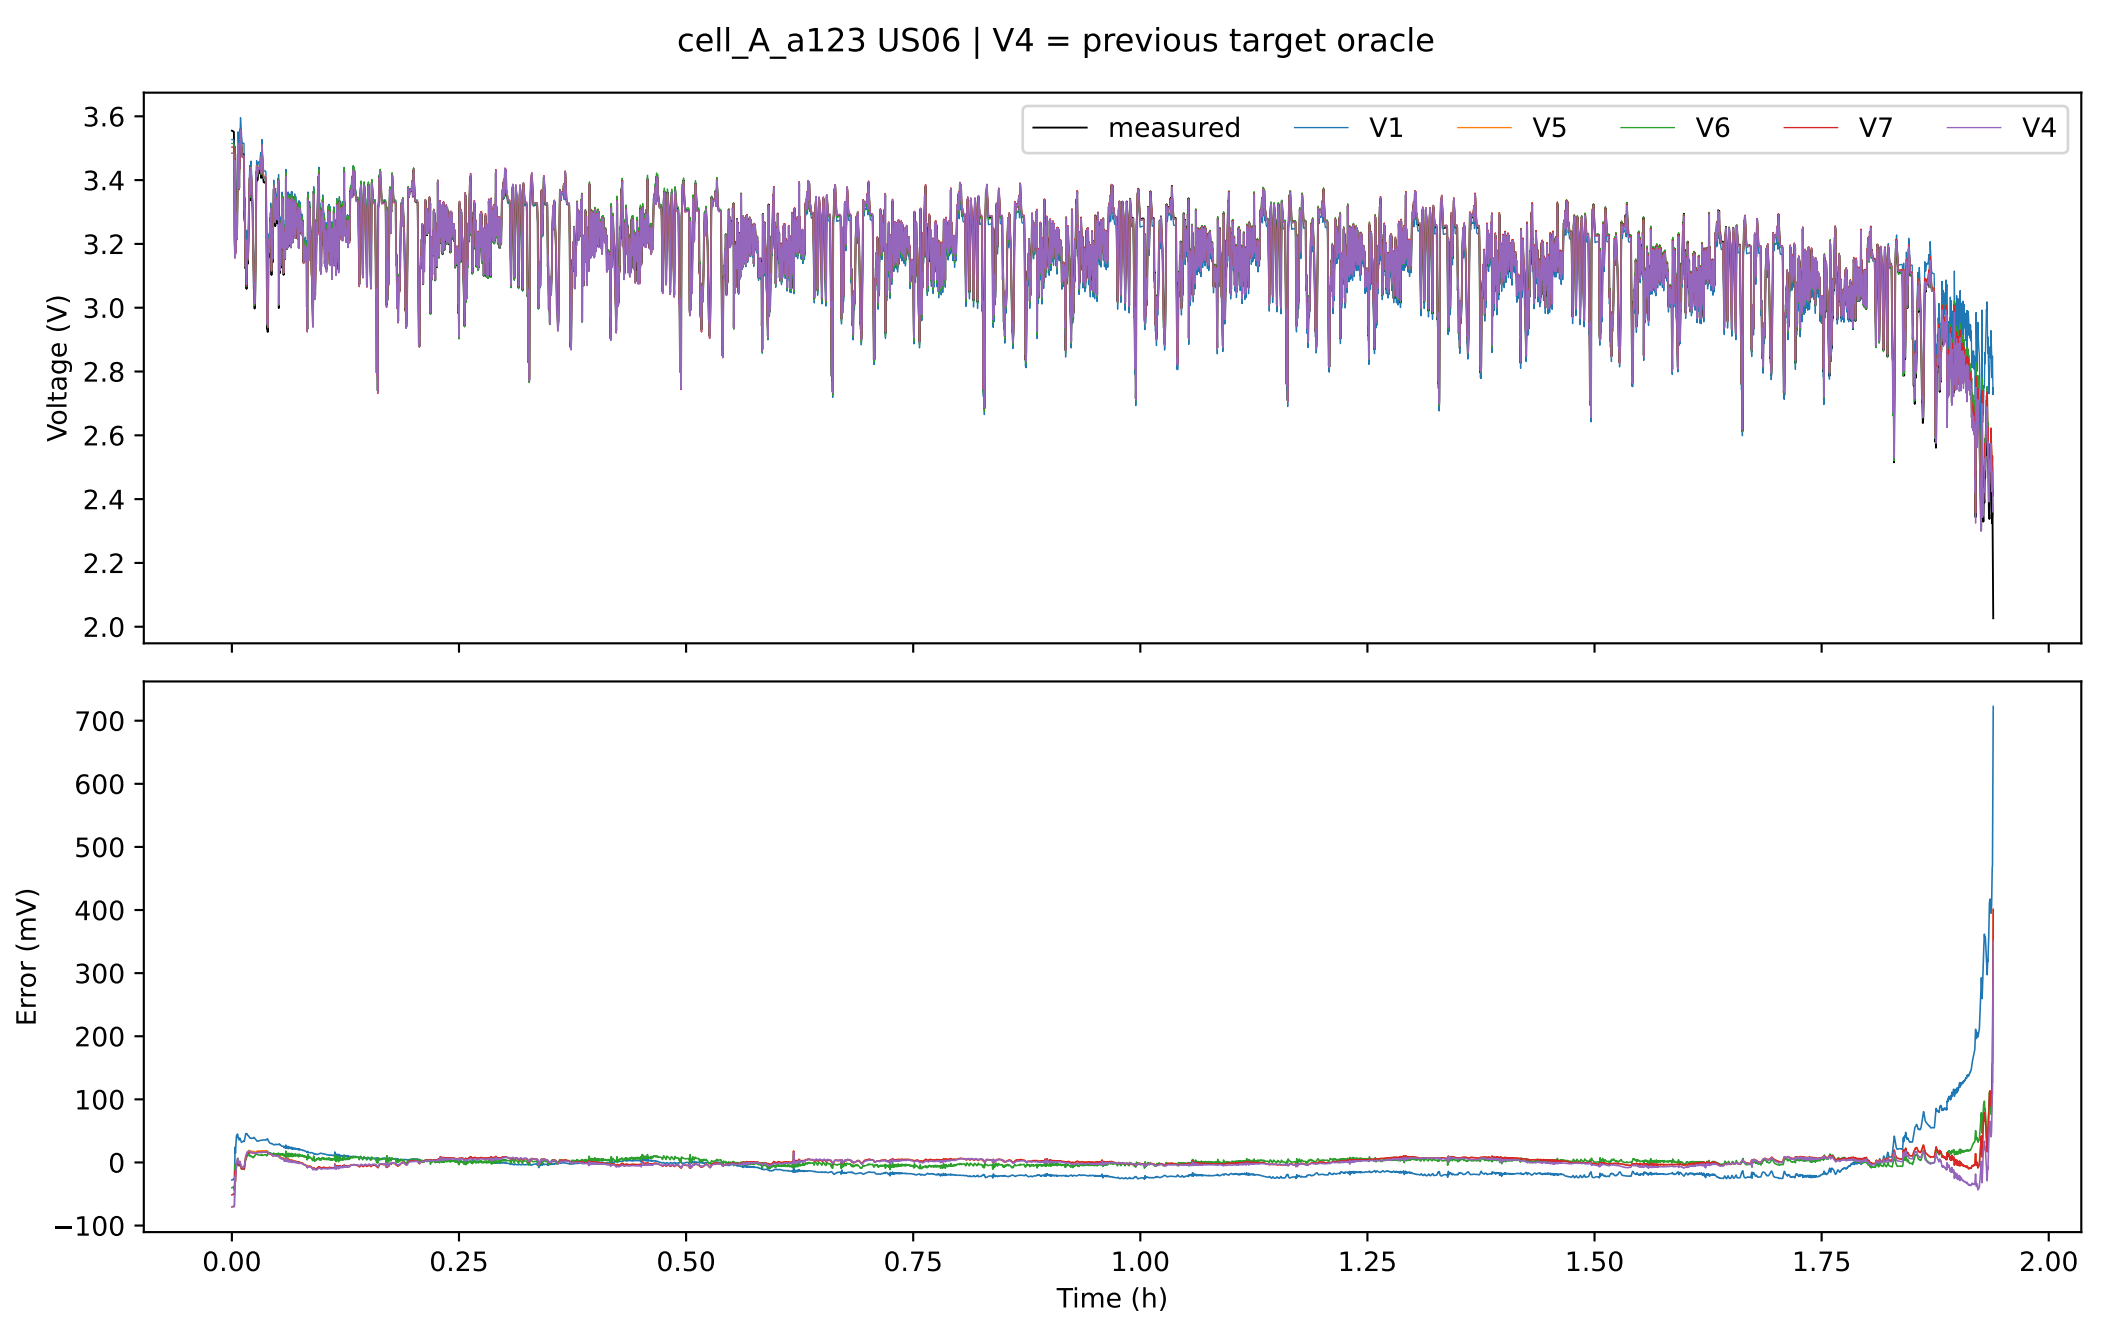

cell_A_a123 US06 | V4 = previous target oracle
measured
V1
V5
V6
V7
V4
Voltage (V)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
Error (mV)
700
600
500
400
300
200
100
0
−100
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Time (h)