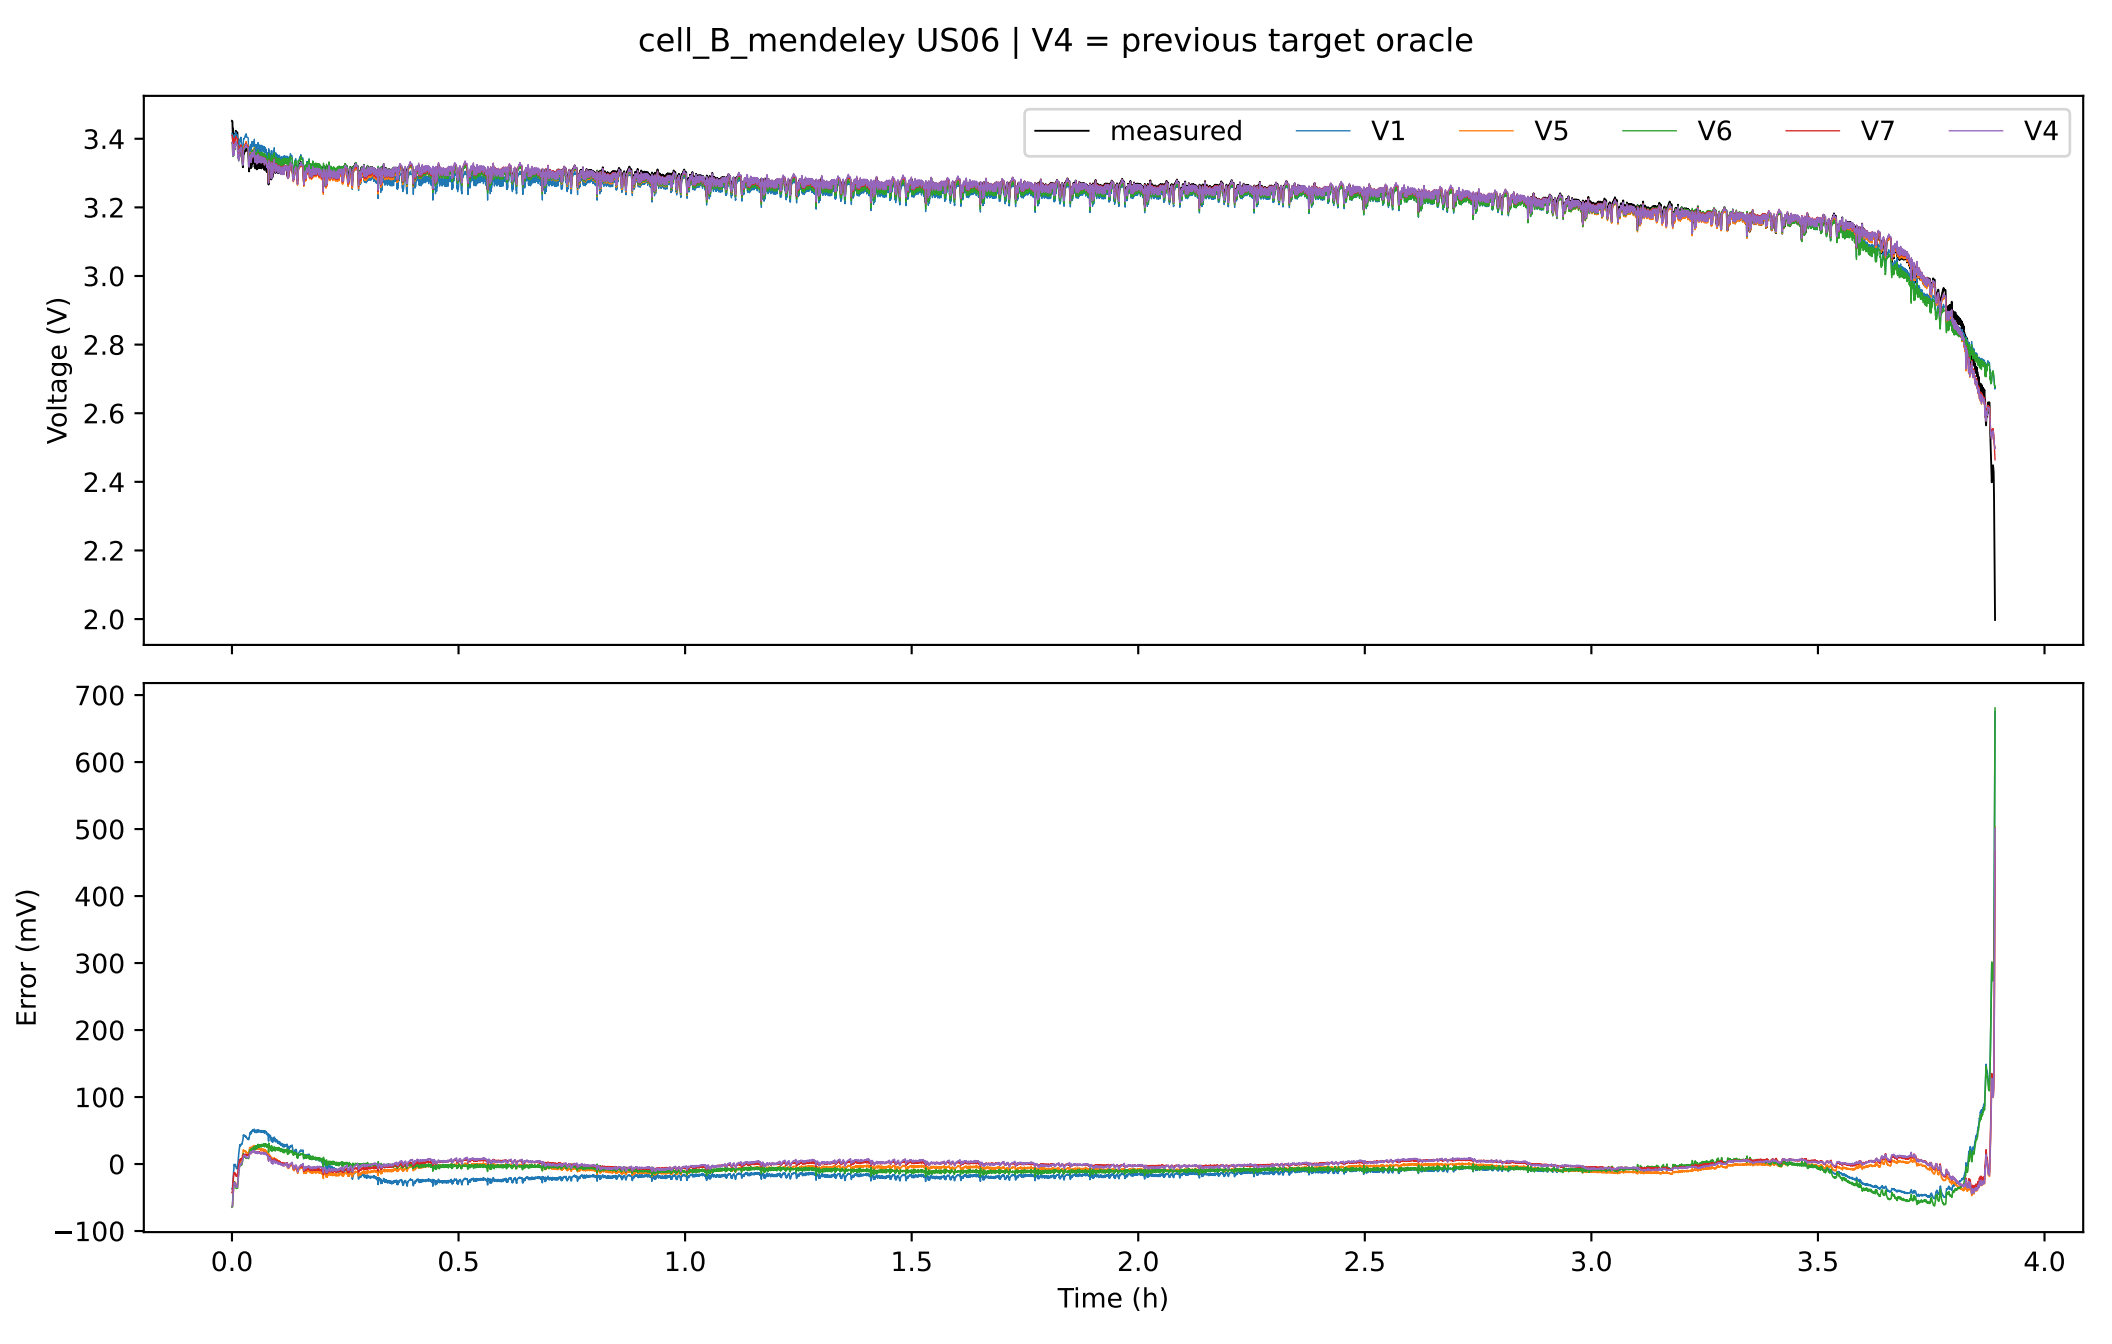

cell_B_mendeley US06 | V4 = previous target oracle
measured
V1
V5
V6
V7
V4
Voltage (V)
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
Error (mV)
700
600
500
400
300
200
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time (h)