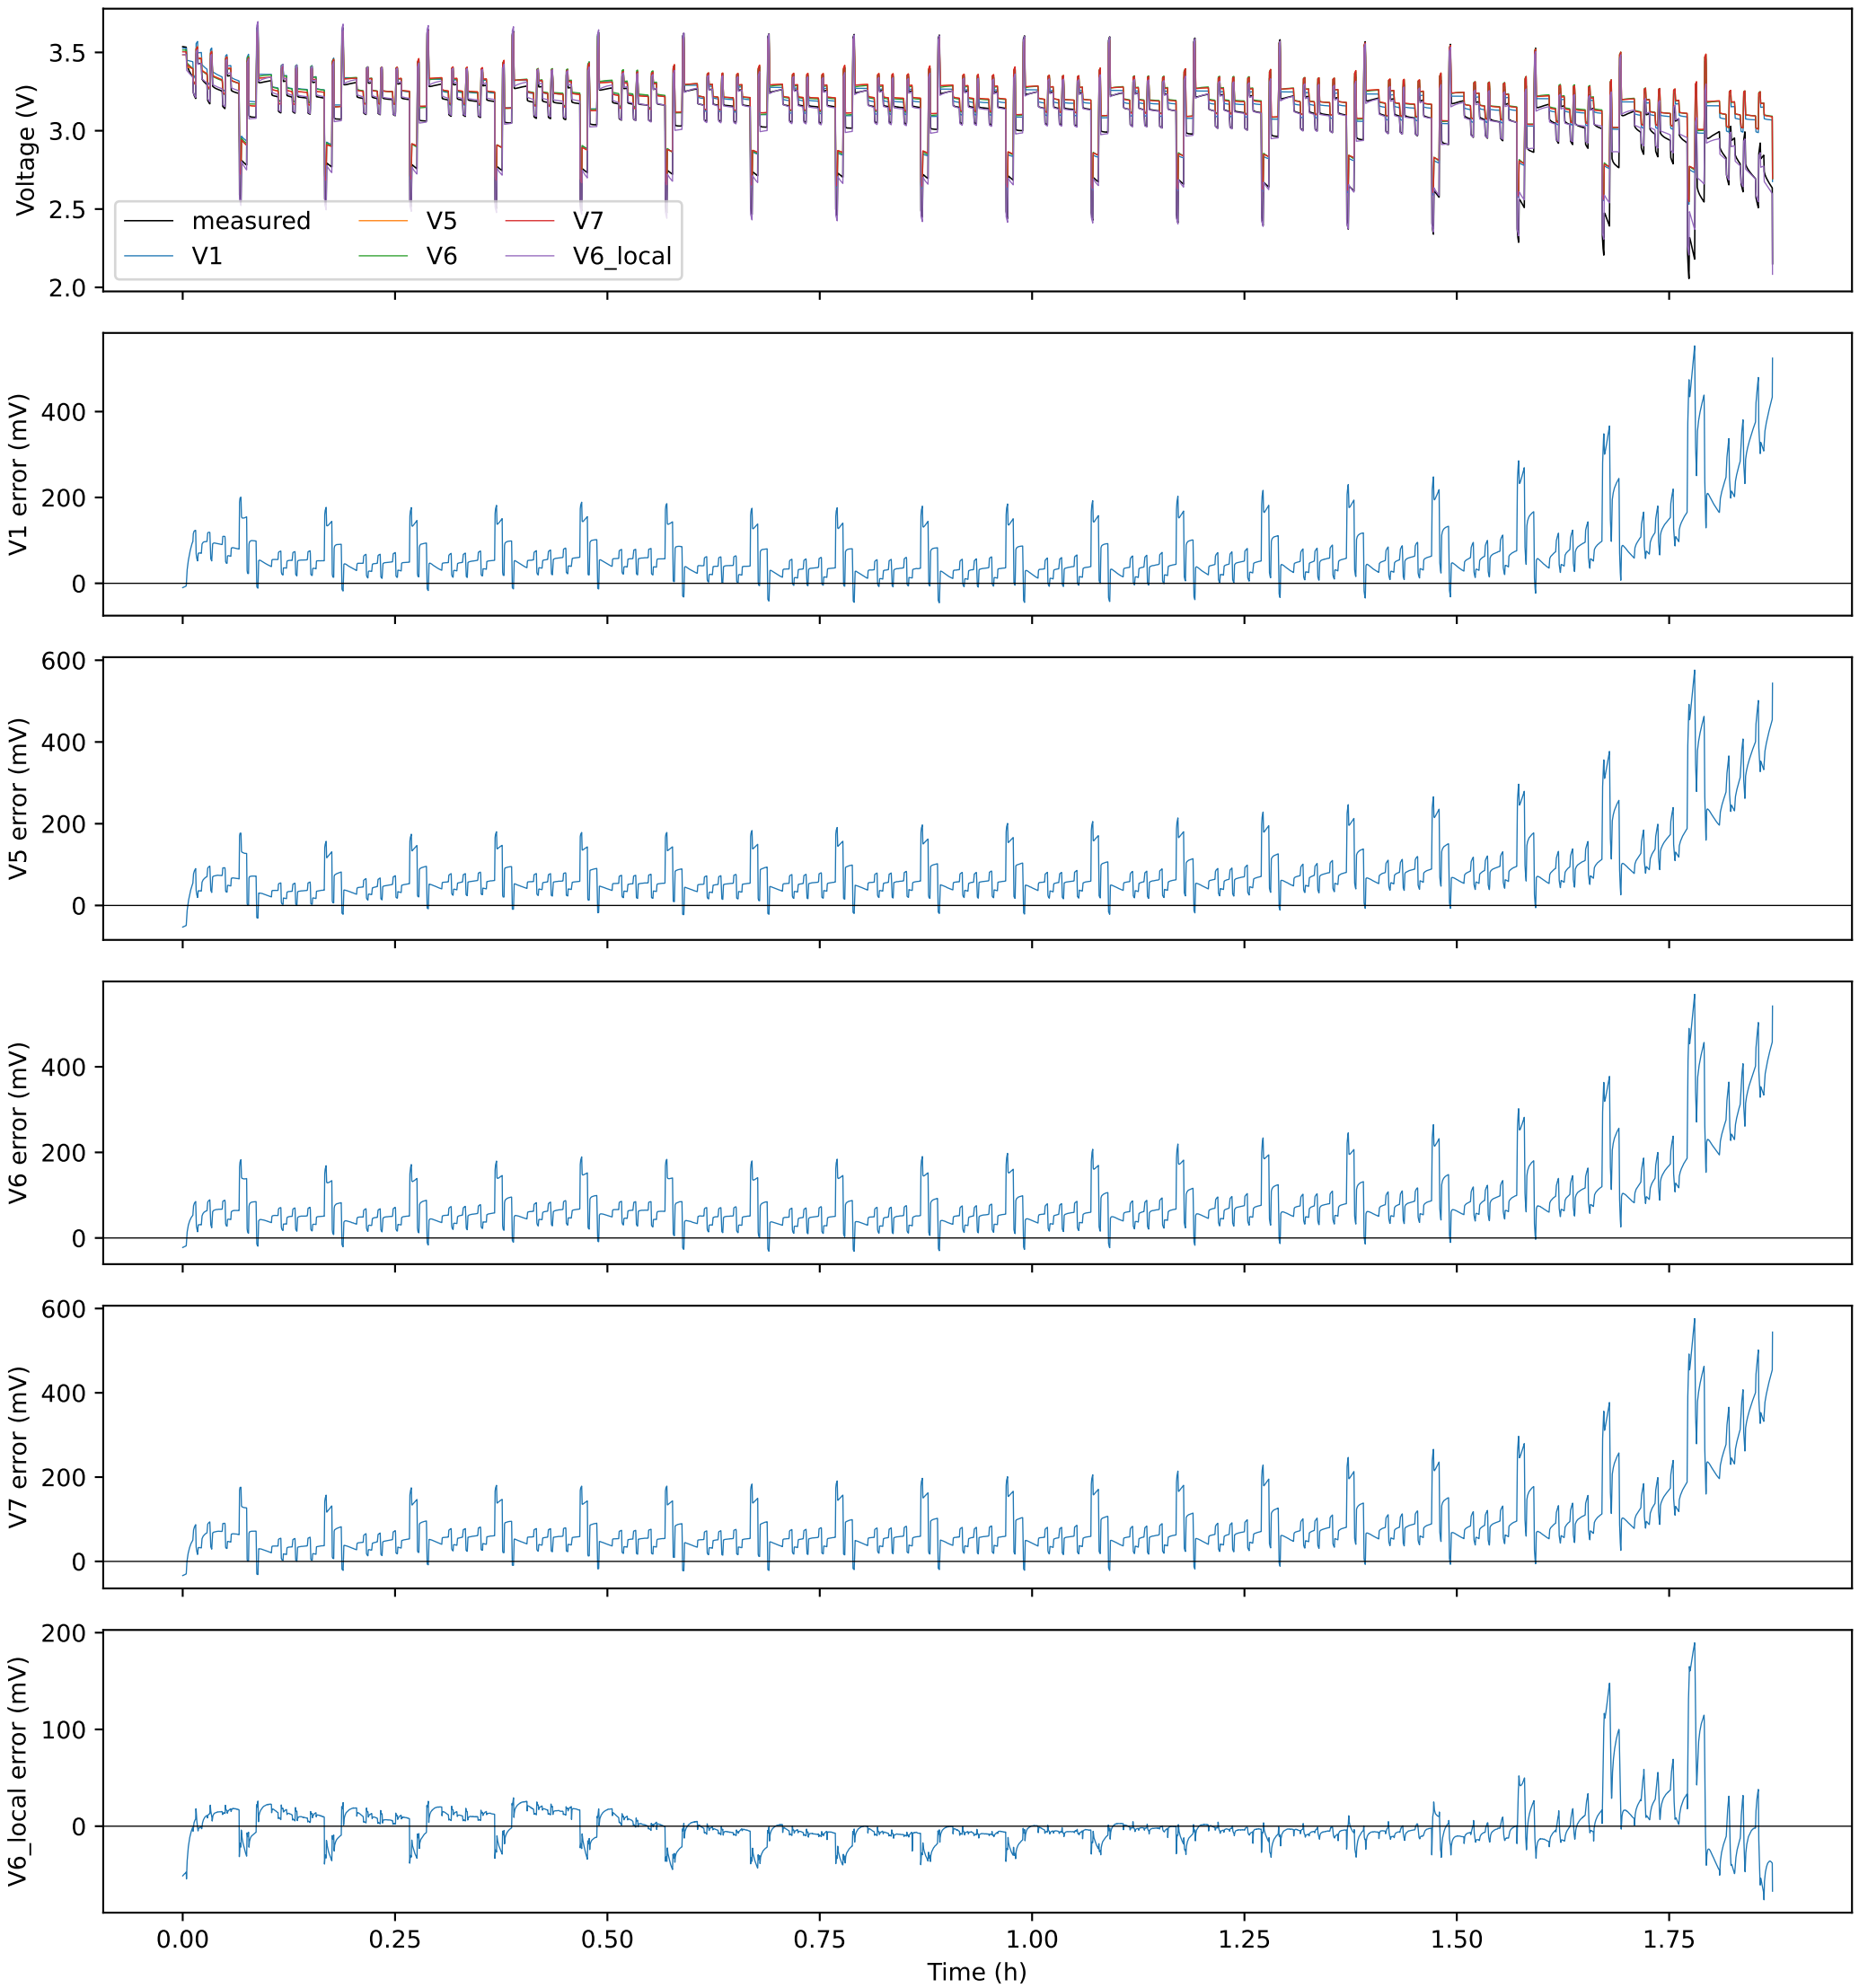

A123 0C DST
Voltage (V)
3.5
3.0
2.5
2.0
measured
V1
V5
V6
V7
V6_local
V1 error (mV)
400
200
0
V5 error (mV)
600
400
200
0
V6 error (mV)
400
200
0
V7 error (mV)
600
400
200
0
V6_local error (mV)
200
100
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
Time (h)