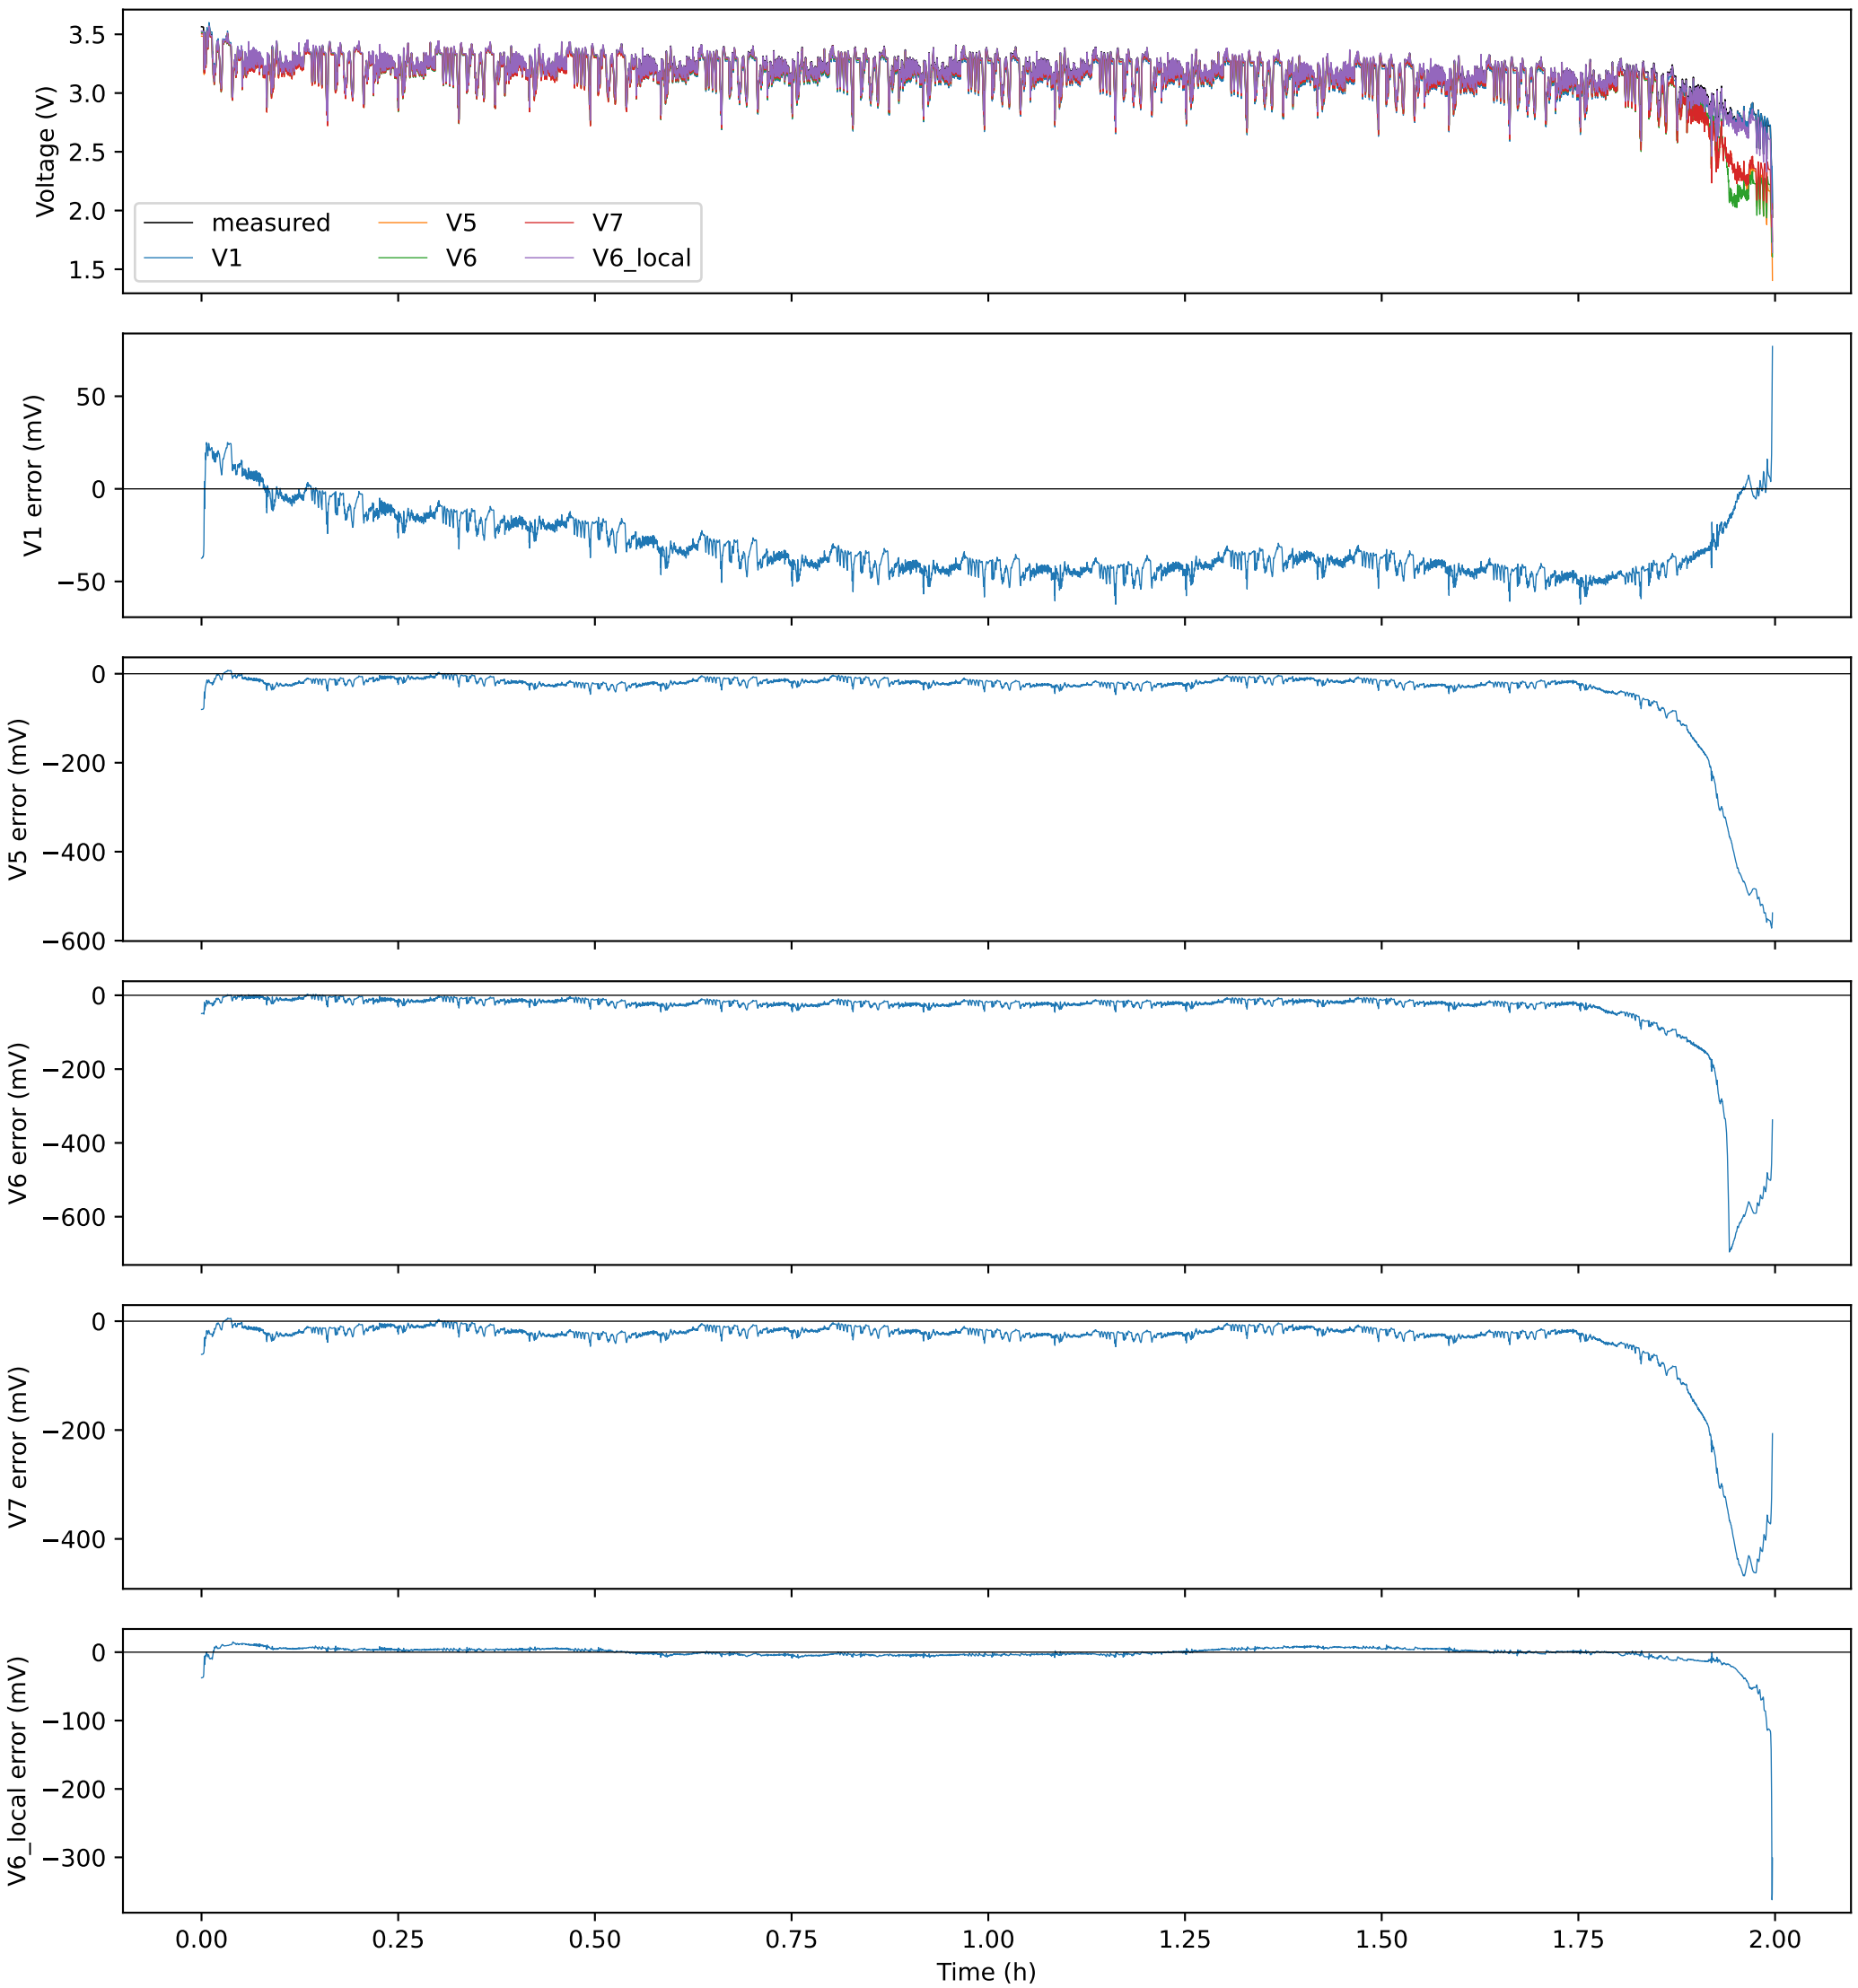

A123 50C US06
Voltage (V)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
measured
V1
V5
V6
V7
V6_local
V1 error (mV)
50
0
−50
V5 error (mV)
0
−200
−400
−600
V6 error (mV)
0
−200
−400
−600
V7 error (mV)
0
−200
−400
V6_local error (mV)
0
−100
−200
−300
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Time (h)