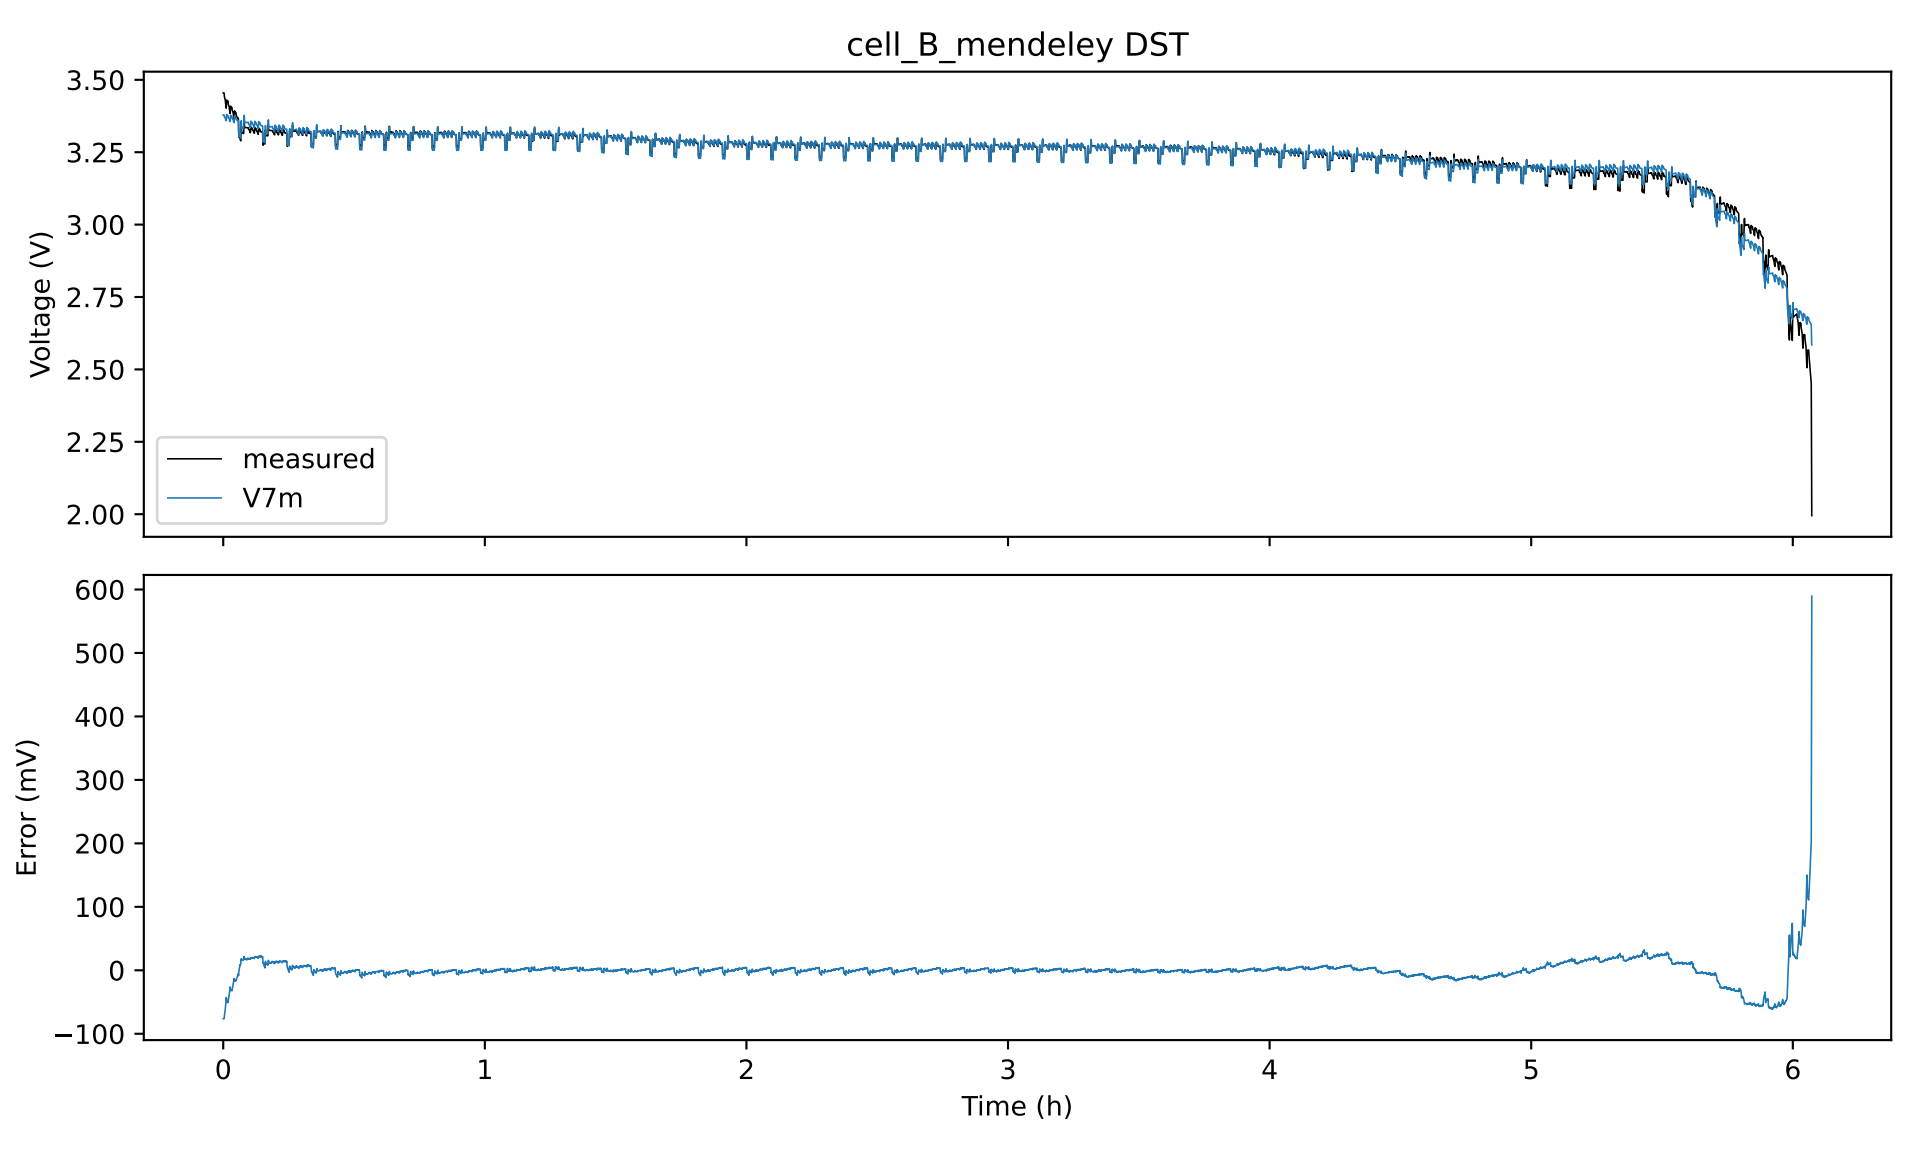

cell_B_mendeley DST
Voltage (V)
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
measured
V7m
Error (mV)
600
500
400
300
200
100
0
−100
0
1
2
3
4
5
6
Time (h)