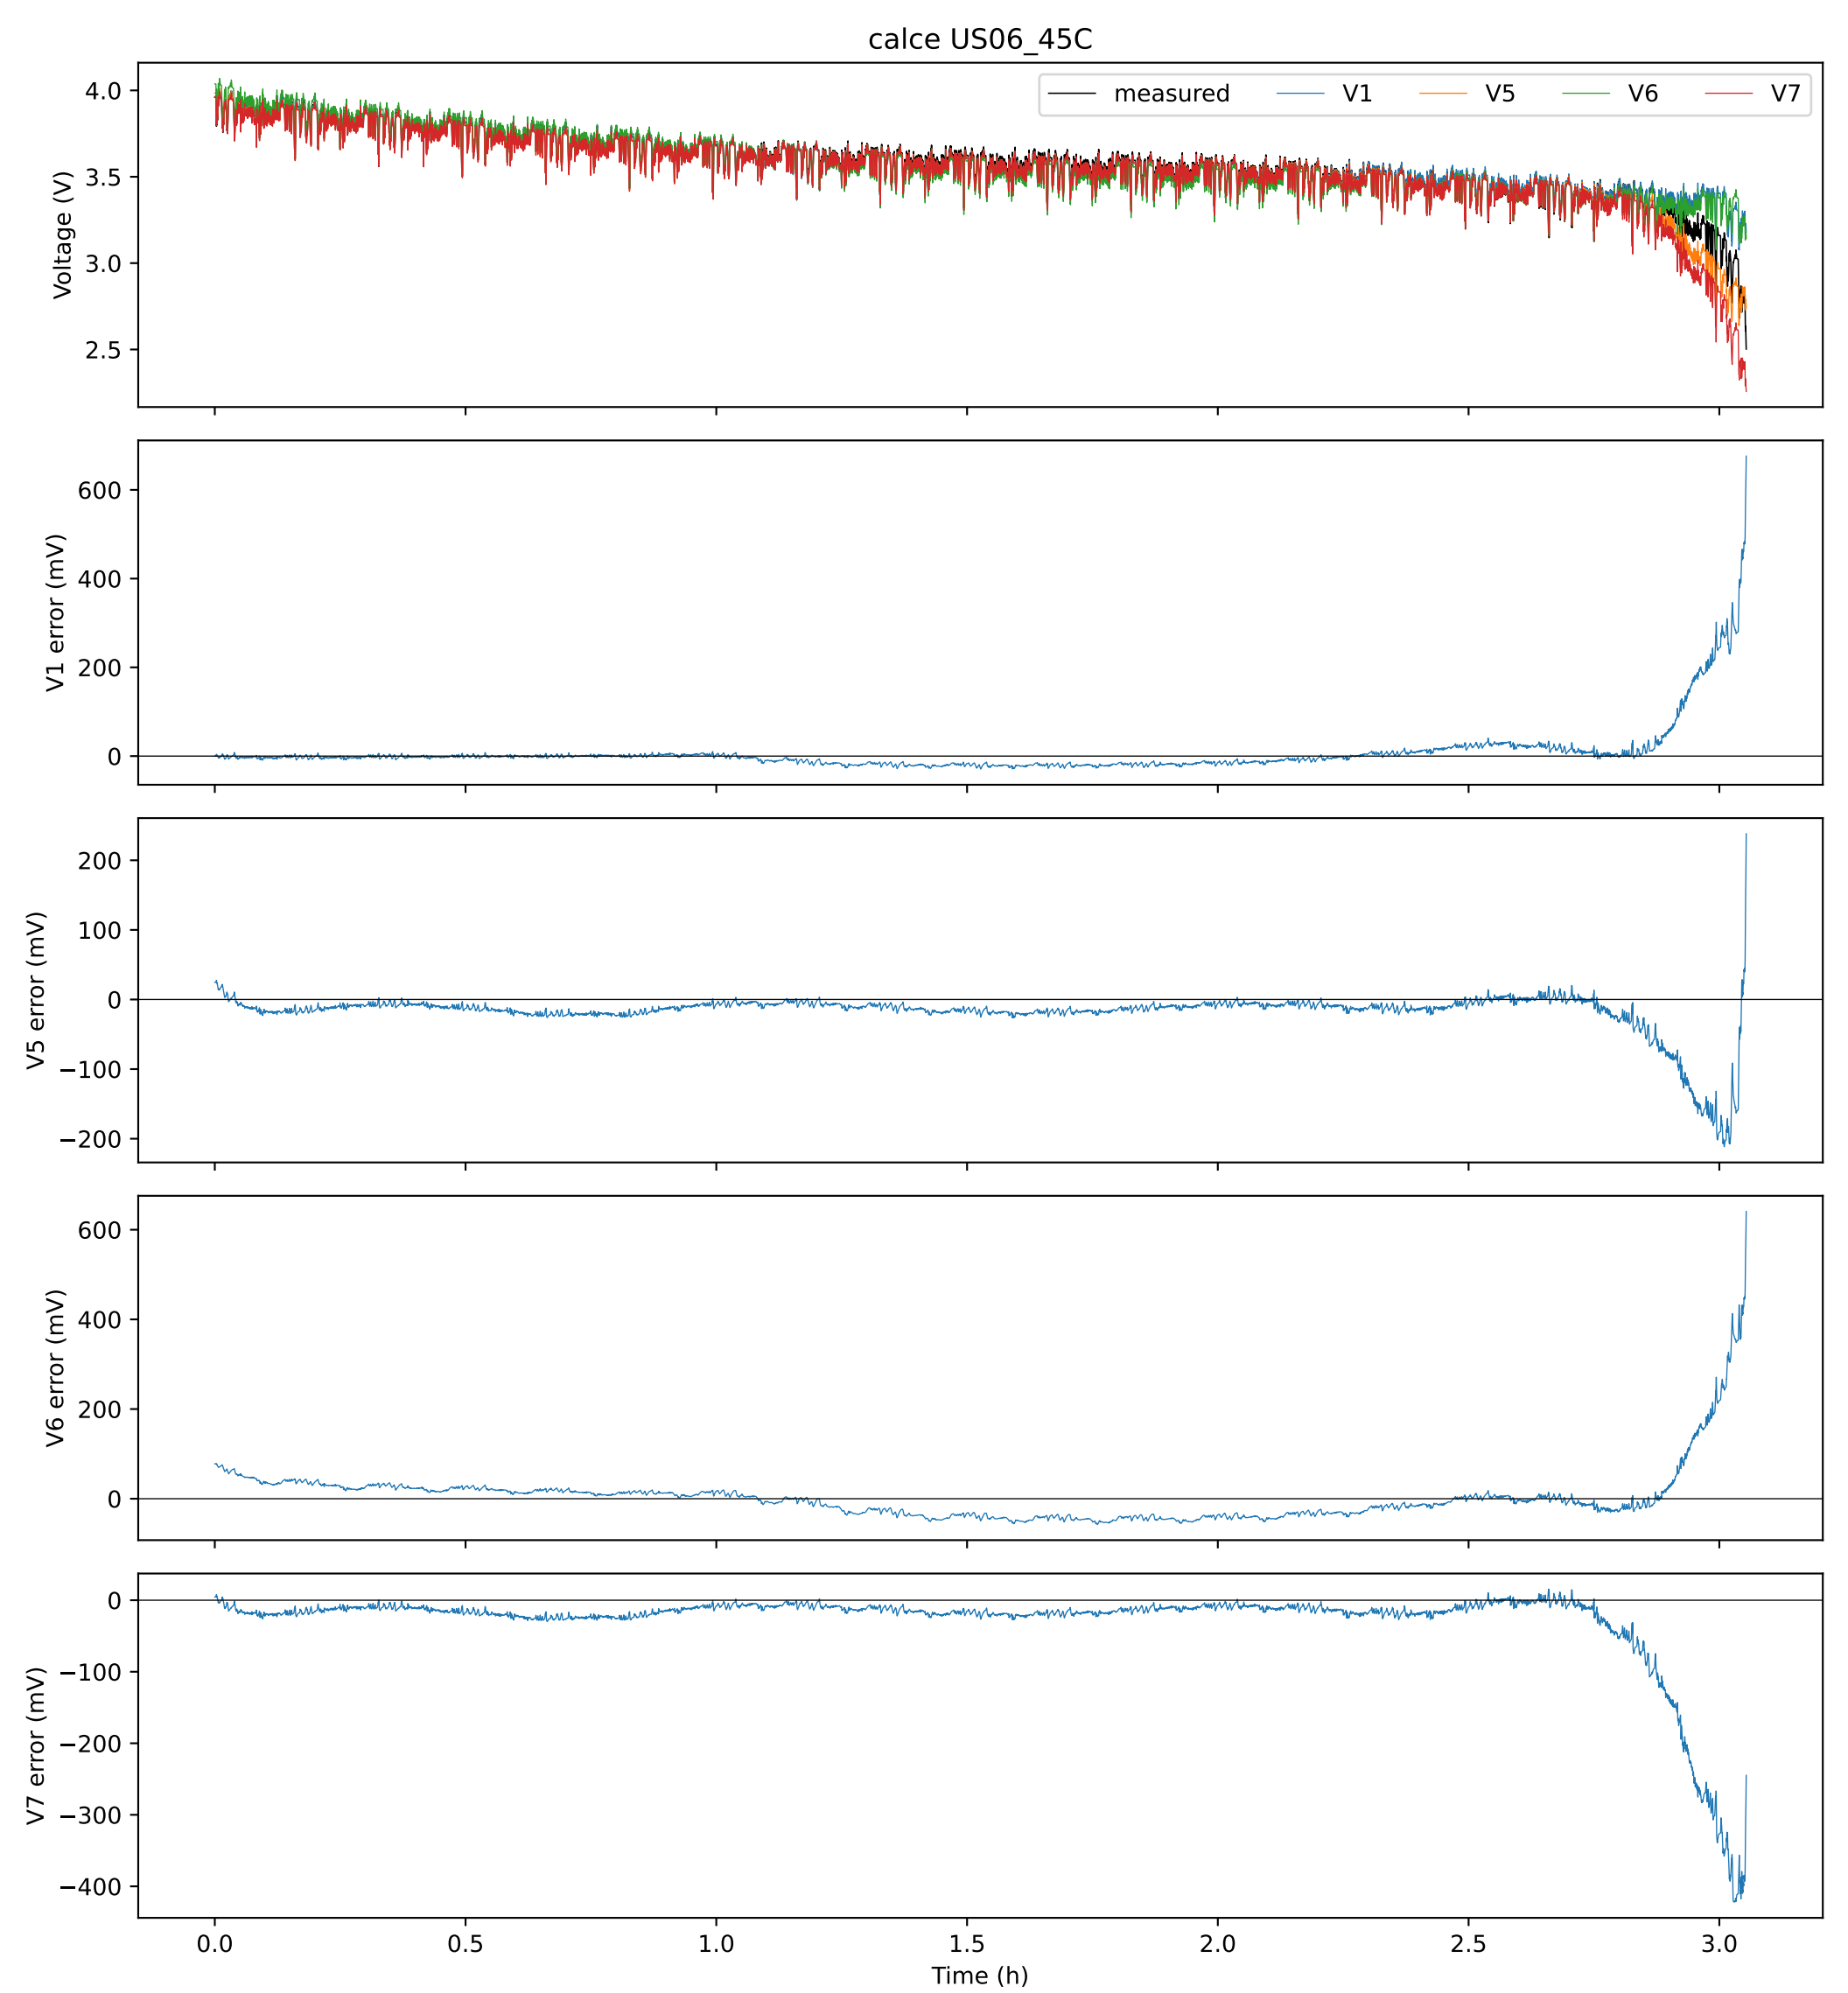

calce US06_45C
measured
V1
V5
V6
V7
Voltage (V)
4.0
3.5
3.0
2.5
V1 error (mV)
600
400
200
0
V5 error (mV)
200
100
0
−100
−200
V6 error (mV)
600
400
200
0
V7 error (mV)
0
−100
−200
−300
−400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Time (h)