


Espectros de mamografía: efecto del kV y del material de ánodo

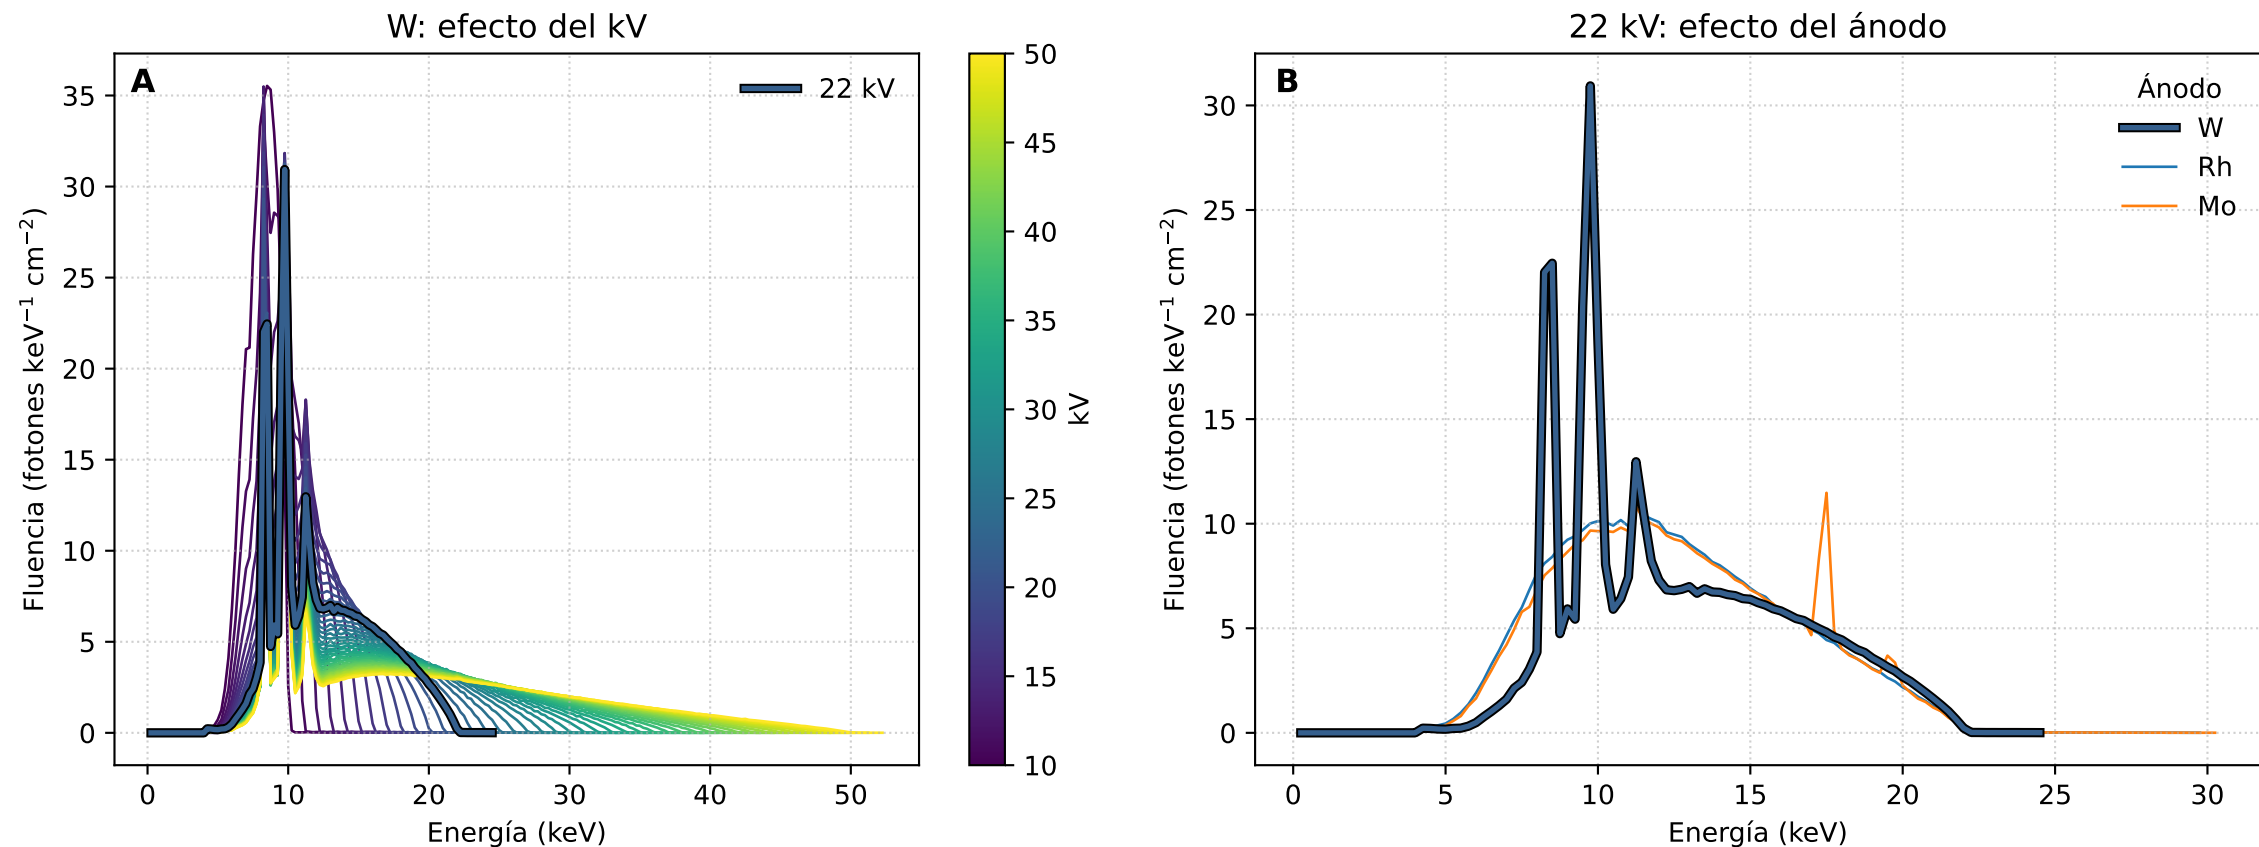

18.11.2020
unfiltered x-ray spectrum
measured at: PTB, Braunschweig
anode: tungsten
tube voltage: 22 kV
anode angle: 30
inherent filtration: 4 mm Be
measured in air at 100 cm distance from the focus
bin width: 0.25 keV