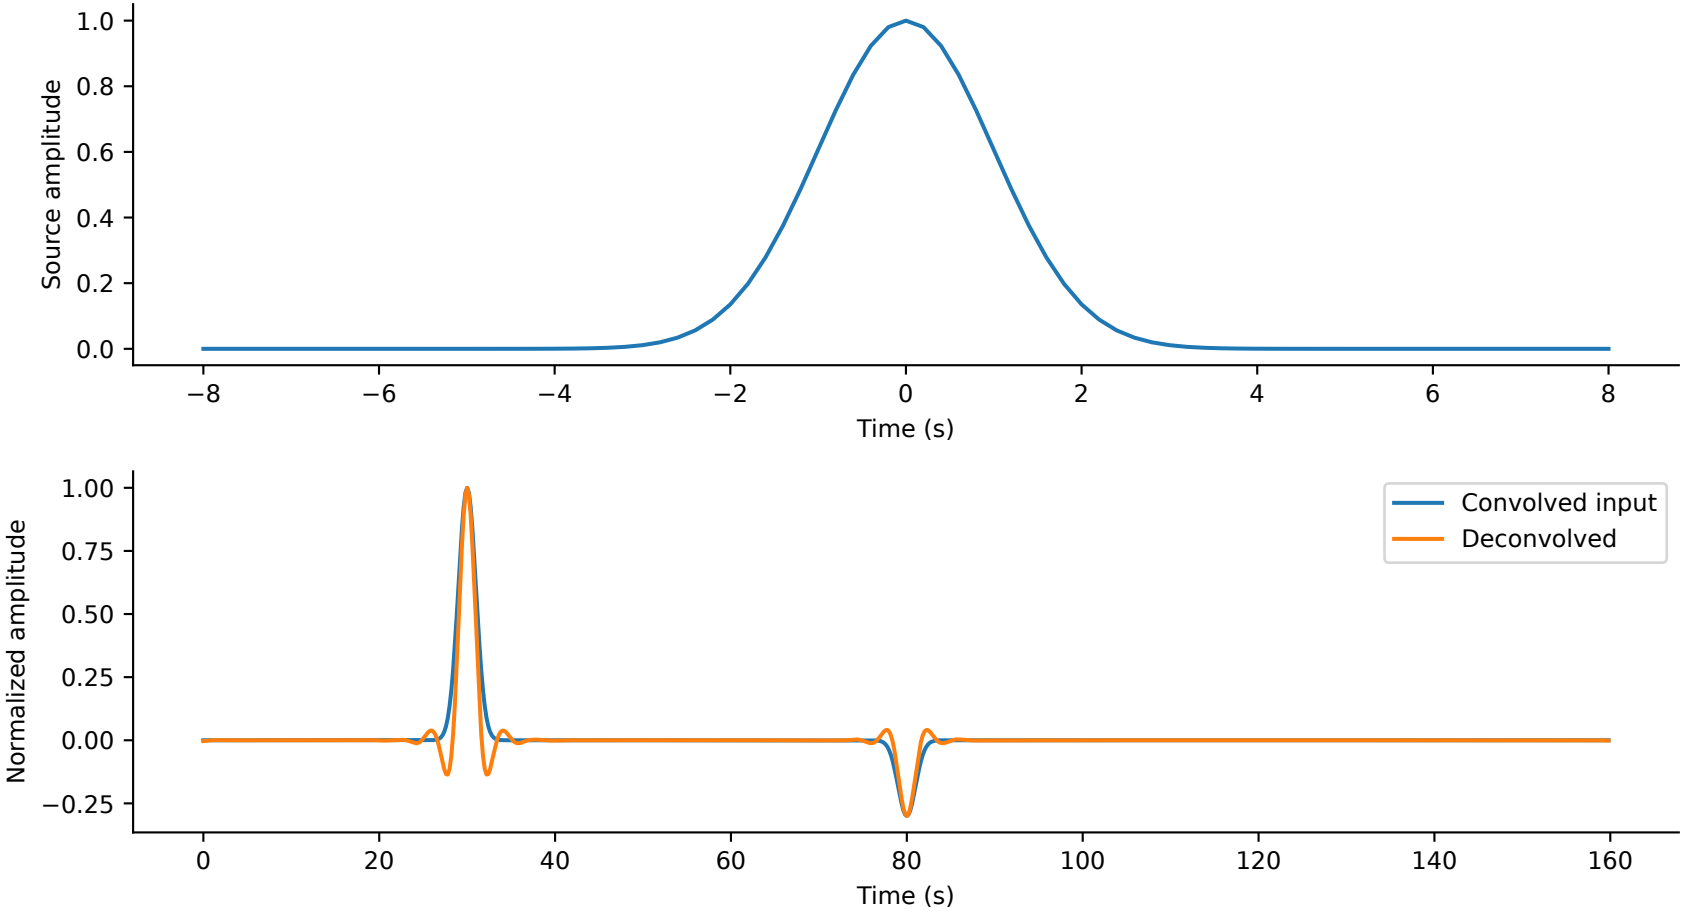
Source amplitude
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
Time (s)
Normalized amplitude
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Time (s)
Convolved input
Deconvolved