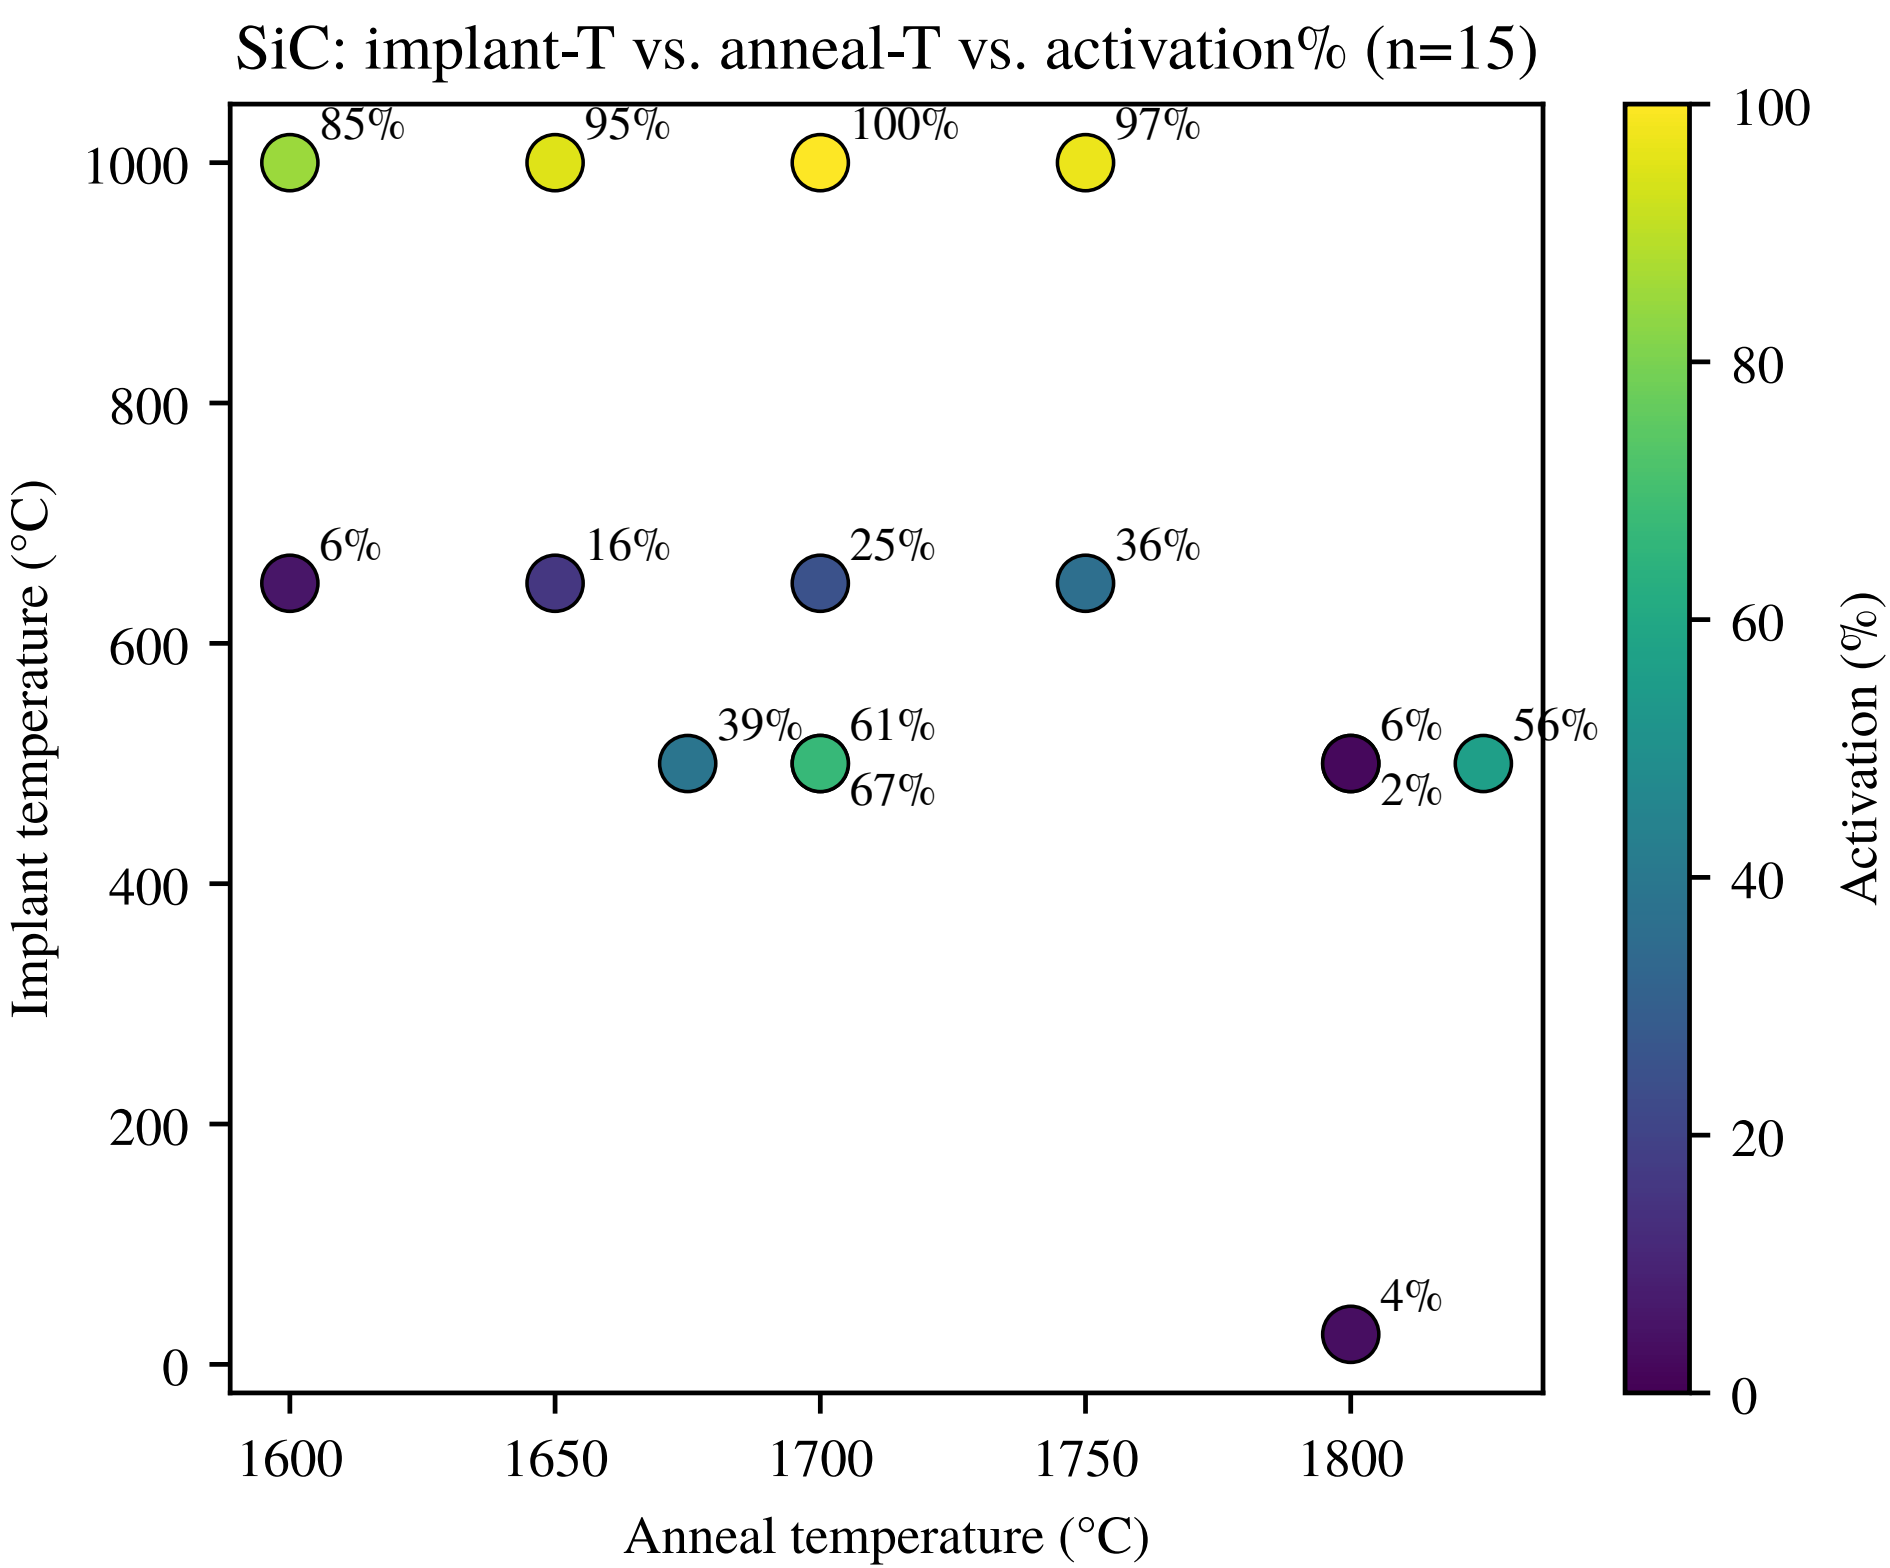
SiC: implant-T vs. anneal-T vs. activation% (n=15)
85%
95%
100%
97%
6%
16%
25%
36%
39%
61%
67%
6%
2%
56%
4%
1000
800
600
400
200
0
1600
1650
1700
1750
1800
Implant temperature (°C)
Anneal temperature (°C)
100
80
60
40
20
0
Activation (%)