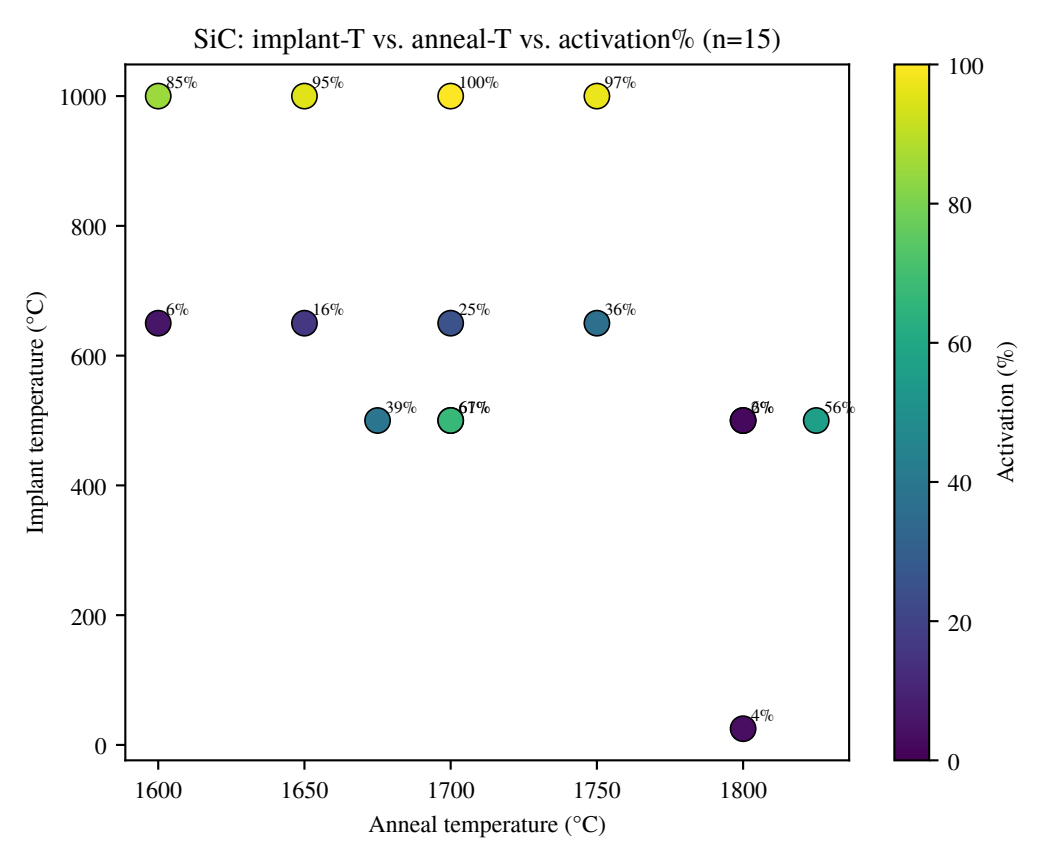
SiC: implant-T vs. anneal-T vs. activation% (n=15)
85%
95%
100%
97%
6%
16%
25%
36%
39%
56%
4%
Implant temperature (°C)
Anneal temperature (°C)
Activation (%)
0
200
400
600
800
1000
1600
1650
1700
1750
1800
0
20
40
60
80
100