

UC00575


Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 3 - Auditoria, acreditação e melhoria contínua

Objeto de Aprendizagem – 3.3 — Revisão pela Gestão

O que é a Revisão pela Gestão?

A revisão pela gestão constitui um processo sistemático e formal de análise crítica do sistema de gestão da qualidade (SGQ), conduzido pela gestão de topo do laboratório. Trata-se de um **requisito obrigatório da ISO/IEC 17025** (cláusula 8.9), cuja finalidade é avaliar a adequação, eficácia e sustentabilidade do sistema face aos objetivos estratégicos do laboratório e às exigências da acreditação.

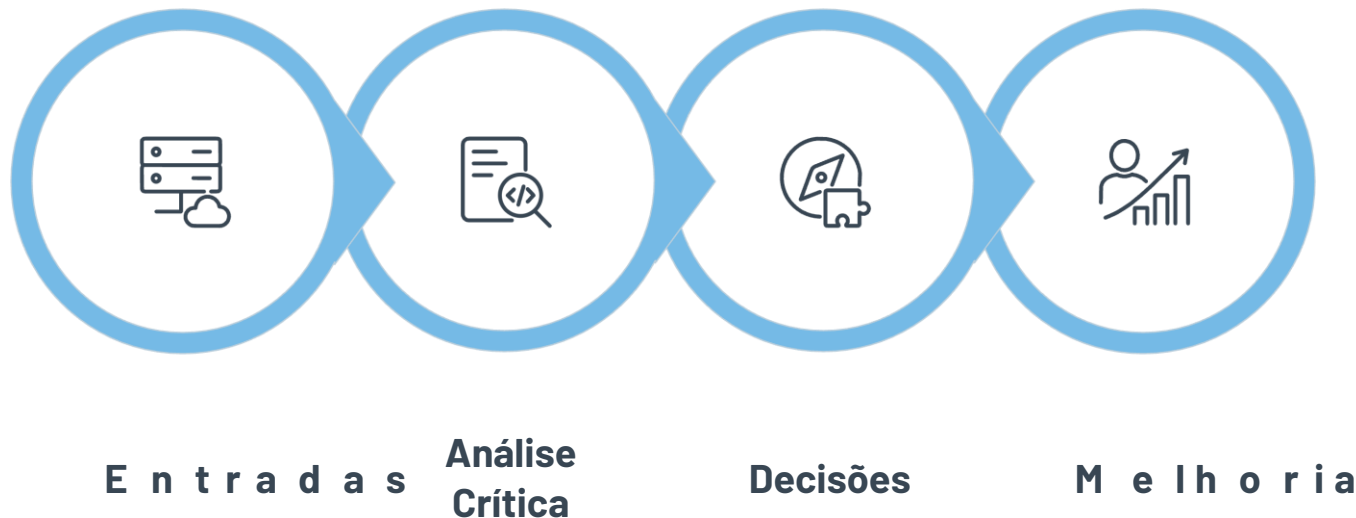

Este processo não é uma formalidade administrativa — é o mecanismo central pelo qual a gestão de topo exerce a sua responsabilidade de liderança, garantindo que o laboratório mantém a competência técnica, a conformidade normativa e a capacidade de resposta aos desafios operacionais e regulatórios.

Objetivos da Revisão pela Gestão



Eficácia do Sistema

Avaliar se o SGQ está a funcionar de forma eficaz e a produzir os resultados pretendidos ao nível técnico e organizacional.



Desempenho Técnico

Monitorizar o desempenho dos processos laboratoriais, incluindo a qualidade dos resultados e a competência técnica demonstrada.



Adequação de Recursos

Avaliar se os recursos humanos, materiais e de infraestrutura são suficientes para suportar as atividades acreditadas.



Gestão de Riscos

Identificar riscos emergentes e oportunidades de melhoria que possam impactar a conformidade ou a acreditação.



Manutenção da Acreditação

Garantir a conformidade contínua com os requisitos do IPAC e a sustentabilidade do estatuto de laboratório acreditado.

P e r i o d i c i d a d e

Revisões Obrigatórias

Revisão Anual: Realizada pelo menos uma vez por ano, cobrindo todos os elementos obrigatórios da cláusula 8.9 da ISO/IEC 17025. Constitui o ciclo formal de avaliação do SGQ.

Revisões Extraordinárias: Desencadeadas por eventos críticos, como resultados insatisfatórios em ensaios de aptidão, auditorias com constatações graves ou alterações organizacionais significativas.

Participantes Obrigatórios

- Direção / Gestão de topo
- Responsável técnico
- Responsável de qualidade
- Responsáveis de área (conforme agenda)

P l a n e a m e n t o

A g e n d a

Preparação e comunicação da agenda com antecedência suficiente para recolha e análise prévia dos dados de entrada.

Convocatória documentada

Registo formal da convocatória, presença dos participantes e aceitação das responsabilidades atribuídas.

Ata e relatório de revisão

Elaboração obrigatória de ata detalhada com decisões, prazos, responsáveis e indicadores de acompanhamento.

A r q u i v o

Conservação dos registos por período definido, assegurando rastreabilidade documental em auditorias IPAC.

Entradas Obrigatórias da Revisão pela Gestão

A ISO/IEC 17025 define um conjunto diversificado de informações que **devem ser tabelas anualmente** por a considerar em cada ciclo de revisão.

A omissão de qualquer entrada compromete a análise crítica e a eficácia das decisões.



1 Auditorias Internas

resultados e conclusões.



2 Auditorias IPAC

constatações e seguimentos.



3 Reclamações de Clientes

análise e resolução.



4 Não Conformidades

frequência e tipologia.



5 Ações Corretivas

eficácia e encerramento.



6 Indicadores do SGQ

desempenho e tendências.



7 Satisfação do Cliente

feedback e resultados.



8 Satisfação do Cliente

requisitos e expectativas.



9 Recursos Humanos e Materiais

disponibilidade e adequação.



10 Desempenho Técnico

competência laboratorial.

Auditorias e Não Conformidades

A análise de auditorias internas e externas (IPAC) e das não conformidades detetadas constitui uma das entradas mais críticas da revisão. Não basta registar o número de ocorrências — é imperativo avaliar **tendências, reincidências e impacto real na competência técnica** do laboratório.

Análise de tendências

Identificação de padrões recorrentes em áreas técnicas específicas, processos ou equipamentos, indicando fragilidades sistémicas.

Reincidência de NC


A repetição de não conformidades do mesmo tipo sinaliza falha na eficácia das ações corretivas implementadas anteriormente.

Eficácia das ações corretivas

Verificação objetiva de que as causas raiz foram eliminadas e que a recorrência foi efetivamente prevenida com evidência documentada.

Impacto na competência técnica

Avaliação do efeito das NC na validade dos resultados de ensaio, na fiabilidade dos equipamentos e na confiança dos clientes.

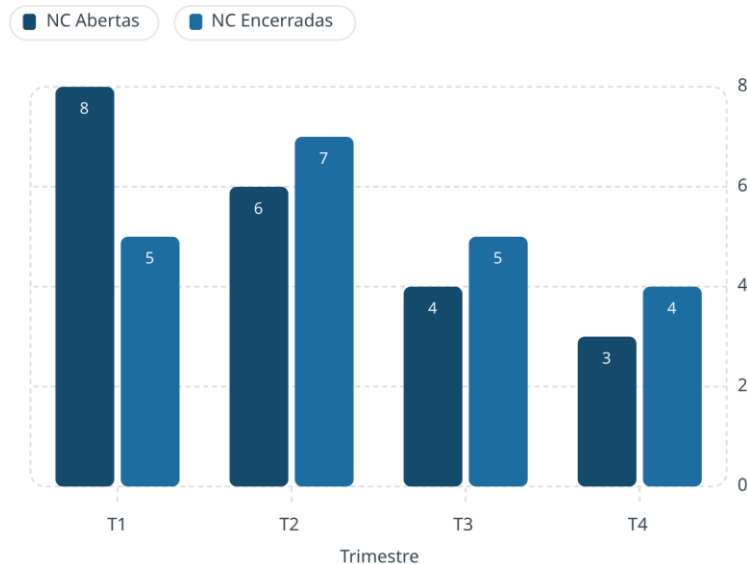

O gráfico exemplifica a evolução trimestral de NC abertas vs. encerradas — um indicador essencial para avaliar a eficácia do sistema corretivo.

Reclamações e Satisfação do Cliente


Tratamento de Reclamações

Cada reclamação deve ser analisada individualmente quanto à sua natureza (técnica, administrativa, prazo), causa raiz e resolução. A revisão pela gestão avalia a **eficácia global do processo de tratamento**, não apenas o número de ocorrências.

- **Registo e categorização formal de todas as reclamações recebidas no período**
- **Análise estatística por tipologia, área técnica e frequência de ocorrência**
- **Avaliação do tempo médio de resposta e grau de resolução satisfatória**
- **Impacto das reclamações recorrentes na definição de ações preventivas**

Análise da Satisfação do Cliente

O feedback sistemático dos clientes — através de inquéritos, entrevistas ou avaliações periódicas — fornece dados fundamentais para a revisão. O laboratório deve demonstrar que este feedback **influencia decisões concretas de melhoria**.

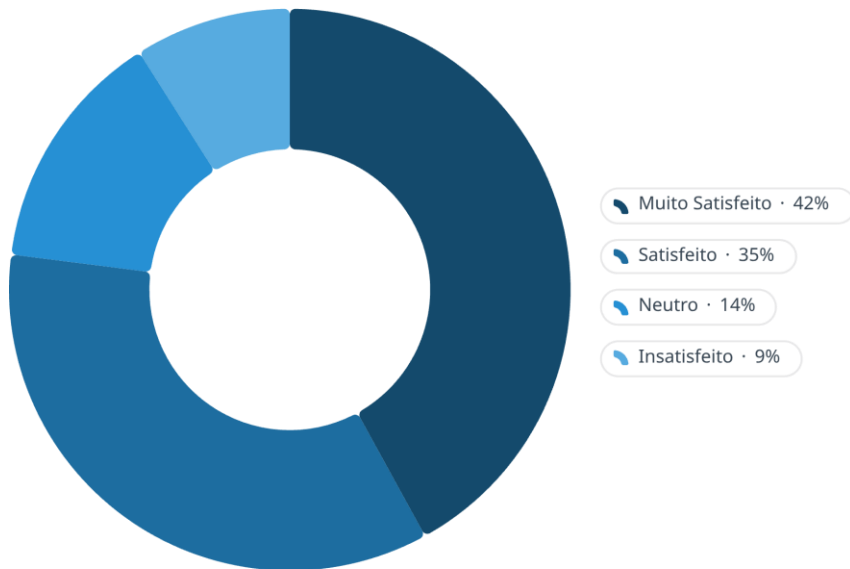

Avaliação de Fornecedores Críticos

A revisão pela gestão deve incluir uma análise estruturada do desempenho dos fornecedores com impacto direto na qualidade dos resultados laboratoriais. A ISO/IEC 17025 exige que o laboratório assegure que os serviços e produtos externos não comprometem a validade técnica dos ensaios realizados.



Serviços de Calibração

Avaliação da conformidade dos certificados de calibração, rastreabilidade metrológica, prazos de entrega e competência técnica dos laboratórios prestadores acreditados.



Consumíveis e Reagentes

Análise de desvios de qualidade, lotes rejeitados, atrasos de entrega e impacto nos ensaios. Verificação da conformidade com especificações técnicas definidas.



Manutenção de Equipamentos

Revisão dos contratos de manutenção preventiva e corretiva, tempos de resposta, equipamentos fora de serviço e impacto na capacidade operacional do laboratório.



Avaliação de Desempenho

Aplicação de critérios objetivos e documentados de avaliação periódica, com classificação formal dos fornecedores e registro das decisões de qualificação ou exclusão.

Ensaio de Aptidão e Comparações Interlaboratoriais

Os ensaios de aptidão (EA) e as comparações interlaboratoriais (CIL) constituem ferramentas de avaliação externa do desempenho técnico do laboratório. Os seus resultados são obrigatoriamente analisados na revisão pela gestão, com foco na **tendência analítica, desvios sistemáticos e ações corretivas implementadas**.

Z-score e avaliação estatística


Análise do z-score por parâmetro e método. Valores $|z| \leq 2$ são satisfatórios; $|z|$ entre 2 e 3 são questionáveis; $|z| > 3$ são insatisfatórios e exigem ação corretiva imediata com investigação de causa raiz.

Tendência analítica

Avaliação longitudinal dos resultados ao longo de vários ciclos para deteção de tendências sistemáticas (bias) que possam indicar deriva de equipamento, reagentes ou competência do analista.

Impacto na acreditação

Resultados insatisfatórios recorrentes num mesmo parâmetro podem implicar suspensão do âmbito de acreditação pelo IPAC, tornando este indicador crítico para a gestão de topo.

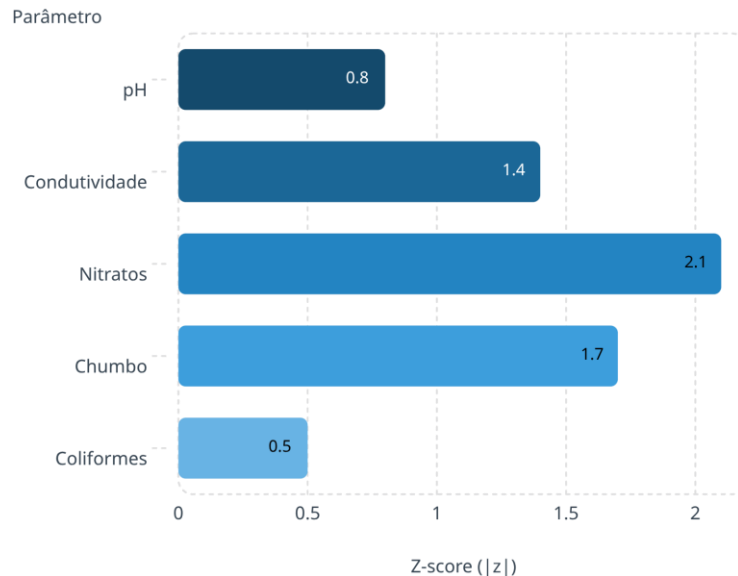

⚠ Z-score $|z| > 2$ para Nitratos — requer investigação e ação corretiva documentada antes da próxima ronda.

Recursos Humanos e Gestão de Competências

Dimensões a Avaliar

- Necessidades de formação técnica e normativa identificadas no período
- Avaliação formal de competências por técnico e por método
- Gestão de autorizações técnicas e suas renovações
- Planeamento de substituições e cobertura de ausências
- Análise da carga de trabalho vs. capacidade instalada
- Retenção do conhecimento técnico em caso de saída de colaboradores

 A adequação dos recursos humanos à escala e complexidade dos ensaios acreditados é um requisito explícito da cláusula 6.2 da ISO/IEC 17025.

Matriz de Competências Técnicas

Técnico / Método	Método A	Método B	Método C	Método D
Técnico 1	☒ Autorizado	☒ Autorizado	☐ Em formação	☒ N/A
Técnico 2	☒ Autorizado	☒ N/A	☒ Autorizado	☒ Autorizado
Técnico 3	☐ Em formação	☒ Autorizado	☒ Autorizado	☒ N/A
Técnico 4	☒ N/A	☒ Autorizado	☒ N/A	☒ Autorizado

A matriz de competências permite identificar lacunas de cobertura, dependências críticas num único técnico e prioridades de formação para o próximo ciclo.



R e c u r s o s

Equipamentos e Calibrações

Avaliação do estado de calibração de todos os equipamentos críticos, conformidade dos certificados, prazos vencidos e plano de recalibração para o próximo período. Verificação da rastreabilidade metrológica.

Manutenção Preventiva

Análise do cumprimento do plano de manutenção preventiva, registo de avarias, tempos de imobilização de equipamentos e impacto na disponibilidade operacional do laboratório.

Software e Sistemas de Informação


Revisão da validação de software laboratorial, atualizações, cópias de segurança, controlo de acessos e integridade dos dados gerados e armazenados electronicamente.

Condições Ambientais

Análise dos registos de monitorização de temperatura, humidade relativa, pressão e outros parâmetros ambientais críticos, verificando conformidade com os requisitos dos métodos de ensaio acreditados.

Indicadores Dashboard

A revisão pela gestão exige uma análise quantitativa e baseada em evidências do desempenho global do SGQ. Os indicadores abaixo representam um painel executivo de referência para laboratórios acreditados.

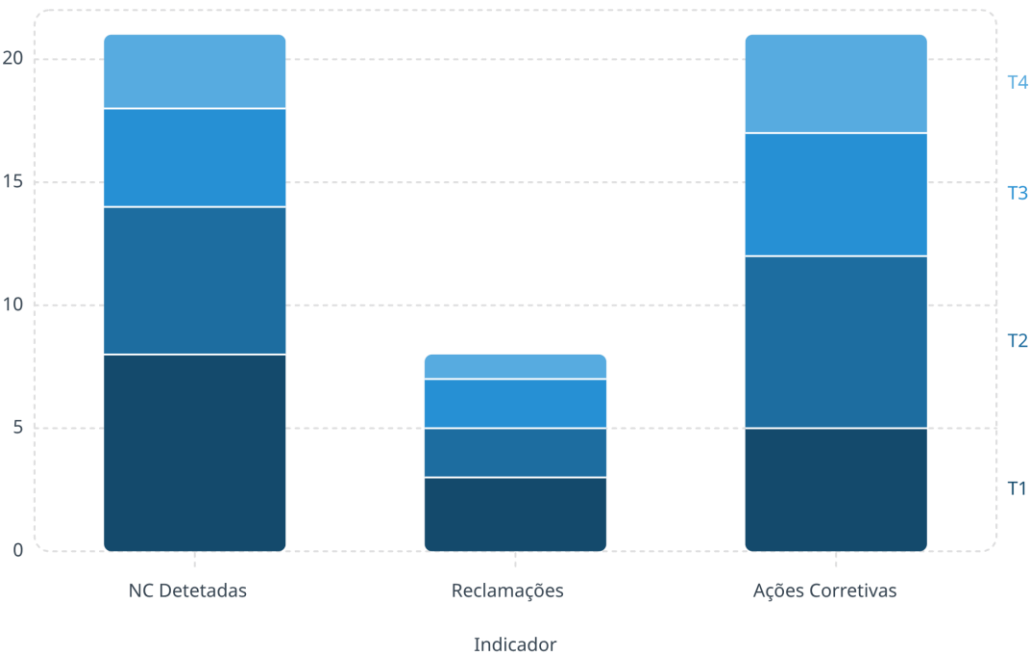

9

Taxa

Percentagem de ações corretivas encerradas dentro do prazo definido.

1

Dias médios de resposta

Tempo médio de resposta a reclamações de clientes no período anual.

8

Satisfação do cliente

Índice global de satisfação apurado nos inquéritos do período.

Definição de Ações e Objetivos Estratégicos

A revisão pela gestão do SGQ termina com a definição de objetivos e **ações estratégicas**, definindo responsabilidades, necessidades e prazos. Estas decisões constituem a base formal da revisão e o motor do ciclo de melhoria contínua do laboratório.



1



Objetivos SMART

Específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporalmente definidos.
Ex.: Reduzir NC em 20% até ao 31/12 do próximo ano.

2



Responsável designado

Cada ação deve ter um responsável formalmente identificado, com autoridade e recursos para a sua execução efetiva.

3



Prazo e marco de verificação

Definição da data limite e de um ponto de verificação intermédio para acompanhamento do progresso da ação implementada.

4



Indicador de eficácia

Critério mensurável e objetivo que permite confirmar, na próxima revisão, que a ação produziu o resultado pretendido.



Objetivos claros, ações bem definidas e acompanhamento rigoroso resultam em **decisões eficazes** e em **melhoria contínua** do SGQ.



Registos da Revisão pela Gestão

A ISO/IEC 17025 exige que os resultados da revisão pela gestão sejam **documentados e conservados como registos de qualidade**. A rastreabilidade documental é verificada pelo IPAC em auditorias de acompanhamento e renovação da acreditação.

→ Ata de revisão detalhada

Registo completo de todos os pontos analisados, participantes presentes, discussões relevantes e conclusões alcançadas em cada ponto da agenda.

→ Relatório de revisão pela gestão

Documento formal que sintetiza as entradas analisadas, os resultados obtidos e as saídas da revisão, incluindo o sumário executivo para a gestão de topo.

→ Planos de ação documentados

Registo estruturado de todas as ações definidas, com identificação do objetivo, responsável, prazo, recursos necessários e indicador de verificação.

→ Evidências de seguimento

Documentação do acompanhamento das ações definidas em revisões anteriores, demonstrando o ciclo de melhoria contínua ao longo dos anos.

Requisito normativo — cláusula 8.9.3

A norma ISO/IEC 17025 exige explicitamente que o laboratório conserve registos das revisões pela gestão, incluindo as decisões tomadas e as ações acordadas. Estes registos constituem evidência objetiva do cumprimento do requisito e são auditados pelo IPAC.

Documento	Responsável	Retenção
Ata de revisão	Resp. Qualidade	Mínimo 5 anos
Relatório de revisão	Direção	Mínimo 5 anos
Plano de ações	Resp. Técnico	Mínimo 5 anos
Convocatória	Resp. Qualidade	Mínimo 5 anos
Evidências de seguimento	Designado	Mínimo 5 anos

O Papel da Gestão de Topo

Liderança Ativa

A gestão de topo não pode delegar a revisão — deve presidir, participar ativamente e demonstrar envolvimento real nas decisões estratégicas do SGQ.



Cultura

A gestão de topo é responsável por promover uma cultura organizacional onde a qualidade, a imparcialidade e a integridade técnica são valores partilhados por todos os colaboradores.



Compromisso

O compromisso explícito da gestão de topo com a manutenção da acreditação e com a melhoria contínua é um requisito normativo verificável da cláusula 5.2 da ISO/IEC 17025.

Alocação de Recursos

As decisões sobre alocação de recursos humanos, financeiros e materiais são uma saída crítica da revisão e refletem o compromisso real da gestão com a sustentabilidade do sistema acreditado.

Erros Frequentes na Revisão pela Gestão

Estes são os erros mais detetados pelo IPAC em auditorias de acompanhamento e renovação. A sua identificação é essencial para garantir que a revisão pela gestão cumpre o seu propósito estratégico e normativo.

⊘ Revisão apenas formal e burocrática

A revisão é realizada para "cumprir o requisito" sem análise crítica real dos dados. As conclusões são genéricas e não refletem o estado real do SGQ.

⊘ Ausência de indicadores mensuráveis

Discussão baseada em perceções subjetivas sem suporte em dados quantitativos. Impossibilidade de avaliar evolução face ao período anterior ou face a objetivos definidos.

⊘ F a l t a ações anteriores

As ações definidas na revisão anterior não são sistematicamente verificadas, criando um ciclo de decisões sem implementação efetiva e sem avaliação de eficácia.

⊘ Objetivos sem monitorização nem responsável

Definição de objetivos vagos, sem responsável designado, sem prazo e sem critério de verificação. Estes objetivos ficam por cumprir e não são revisitados.

⊘ Decisões sem implementação documentada

A gestão de topo toma decisões que não são formalizadas nem comunicadas aos responsáveis de área, resultando em ausência de evidências para o IPAC.

Boas Práticas na Revisão pela Gestão



Análise baseada em dados

Todas as conclusões e decisões devem ser suportadas por dados objetivos e indicadores mensuráveis, evitando avaliações subjetivas sem evidência documental.



Foco na melhoria contínua

Cada revisão deve produzir pelo menos uma iniciativa concreta de melhoria, demonstrando que o processo conduz a evolução real e não apenas a manutenção do status quo.



Gestão de risco proativa

Identificar e avaliar riscos emergentes durante a revisão permite antecipar problemas e implementar medidas preventivas antes que se tornem não conformidades.



Participação multidisciplinar

Envolver responsáveis técnicos de todas as áreas laboratoriais garante uma visão completa do desempenho e aumenta a qualidade das decisões estratégicas.



Integração com auditorias

A revisão pela gestão deve integrar sistematicamente os resultados das auditorias internas e externas, fechando o ciclo entre avaliação independente e decisão de gestão.



Acompanhamento contínuo

Estabelecer mecanismos formais de monitorização intercalar das ações definidas, sem esperar pela próxima revisão anual para verificar o seu progresso.

Conclusão

"A revisão pela gestão transforma dados operacionais em decisões estratégicas para garantir competência técnica, conformidade e sustentabilidade do sistema acreditado."

Requisito

A revisão pela gestão é um requisito não negociável da ISO/IEC 17025, verificado pelo IPAC em todas as auditorias de acreditação e renovação.

Ferramenta de liderança estratégica

Quando realizada com rigor, é o mecanismo mais eficaz de que a gestão de topo dispõe para alinhar o laboratório com os seus objetivos técnicos e organizacionais.

Motor da melhoria contínua

Cada ciclo de revisão deve produzir melhorias concretas e mensuráveis, evidenciando a maturidade e a evolução do sistema de gestão laboratorial ao longo do tempo.

