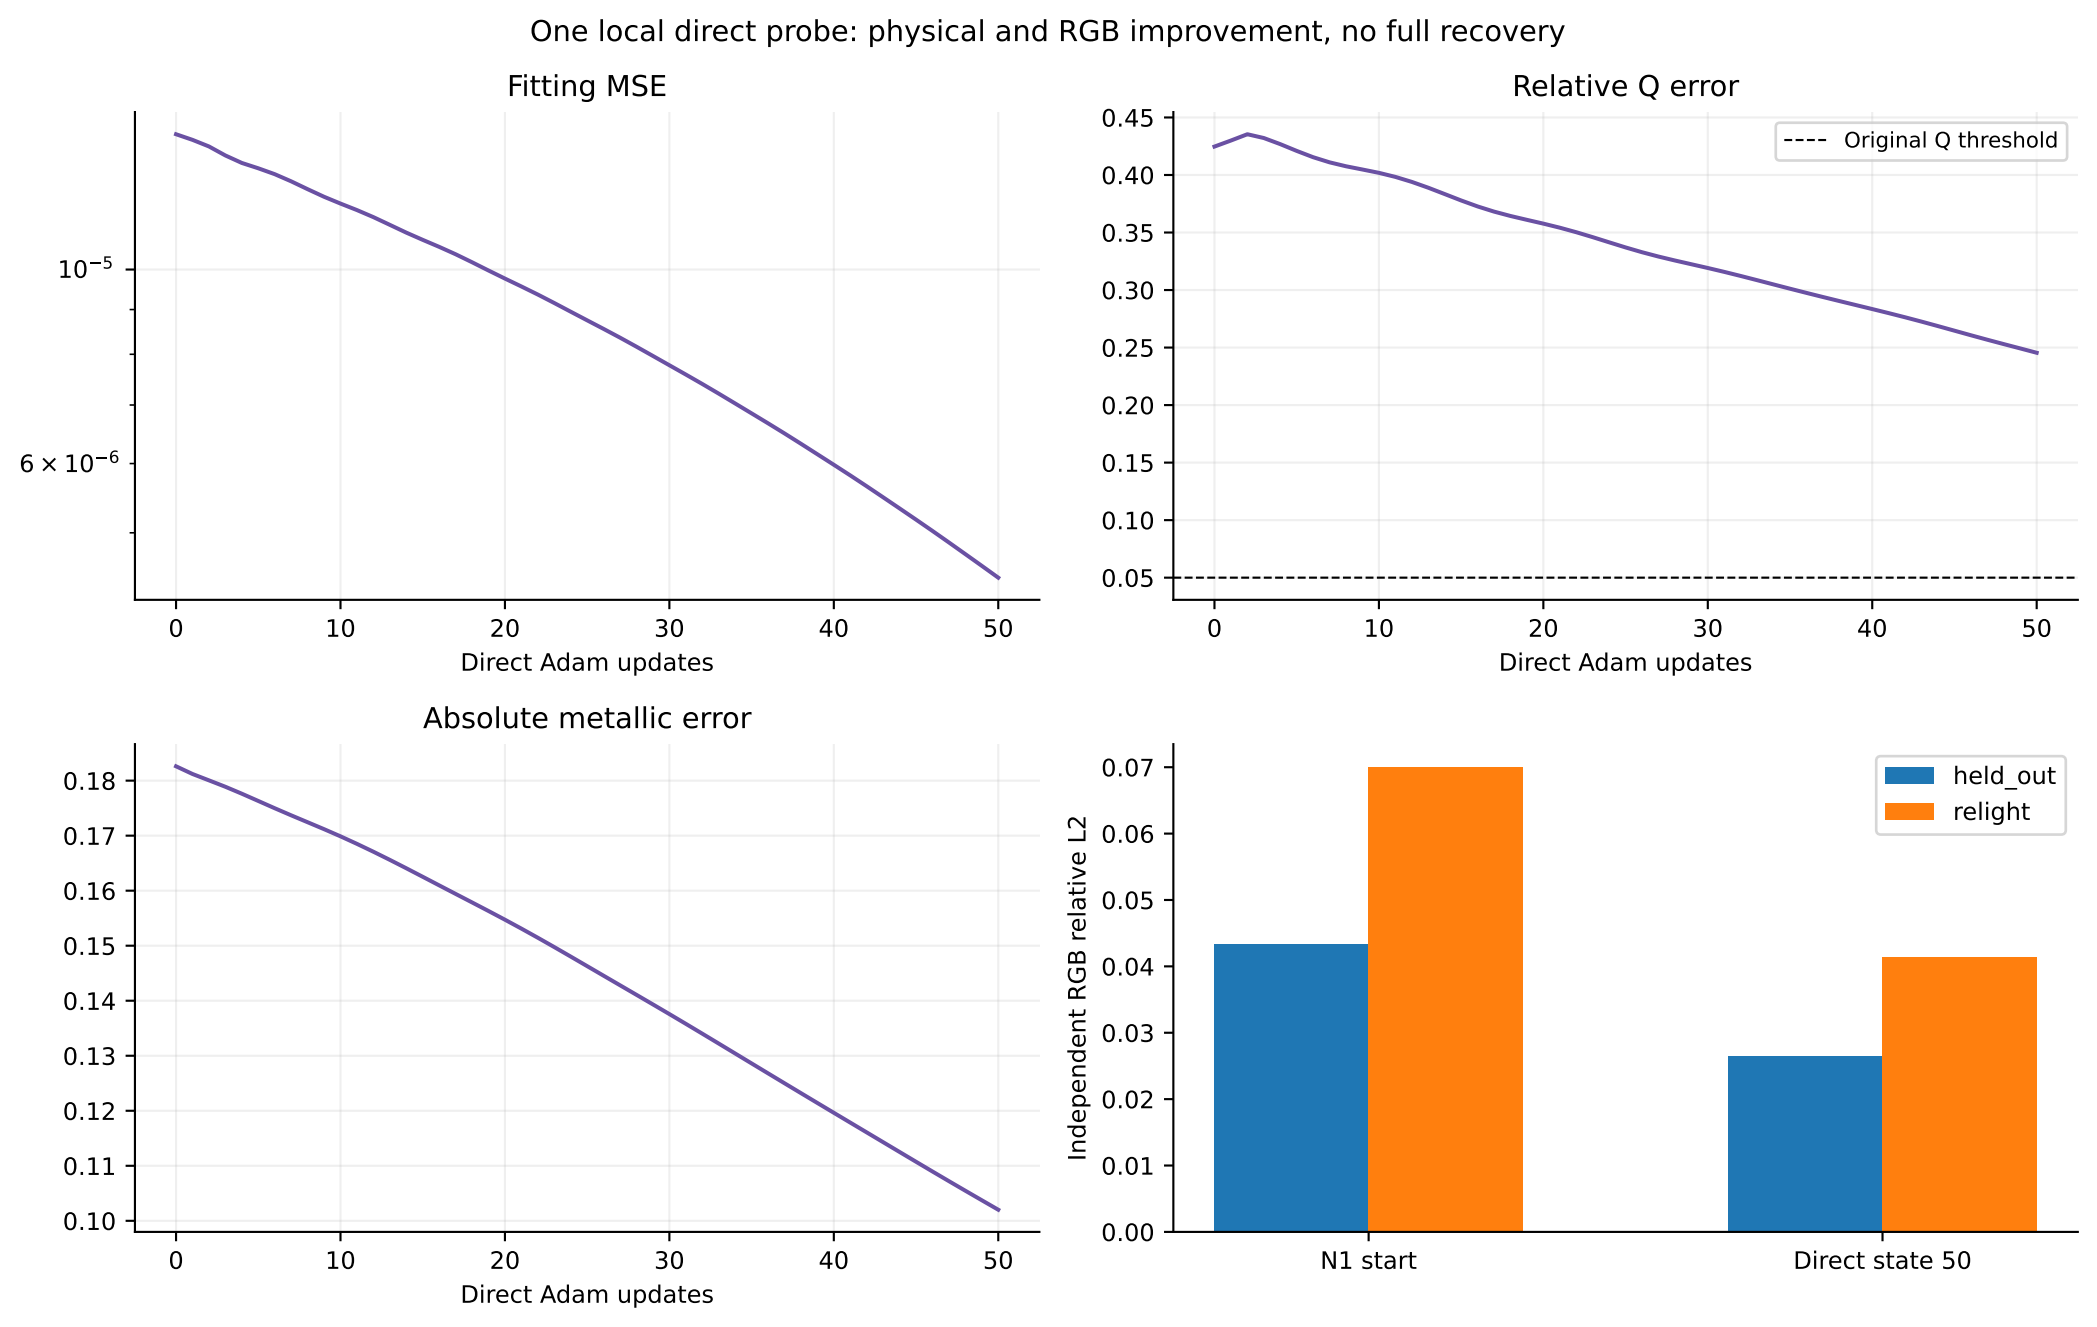
One local direct probe: physical and RGB improvement, no full recovery
Fitting MSE
10^{-5}
6×10^{-6}
0
10
20
30
40
50
Direct Adam updates
Relative Q error
Original Q threshold
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
10
20
30
40
50
Direct Adam updates
Absolute metallic error
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0
10
20
30
40
50
Direct Adam updates
Independent RGB relative L2
held_out
relight
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
N1 start
Direct state 50