



PROTOKOLOVÁ PŘÍRUČKA

Tato protokolová příručka doprovází hru Keep It Contained a je nezbytná
pro její správné používání.

KRITICKÉ PROTOKOLY BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

Tato příručka bude vaším jediným zdrojem podpory při udržování neznámých forem života pod kontrolou, pokud se pokusí překročit karanténní hranici.

Jste operátor; příslušné protokoly pro každý scénář, se kterým se můžete setkat, naleznete zde.

OBECNÉ INFORMACE O MODULECH

Moduly se nacházejí v horní části ovládacího panelu. Hlavní cíle, které musíte vyřešit k zadržení organismů, jsou moduly.

Moduly, se kterými se setkáte, se mohou v každé úrovni lišit a jsou obvykle náhodné.

Podrobné informace o modulech jsou uvedeny na stranách 4-9.

OBECNÉ INFORMACE O PROSTŘEDÍ


Detaily, které vidíte ve svém prostředí, mohou ovlivnit řešení modulů nebo jejich řešení ztížit.

Podrobné informace o prostředí jsou uvedeny na stranách 10-13.

Doporučuje se si je předem přečíst, abyste byli připraveni.

Pokyny k zapojení vodičů

- Modul obsahuje čtyři vodiče a čtyři vstupní sloty.
- Každý vstupní slot je označen symbolem.
- Symboly jsou uspořádány zleva doprava a musí být popsány v tomto pořadí.
- Sloupce níže označují pořadí priority symbolů.
- Pokud je popsán symbol na nejvyšší pozici v některém sloupci, musí být připojen k vodiči barvy uvedené v daném sloupci.
- Pokud je některý vodič již připojen k symbolu, daný sloupec se ignoruje.

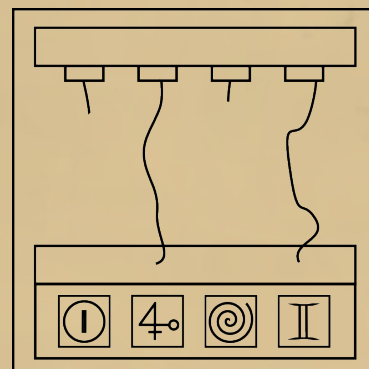

Zelená:

Ⓢ
♀♂
II
☹
⋅I⋅
☹
⌘
♀♂

Žlutá:

☹
☹
⋅I⋅
♀♂
⌘
♀♂
Ⓢ
II

Modrá:


♀♂
II
☹
⌘
☹
Ⓢ
⋅I⋅
♀♂

Červená:

☹
♀♂
☹
♀♂
Ⓢ
⋅I⋅
II
⌘

Pokyny k uvolnění plynu

- Modul obsahuje tři barevné plynové nádrže, z nichž každá je ovládána přepínačem.
- Obrazovka vlevo nahoře zobrazuje barvu krve. Obrazovka vpravo nahoře zobrazuje úroveň čistoty.

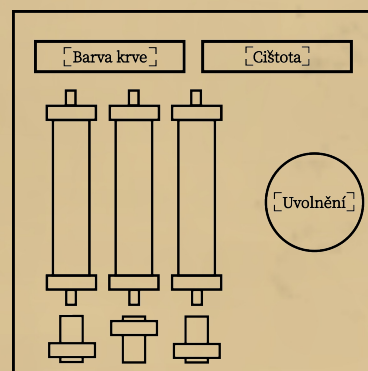


- Pro výběr plynů k uvolnění je třeba přepínače pod jednotlivými nádržemi přepnout dolů.
- Stiskněte červené tlačítko pro uvolnění vybraných plynů.
- Přečtěte si pravidla v daném pořadí a proveďte první platnou instrukci.

1. Pokud je barva krve zelená a úroveň čistoty střední, uvolněte levý a prostřední plyn.
2. Pokud je ovládací panel napájen více než dvěma zdroji energie a úroveň čistoty je čistá, uvolněte všechny plyny.
3. Pokud je barva krve červená a svítí alespoň tři indikátory RAD, neuvolňujte žádný plyn.
4. Pokud je na panelu pouze jeden zdroj energie a nesvítí žádné indikátory BIO, uvolněte pouze prostřední plyn.
5. Pokud je barva krve žlutá nebo je úroveň čistoty nízká, uvolněte levý a pravý plyn.
6. Pokud je úroveň čistoty nulová a svítí pouze dva indikátory RAD, uvolněte pouze levý plyn.
7. Pokud je barva krve modrá a úroveň čistoty vysoká, uvolněte prostřední a pravý plyn.
8. Pokud neplatí žádná z výše uvedených podmínek, uvolněte pouze pravý plyn.

Pokyny k anomáliím


1. Podívejte se na symbol zobrazený na obrazovce a postupujte podle pokynů v Kroku 1.

2. Pomocí získaných informací postupujte podle pokynů v Kroku 2 a určete, o kterou anomálii se jedná.

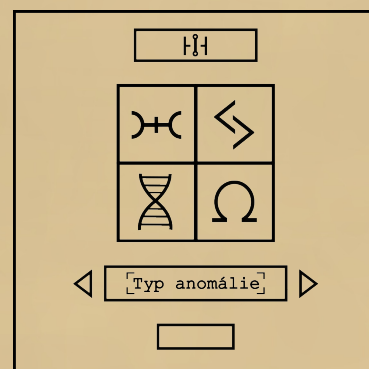

Krok 1:

- Symbol na obrazovce představuje sloupec, ve kterém se nachází.
- Ze čtyř symbolů zobrazených technikovi stisknete tlačítko se symbolem, který do daného sloupce nepatří.
- Tento postup opakuje tolikrát, kolikrát je potřeba, poté pokračujte ke

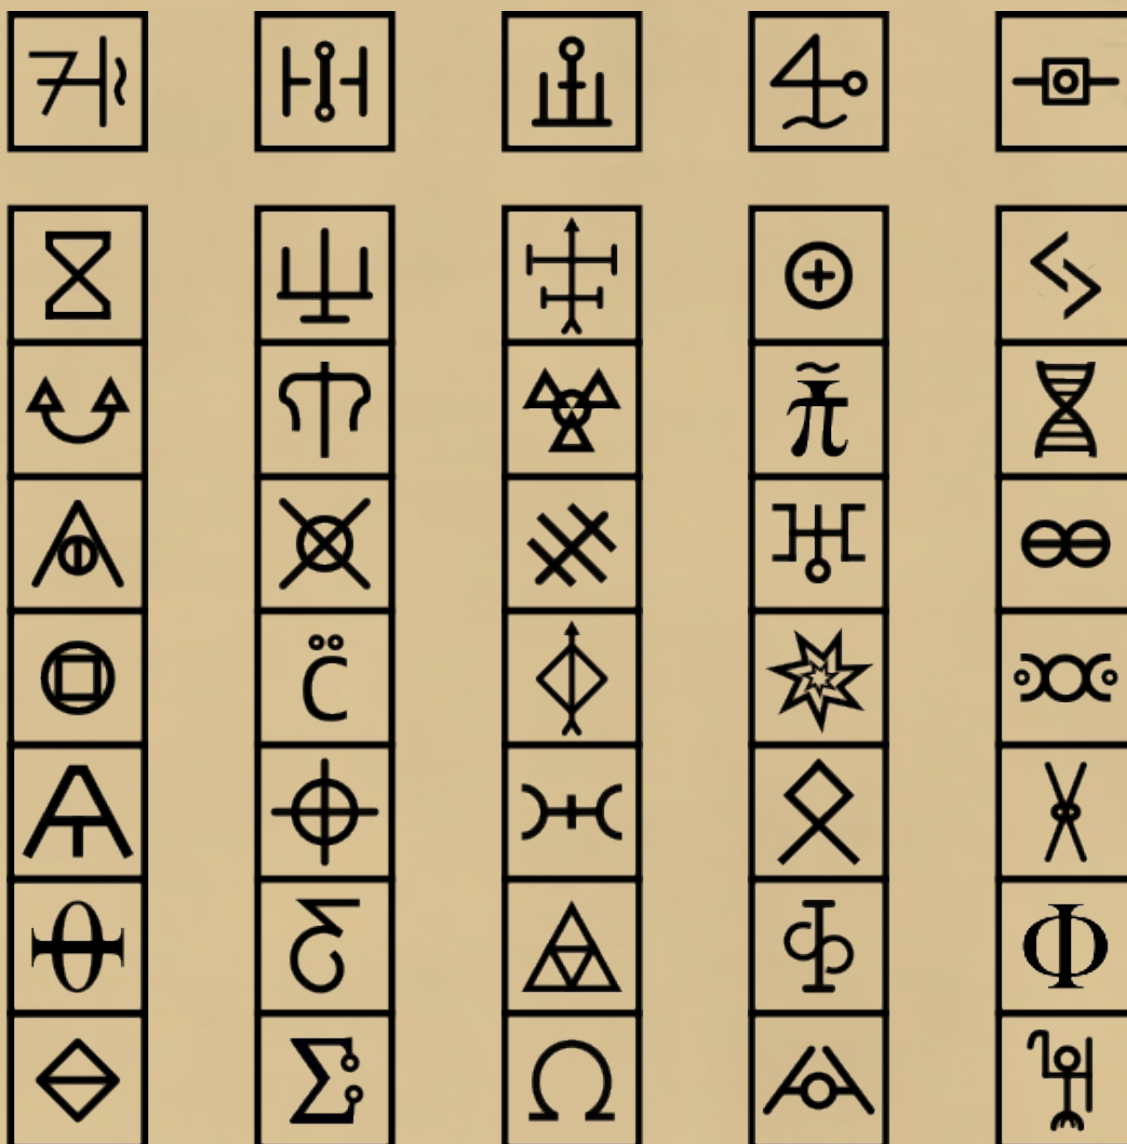

Krok 2:

- Identifikujte anomálii na základě skupiny, která obsahuje všechny tři stisknuté symboly, poté ji zadejte na displeji modulu a potvrďte.

Typy anomálií:


Leach



Mycrotide



Crack

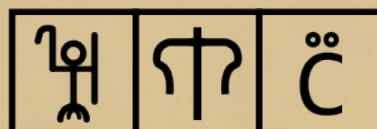

Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink




Glitch



Time




Unknown

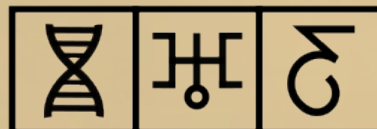


Pokyny k silovým polím


- Postupujte podle níže uvedených pokynů podle barvy kabelu.
- Pokud není žádný kabel k přestřižení, přestřihněte nejspodnější kabel.

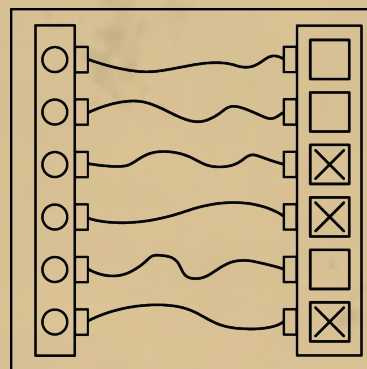


Červený kabel:

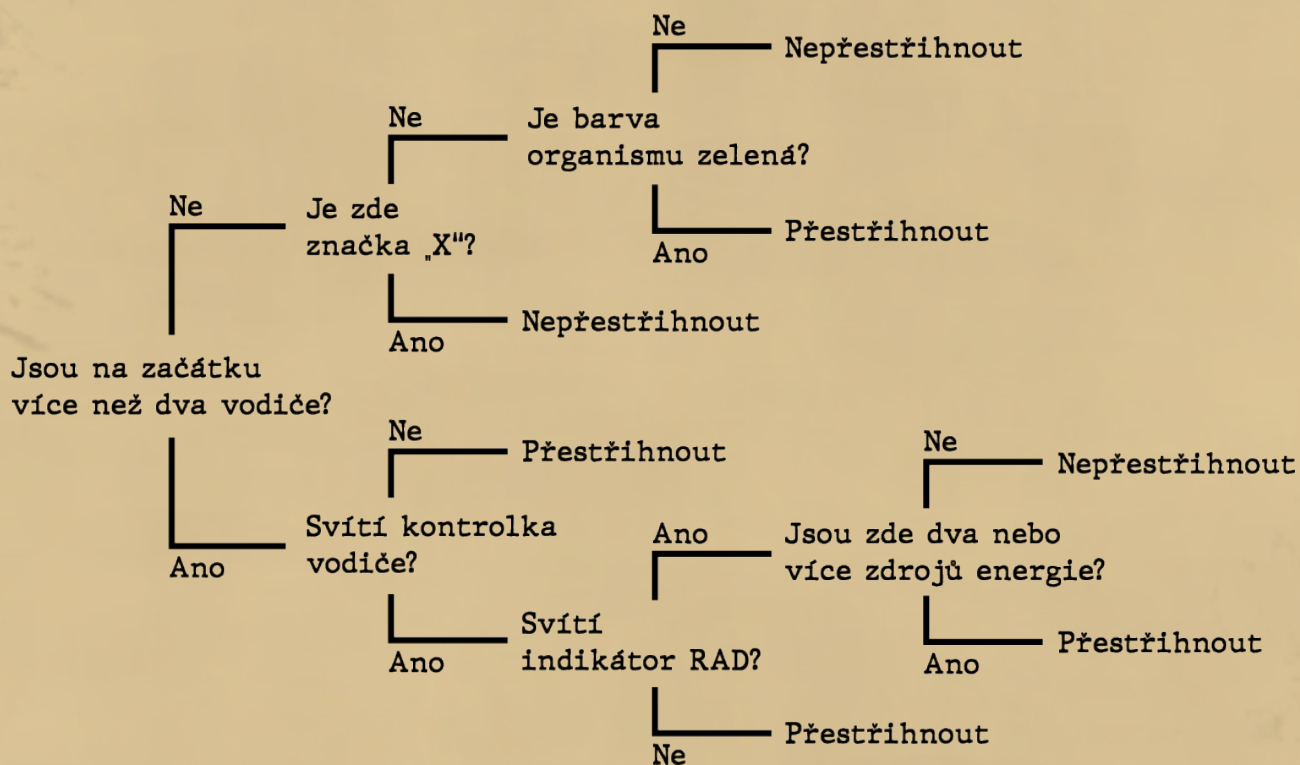

Modrý kabel:

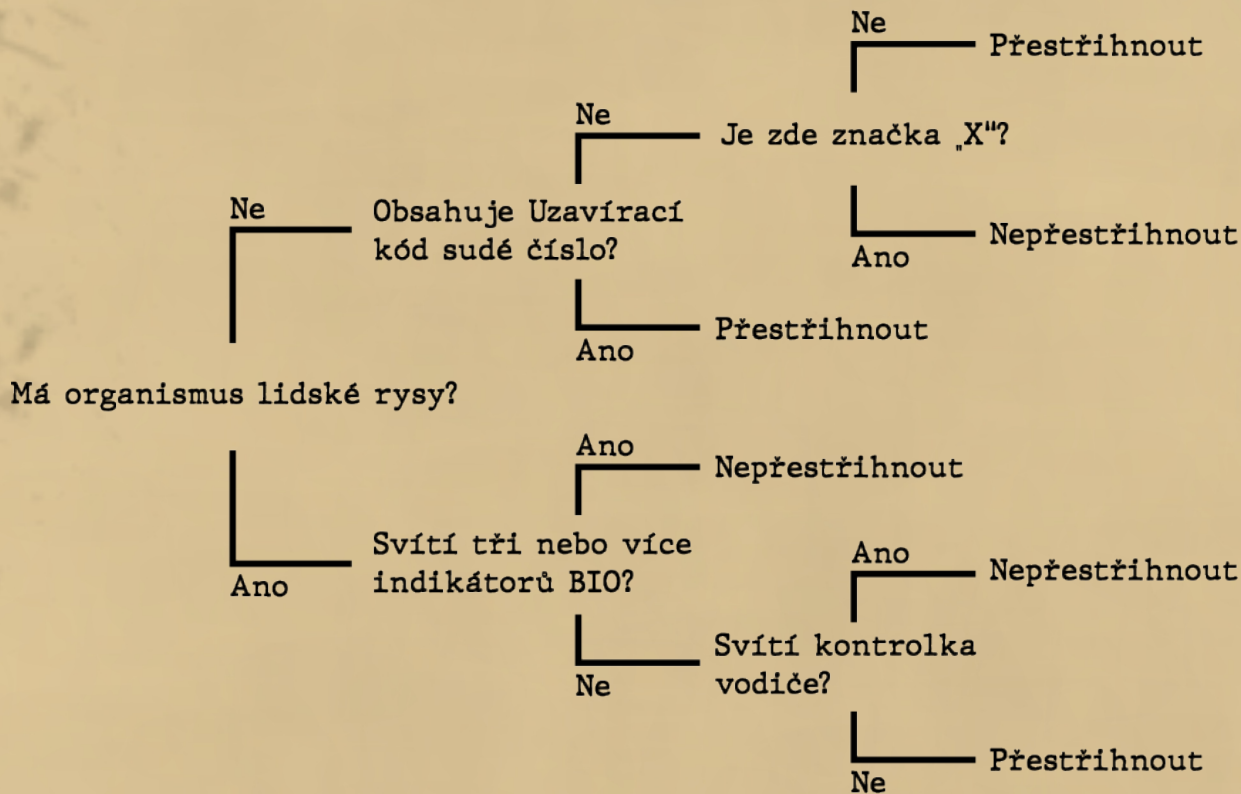


Žlutý kabel:

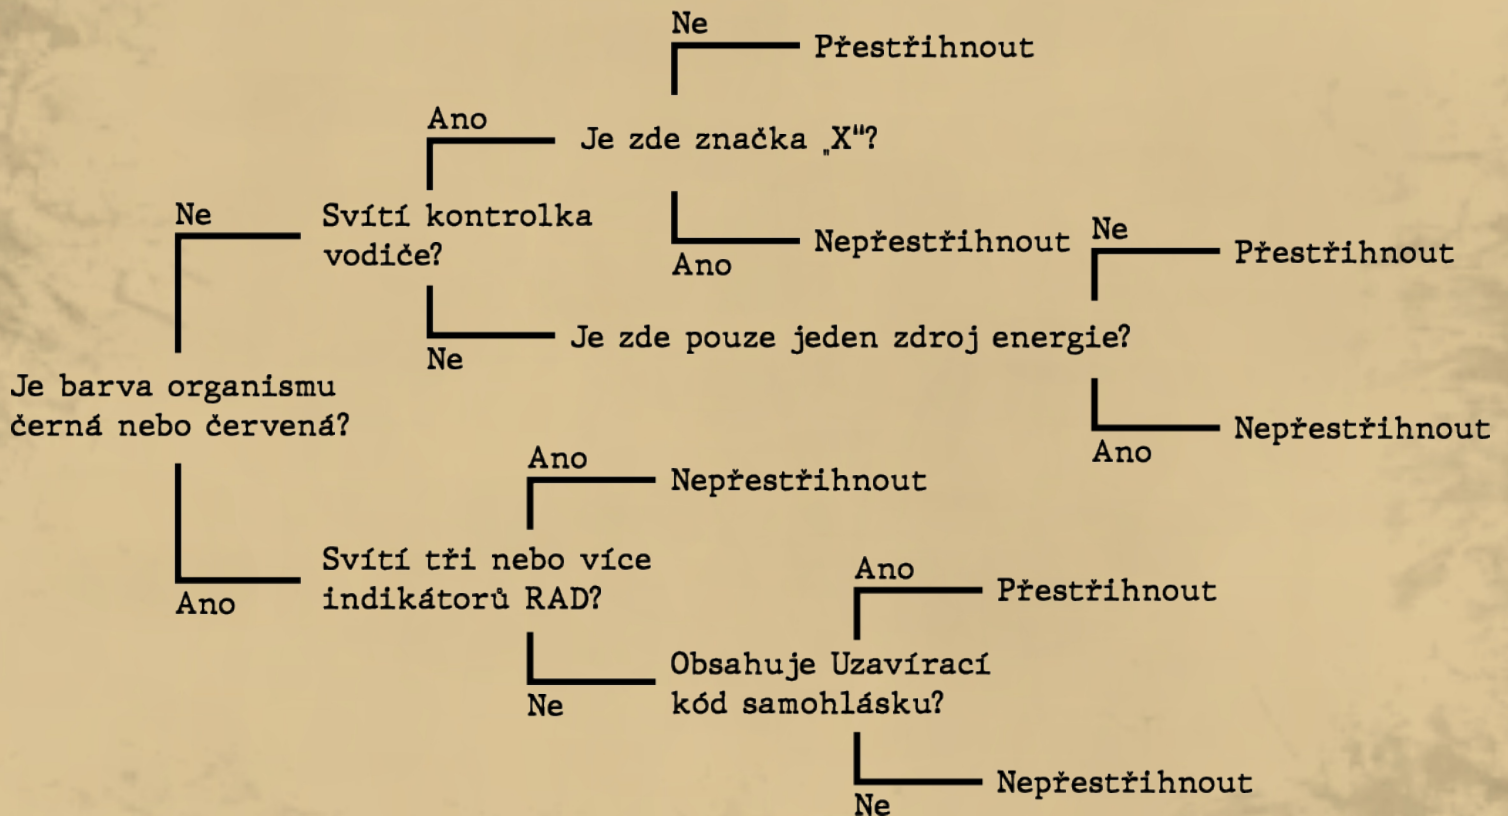

Pokyny k podmínkám


- Použijte informace z ukazatelů tlaku a teploty na modulu k přesunutí posuvníků do správných poloh.
- Pokud posuvník dosáhne úplně nahoře nebo dole, pokračujte v počítání z opačného konce.
- Každý posuvník posouvejte opatrně, protože tlak a teplota se budou měnit a nesmí být uvolněn ve špatné poloze.

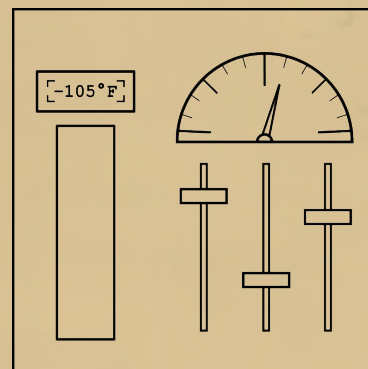

	Pokud je teplota mezi 150°F a 75°F	Pokud je teplota mezi 75°F a 0°F	Pokud je teplota mezi 0°F a -75°F	Pokud je teplota mezi -75°F a -150°F
Pokud je tlak mezi 0 a 45 PSI	Nastavte 2. posuvník o +4 pozice.	Nastavte 1. posuvník o -3 pozice.	Nastavte 3. posuvník o +7 pozic.	Nastavte 2. posuvník o -9 pozic.
Pokud je tlak mezi 45 a 90 PSI	Nastavte 1. posuvník o +1 pozici.	Nastavte 3. posuvník o -5 pozic.	Nastavte 2. posuvník o +8 pozic.	Nastavte 1. posuvník o +6 pozic.
Pokud je tlak mezi 90 a 135 PSI	Nastavte 3. posuvník o -2 pozice.	Nastavte 2. posuvník o -1 pozici.	Nastavte 1. posuvník o -7 pozic.	Nastavte 3. posuvník o +9 pozic.
Pokud je tlak mezi 135 a 180 PSI	Nastavte 2. posuvník o +2 pozice.	Nastavte 1. posuvník o -9 pozic.	Nastavte 3. posuvník o +3 pozice.	Nastavte 2. posuvník o -6 pozic.

Pokyny k sekvenci DNA

1. Vyberte správnou tabulku podle barvy DNA.
2. Stiskněte tlačítko odpovídající bázi, která bliká na obrazovce.
3. Při každém správném stisknutí se objeví nová báze a přidá se za dříve zadanou, čímž vznikne sekvence.

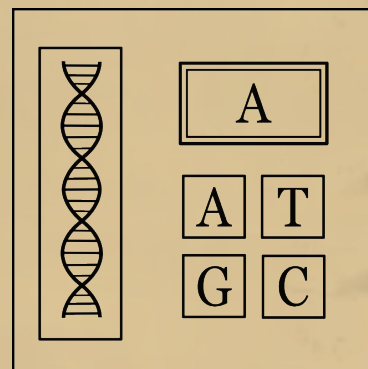

Pokaždé, když je přidána nová báze, musí být sekvence zadána znovu od začátku, dokud není modul dokončen.

Červená DNA:

Pokud kód pečetění obsahuje samohlásku:

Pokud kód pečetění neobsahuje samohlásku:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
G	A	C	T
C	G	A	T

Žlutá DNA:

Pokud kód pečetění obsahuje sudé číslo:

Pokud kód pečetění neobsahuje sudé číslo:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
A	C	G	T
T	A	C	G

Modrá DNA:

Pokud je součet čísel v kódu pečetění sudý:

Pokud je součet čísel v kódu pečetění lichý:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
A	G	T	C
G	A	T	C

Fialová DNA:



Pokud je poslední písmeno kódu pečetění samohláska:

Pokud je poslední písmeno kódu pečetění souhláska:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
T	C	G	A
C	T	A	G


Pokyny pro klávesnici

- Přiřaďte svítící tlačítka k černým políčkům, abyste našli správnou klávesnici.
- Stiskněte tlačítka označená „X“.
- Opakujte, dokud není modul dokončen.

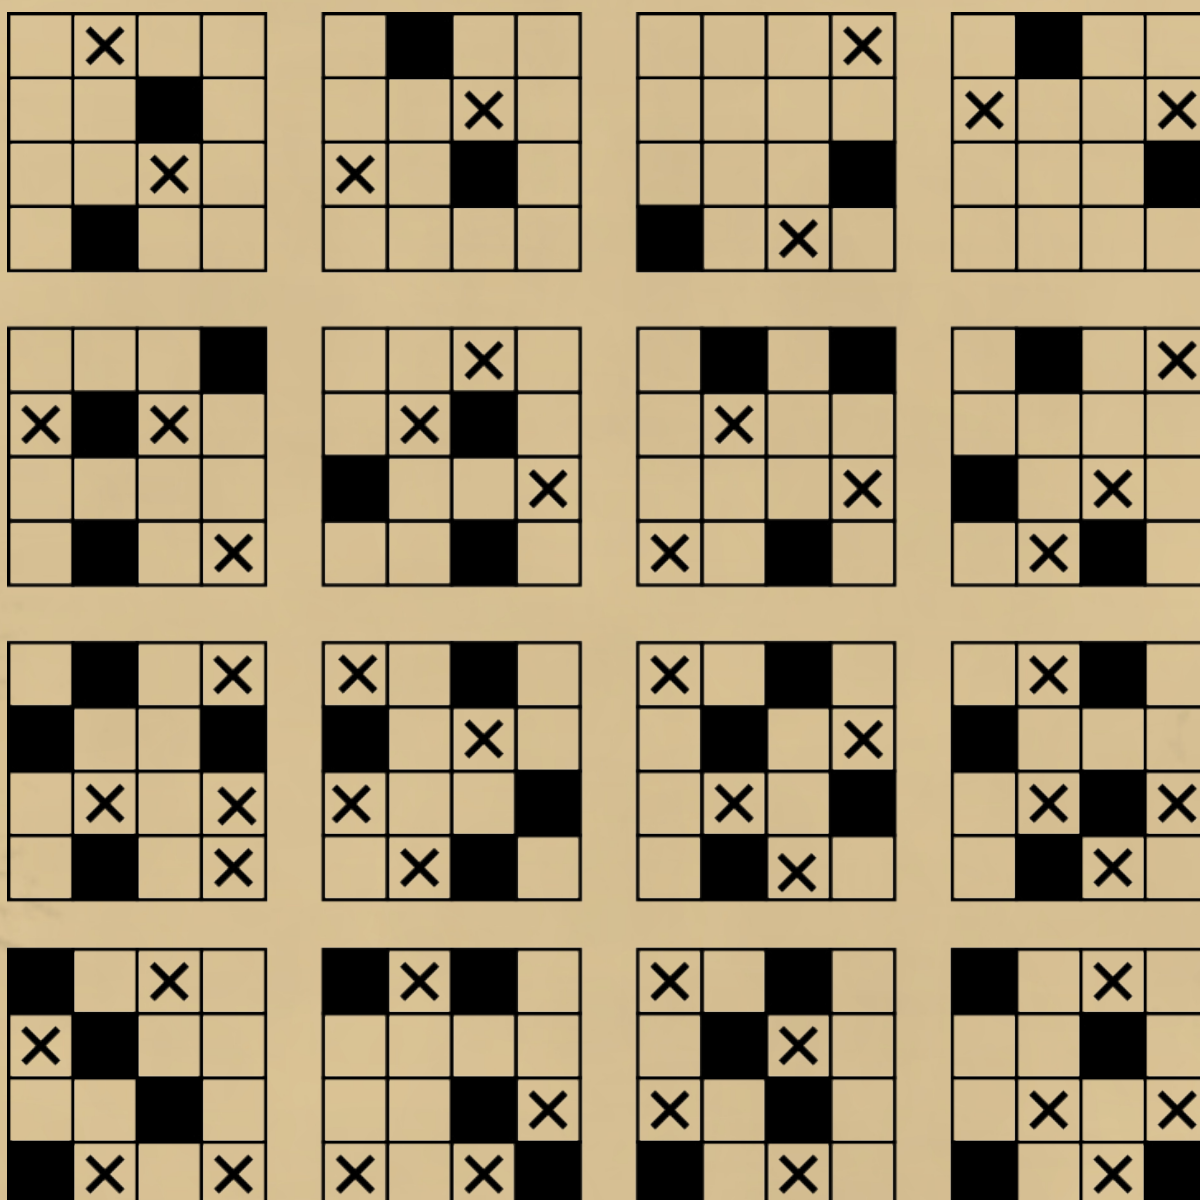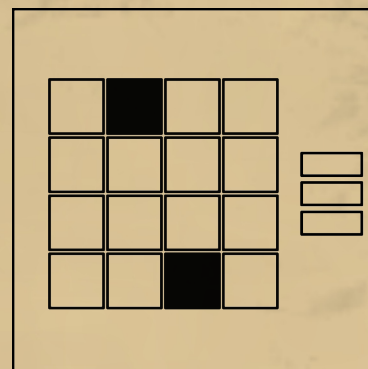


Pokyny ke kompasu


- Poloha světél kolem kompasu ukazuje, který ze 4 přepínačů je třeba otočit.
- Polohy světél jsou určeny směrem, kterým kompas ukazuje.
- Jakmile jsou všechny přepínače otočeny, modul je dokončen.

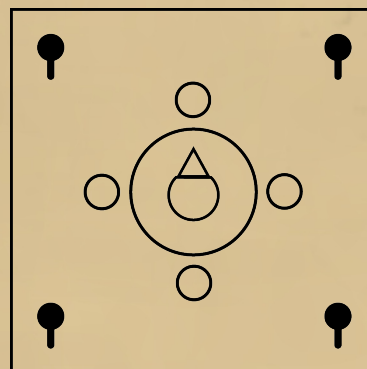


- Pořadí kódování přepínačů:




- Otočte D

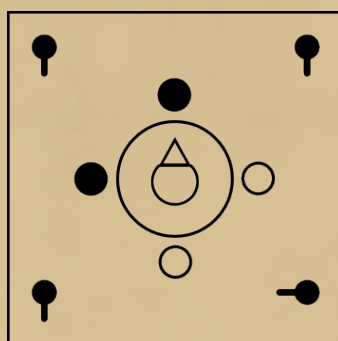


- Otočte A

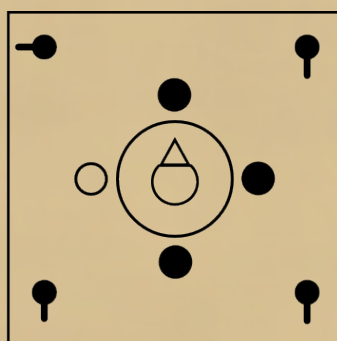


- Otočte C

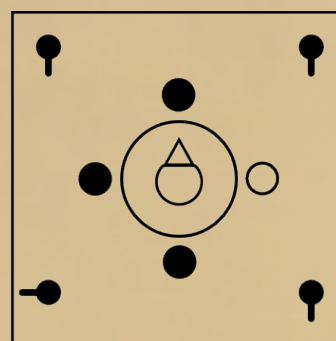


- Otočte B

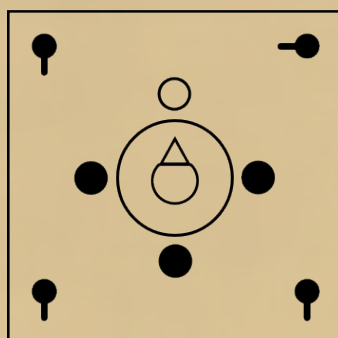


- Otočte A

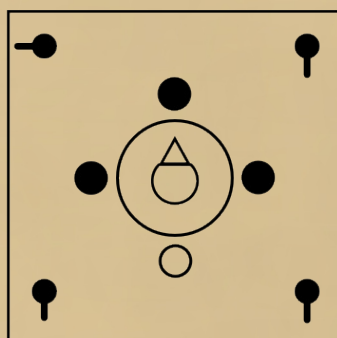


- Otočte C

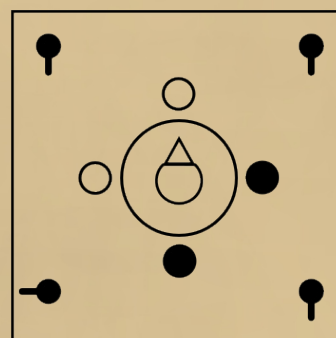

- Otočte B

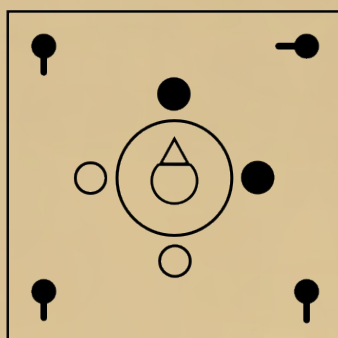


- Otočte D

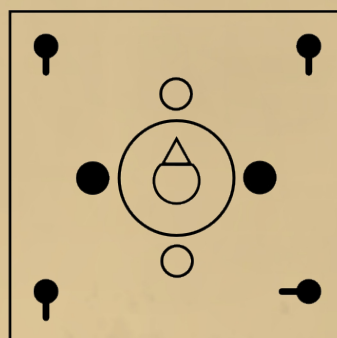

Pokyny týkající se vln

- Pořadí, ve kterém se rozsvěcují světla na třech panelech modulu, určuje pořadí, ve kterém mají být panely vyřešeny.
- Pro panel, který má být vyřešen, vyberte odpovídající část z tabulky níže podle počtu čipů umístěných ve spodní části panelu a postupujte podle pokynů.

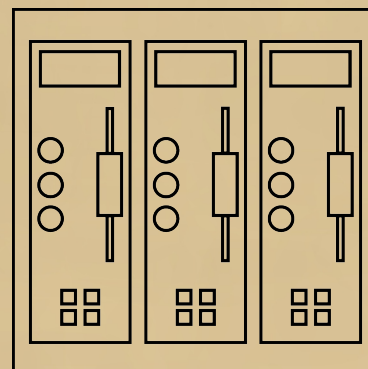

1 čip:

- Pokud je vlnová délka krátká, stiskni spodní tlačítko 1×.
- Jinak, pokud jsou alespoň 2 zdroje energie, stiskni prostřední tlačítko 3×.
- Jinak stiskni horní tlačítko 2×.

2 čipy:

- Pokud je amplituda vysoká, stiskni prostřední tlačítko 1×.
- Jinak, pokud kód obsahuje sudé číslo, stiskni horní tlačítko 1×.
- Jinak, pokud je vlnová délka dlouhá, stiskni nejprve horní tlačítko a poté ihned prostřední.
- Jinak stiskni spodní tlačítko 3×.

3 čipy:

- Pokud je priorita 1., stiskni horní tlačítko 2×.
- Jinak, pokud je vlnová délka krátká a amplituda vysoká, stiskni horní tlačítko a poté ihned spodní.
- Jinak, pokud je vlnová délka dlouhá nebo amplituda nízká, stiskni horní tlačítko 2× a poté prostřední 1×.
- Jinak stiskni všechna tlačítka odspodu nahoru.

4 čipy:

- Pokud je amplituda nízká, stiskni prostřední tlačítko 1×.
- Jinak, pokud nejsou žádné vlny, stiskni prostřední tlačítko 1× a poté spodní 2×.
- Jinak, pokud je priorita 2., stiskni všechna tlačítka shora dolů.
- Jinak stiskni spodní tlačítko 3×.


DEFORMACE

Když některé formy života v laboratoři ztratí stabilitu, způsobují deformace v okolním prostředí.

Protiopatření k problémům, které tyto deformace mohou v laboratoři způsobit, jsou uvedena níže.


Deformace

- **Podržte tlačítko, dokud se úroveň tlaku nevrátí do normálu.**

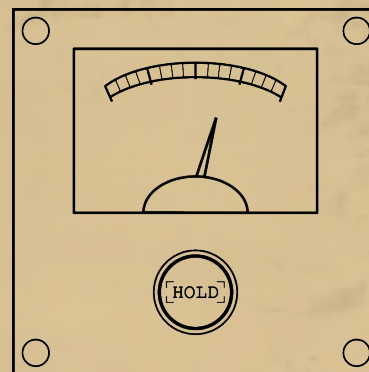


Deformace

- Stiskněte pouze blikající tlačítko, abyste stabilizovali formu života.

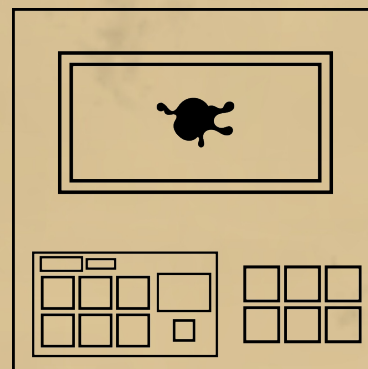


Deformace

- Zapínejte pouze ty přepínače na panelu, jejichž kontrolky blikají.

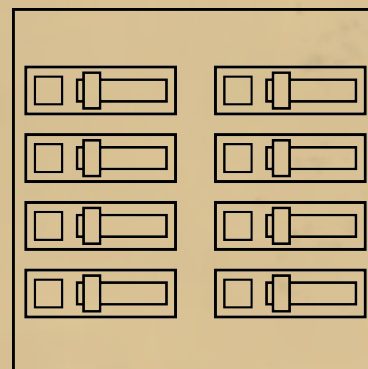


Deformace

- Vraťte vysunuté trubice zpět na jejich místo a poté spustěte boční páku, abyste je zajistili.

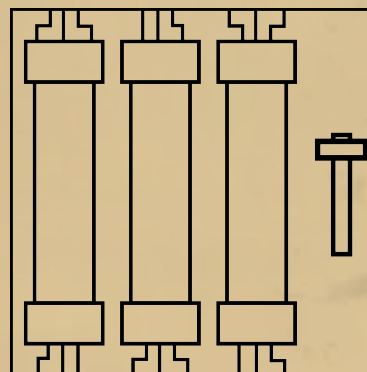

Deformace

- Zapínejte a vypínejte přepínače podle čísel na nich, abyste vyrovnali úroveň pravého měřidla s levým.

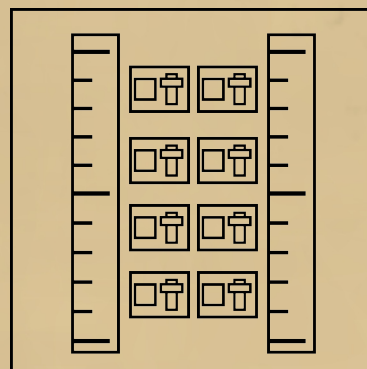

Informace o indikátorech


Indikátory RAD a BIO se nacházejí na ovládacím panelu a poskytují informace o subjektu a prostředí, ve kterém je subjekt držen.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informace o zdrojích energie

Zdroje energie napájejí ovládací panel a jejich počet se může lišit v závislosti na podmínkách zadržení subjektu. Nacházejí se ve spodní části ovládacího panelu.

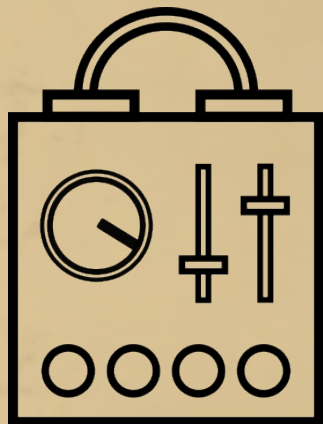

Informace o Uzavíracím kódu

Uzavírací kód je identifikátor specifický pro subjekt, přidělený každému subjektu, který slouží jako jedinečný odkaz poskytující o něm informace. Nachází se v horní části pozorovacího okna.

BZ3-D6X

Seznam samohlásek:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informace o mechanismu sebezničení

Tlačítko sebezničení se používá ke zničení jak subjektu, tak pozorovací komory, aby se zabránilo jeho úniku. Mělo by být použito pouze jako poslední možnost.

