



PODRĘCZNIK PROTOKOŁU

Ten podręcznik protokołu towarzyszy grze Keep It Contained i jest wymagany do jej prawidłowego działania.

KRYTYCZNE PROTOKOŁY BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

**Ten przewodnik będzie twoim jedynym źródłem wsparcia w utrzymywaniu
nieznanych form życia pod kontrolą, gdy próbują przekroczyć linię
kwarantanny.**

**Jesteś operatorem; odpowiednie protokoły dla każdego możliwego scenariusza
znajdziesz tutaj.**

OGÓLNE INFORMACJE O MODUŁACH

Moduły znajdują się na górze panelu sterowania. Główne cele, które musisz rozwiązać, aby powstrzymać organizmy, to moduły.

Moduły, które napotkasz, mogą się różnić na każdym poziomie i są zazwyczaj losowe.

Szczegółowe informacje o modułach znajdują się na stronach 4-9.


OGÓLNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU


Szczegóły widoczne w otoczeniu mogą wpływać na rozwiązanie modułów lub utrudniać ich rozwiązanie.

Szczegółowe informacje o środowisku znajdują się na stronach 10-13.

Zaleca się zapoznanie z nimi wcześniej, aby być przygotowanym.

Instrukcje dotyczące podłączania przewodów

- Moduł zawiera cztery przewody i cztery gniazda wejściowe.
 - Każde gniazdo wejściowe jest oznaczone symbolem.
 - Symbole są uporządkowane od lewej do prawej i muszą być opisywane w tej kolejności.
 - Kolumny poniżej wskazują kolejność priorytetu symboli.
 - Jeśli opisany symbol znajduje się na najwyższej pozycji w którejkolwiek kolumnie, należy go podłączyć do przewodu w kolorze określonym w tej kolumnie. Jeśli którykolwiek przewód jest już podłączony do symbolu, tę kolumnę należy zignorować.
- 
- The diagram shows a module with four input sockets at the top, each with a colored wire (red, blue, green, yellow) and a corresponding symbol in a box. Below the sockets is a table with four columns, each containing a symbol in a box. The symbols are: 1 (red), 4 (blue), a target symbol (green), and a square symbol (yellow). The table is used to determine the connection priority for each wire.

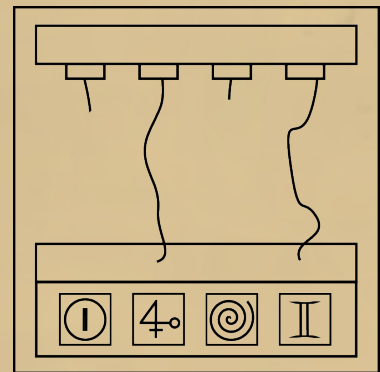


Zielony: Żółty: Niebieski: Czerwony:

①	☉	4♏	☉
4♏	☿	♊	4♏
♊	♂	♊	☉
☿	4♏	☿	4♏
♂	♋	☉	①
☉	4♏	①	♂
♋	①	♂	♊
4♏	♊	4♏	♋

Instrukcje dotyczące uwalniania gazu


- Moduł zawiera trzy kolorowe pojemniki z gazem, z których każdy jest sterowany przełącznikiem.
- Ekran w lewym górnym rogu pokazuje kolor krwi. Ekran w prawym górnym rogu pokazuje poziom czystości.
- Aby wybrać gazy do uwolnienia, należy opuścić przełączniki znajdujące się pod każdym pojemnikiem z gazem.
- Naciśnij czerwony przycisk, aby uwolnić wybrane gazy.
- Czytaj zasady po kolei i wykonaj pierwszą poprawną instrukcję.

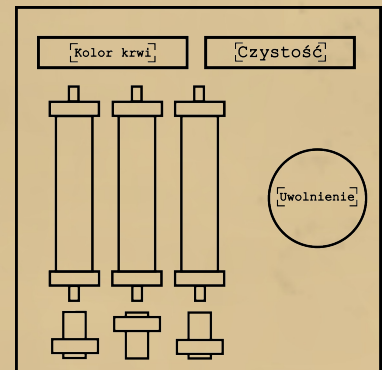

1. Jeśli kolor krwi jest zielony, a poziom czystości średni, uwolnij lewy i środkowy gaz.
2. Jeśli panel sterowania jest zasilany przez więcej niż dwa źródła zasilania, a poziom czystości jest czysty, uwolnij wszystkie gazy.
3. Jeśli kolor krwi jest czerwony i świecą się co najmniej trzy wskaźniki RAD, nie uwalniaj żadnego gazu.
4. Jeśli na panelu znajduje się tylko jedno źródło zasilania i żadne wskaźniki BIO nie są aktywne, uwolnij tylko środkowy gaz.
5. Jeśli kolor krwi jest żółty lub poziom czystości jest niski, uwolnij lewy i prawy gaz.
6. Jeśli poziom czystości wynosi zero i świecą się tylko dwa wskaźniki RAD, uwolnij tylko lewy gaz.
7. Jeśli kolor krwi jest niebieski, a poziom czystości wysoki, uwolnij środkowy i prawy gaz.
8. Jeśli żaden z powyższych warunków nie ma zastosowania, uwolnij tylko prawy gaz.


Instrukcje dotyczące anomalii

1. Spójrz na symbol pojawiający się na ekranie i postępuj zgodnie z instrukcjami z Kroku 1.
2. Korzystając z zebranych informacji, wykonaj instrukcje z Kroku 2, aby określić, jaka to anomalia.

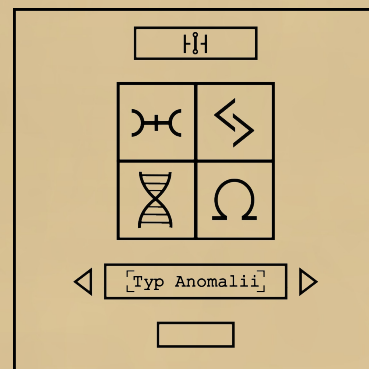

Krok 1:

- Symbol na ekranie reprezentuje kolumnę, w której się znajduje.
- Spośród czterech symboli pokazanych technikowi naciśnij przycisk z symbolem, który nie należy do tej kolumny.
- Powtarzaj ten proces tyle razy, ile potrzeba, a następnie przejdź do Kroku 2.

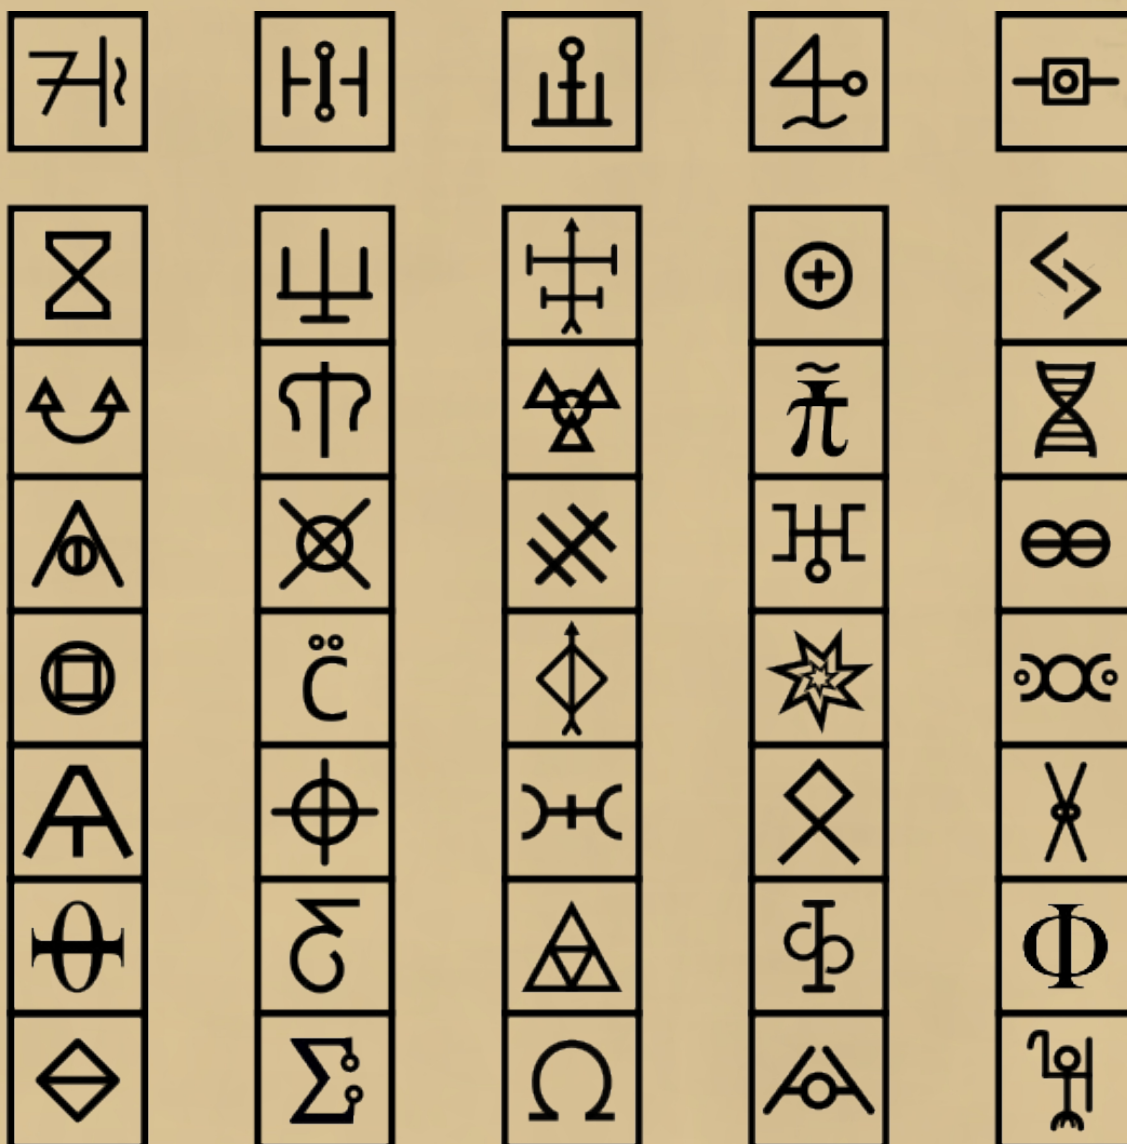

Krok 2:


- Identify the anomaly based on the group that contains all three of the pressed symbols, then enter it on the module's display and submit it.

Typy Anomalii:

Leach




Mycrotide

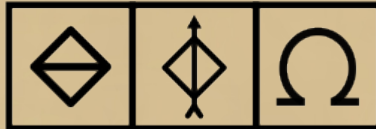

Crack



Loop

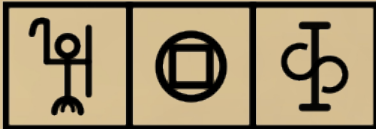

Phase



Skin



Breach



Worm



Stink



Glitch



Time




Unknown




Instrukcje dotyczące pól siłowych


- Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami w zależności od koloru kabla.
- Jeśli nie ma kabla do przecięcia, przetnij najniżej położony kabel.

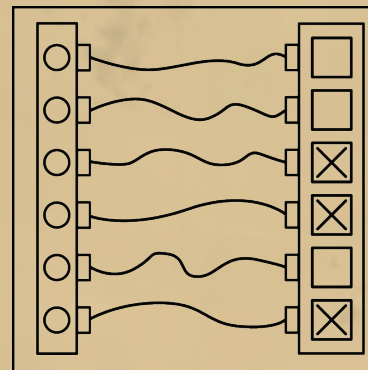


Czerwony kabel:

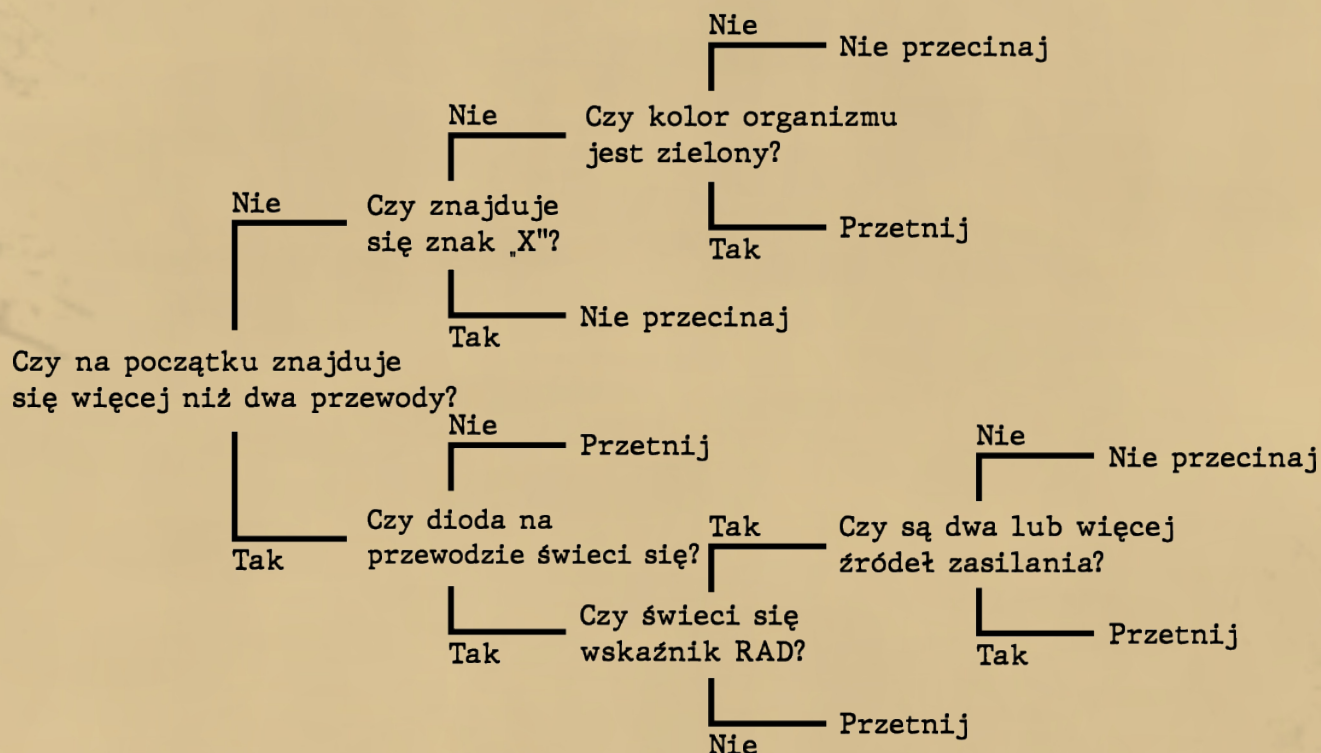

Niebieski kabel:

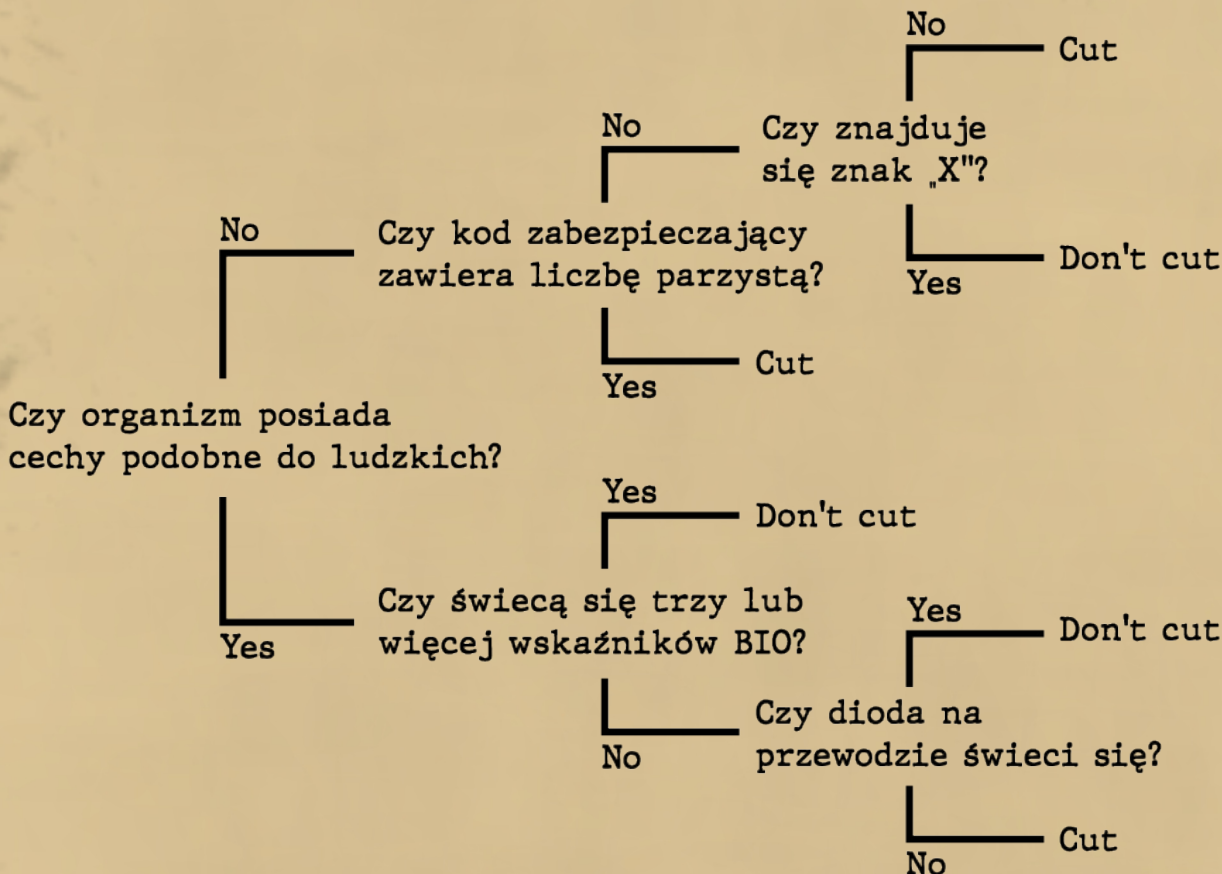


Żółty kabel:

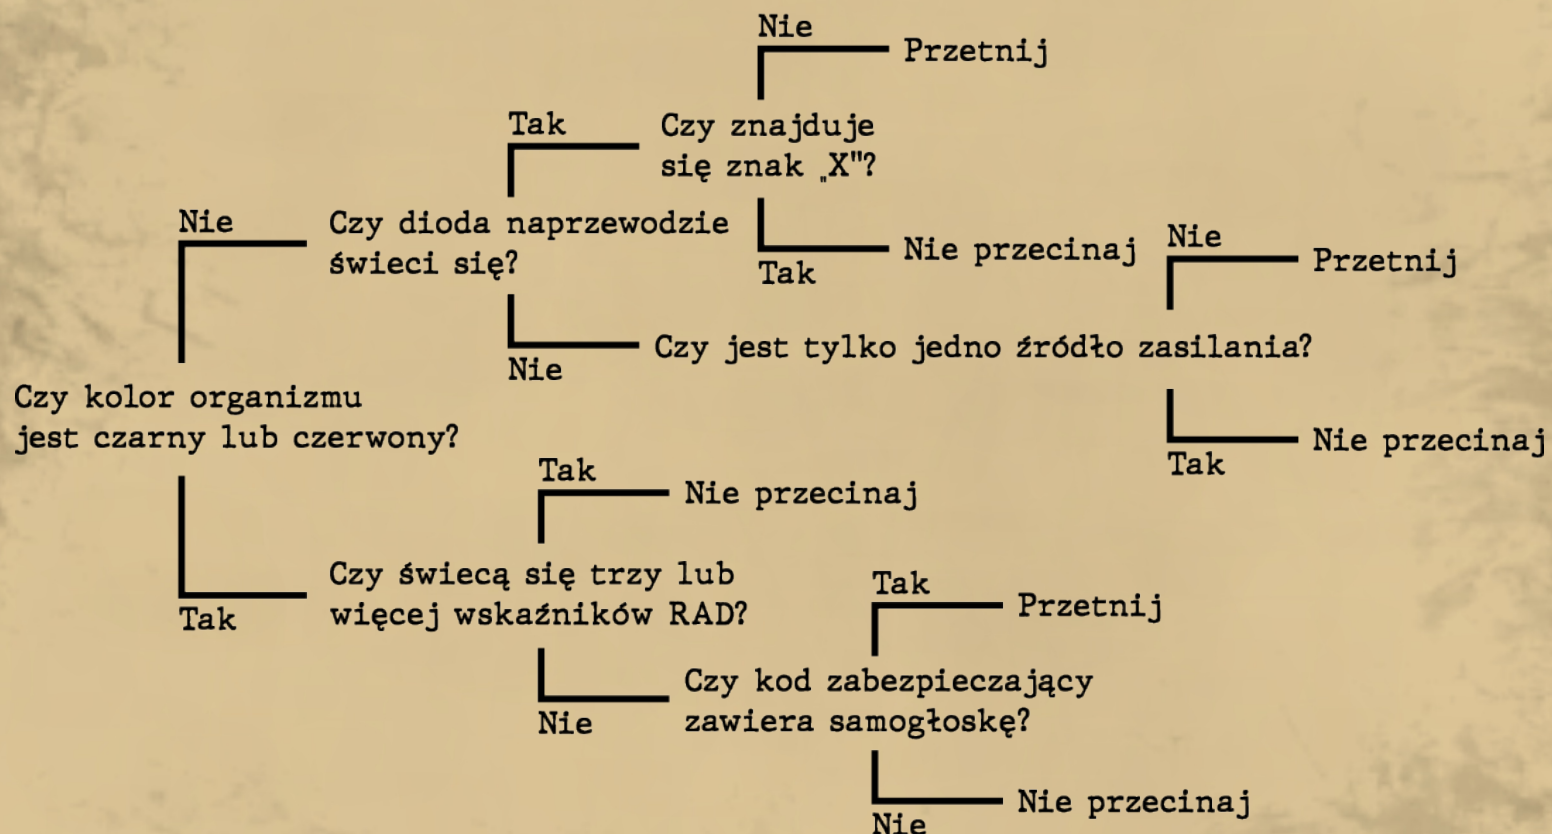

Instrukcje dotyczące warunków

- Użyj informacji ze wskaźników ciśnienia i temperatury na module, aby ustawić suwaki we właściwych pozycjach.
- Jeśli suwak osiągnie samą górę lub dół, kontynuuj liczenie od przeciwnego końca.
- Przesuwaj każdy suwak ostrożnie, ponieważ ciśnienie i temperatura będą się zmieniać i nie wolno go pozostawić w niewłaściwej pozycji.

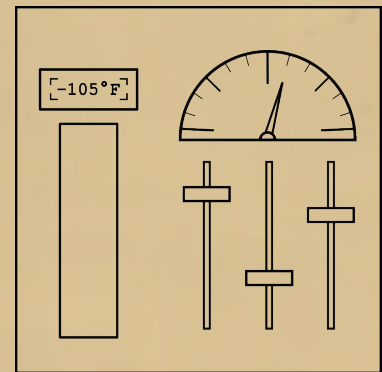

	Jeśli temperatura wynosi od 150°F do 75°F	Jeśli temperatura wynosi od 75°F do 0°F	Jeśli temperatura wynosi od 0°F do -75°F	Jeśli temperatura wynosi od -75°F do -150°F
Jeśli ciśnienie wynosi od 0 do 45 PSI	Dostosuj 2. suwak o +4 pozycję.	Dostosuj 1. suwak o -3 pozycję.	Dostosuj 3. suwak o +7 pozycję.	Dostosuj 2. suwak o -9 pozycję.
Jeśli ciśnienie wynosi od 45 do 90 PSI	Dostosuj 1. suwak o +1 pozycję.	Dostosuj 3. suwak o -5 pozycję.	Dostosuj 2. suwak o +8 pozycję.	Dostosuj 1. suwak o +6 pozycję.
Jeśli ciśnienie wynosi od 90 do 135 PSI	Dostosuj 3. suwak o -2 pozycję.	Dostosuj 2. suwak o -1 pozycję.	Dostosuj 1. suwak o -7 pozycję.	Dostosuj 3. suwak o +9 pozycję.
Jeśli ciśnienie wynosi od 135 do 180 PSI	Dostosuj 2. suwak o +2 pozycję.	Dostosuj 1. suwak o -9 pozycję.	Dostosuj 3. suwak o +3 pozycję.	Dostosuj 2. suwak o -6 pozycję.


Instrukcje dotyczące sekwencji DNA

1. Wybierz odpowiednią tabelę na podstawie koloru DNA.

2. Naciśnij przycisk odpowiadający zasadzie, która miga na ekranie.

3. Przy każdym poprawnym naciśnięciu pojawi się nowa zasada i zostanie dodana po poprzednio wprowadzonej, tworząc sekwencję.

4. Za każdym razem, gdy dodana zostanie nowa zasada, sekwencję należy wprowadzić ponownie od początku, aż moduł zostanie ukończony.

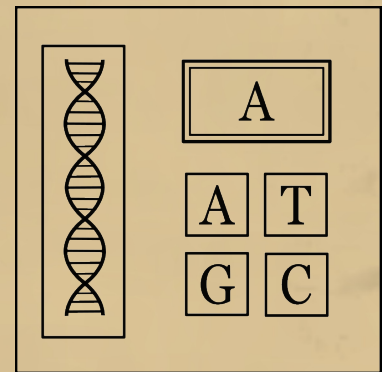

Czerwone DNA:

Jeśli kod pieczęci zawiera samogłoskę:

Jeśli kod pieczęci nie zawiera samogłoski:

Zasada A	Zasada G	Zasada T	Zasada C
G	A	C	T
C	G	A	T

Żółte DNA:

Jeśli kod pieczęci zawiera liczbę parzystą:

Jeśli kod pieczęci nie zawiera liczby parzystej:

Zasada A	Zasada G	Zasada T	Zasada C
A	C	G	T
T	A	C	G

Niebieskie DNA:

Jeśli suma liczb w kodzie pieczęci jest parzysta:

Jeśli suma liczb w kodzie pieczęci jest nieparzysta:

Zasada A	Zasada G	Zasada T	Zasada C
A	G	T	C
G	A	T	C

Fioletowe DNA:



Jeśli ostatnia litera kodu pieczęci jest samogłoską:

Jeśli ostatnia litera kodu pieczęci jest spółgłoską:

Zasada A	Zasada G	Zasada T	Zasada C
T	C	G	A
C	T	A	G


Instrukcje klawiatury

- Dopasuj świecące przyciski do czarnych pól, aby znaleźć właściwą klawiaturę.
- Naciśnij przyciski oznaczone „X”.
- Powtarzaj, aż moduł zostanie ukończony.

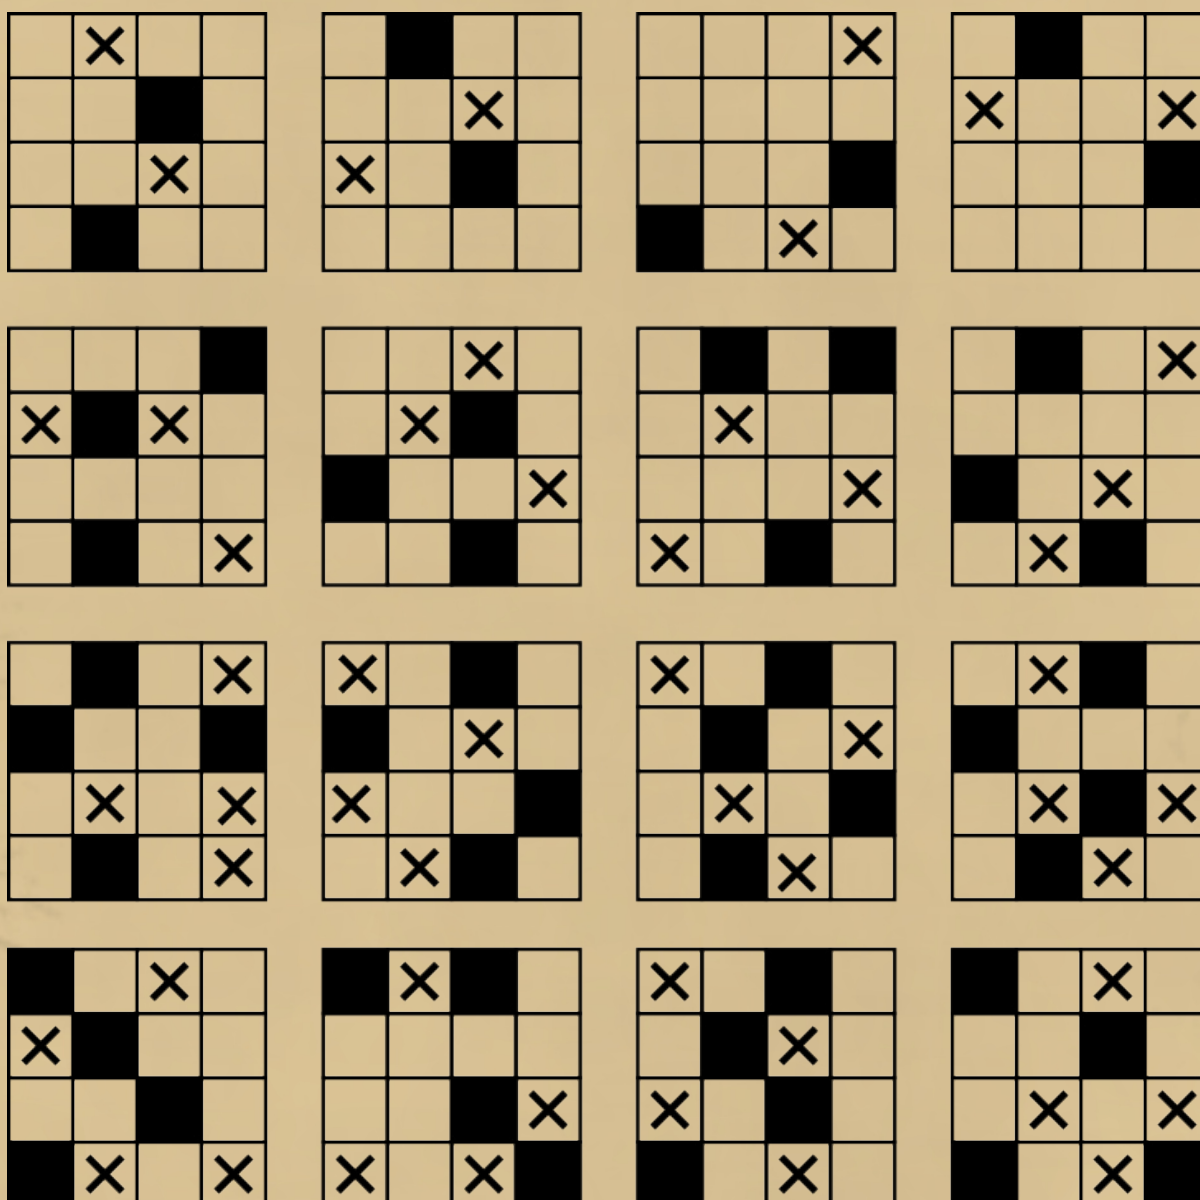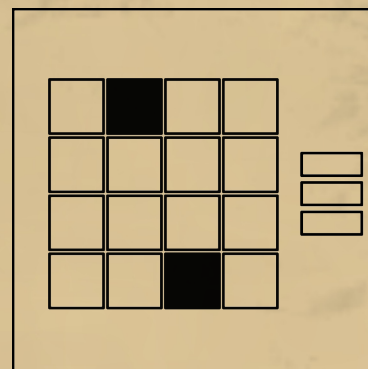


Instrukcje dotyczące kompasu


- Pozycja świateł wokół kompasu wskazuje, który z 4 przełączników należy obrócić.
- Pozycje świateł są określone na podstawie kierunku, w którym zwrócony jest kompas.
- Gdy wszystkie przełączniki zostaną obrócone, moduł zostaje ukończony.

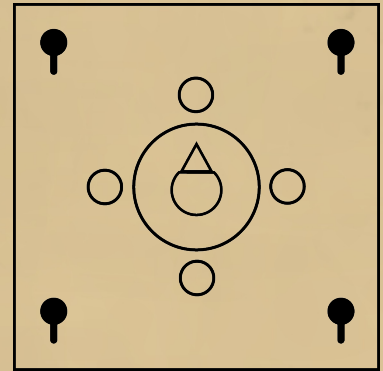


- Kolejność kodowania przełączników:




- Obróć D

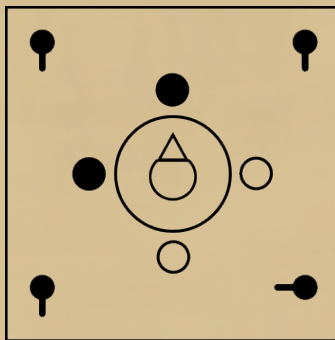


- Obróć A

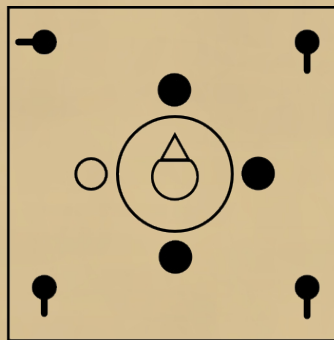


- Obróć C

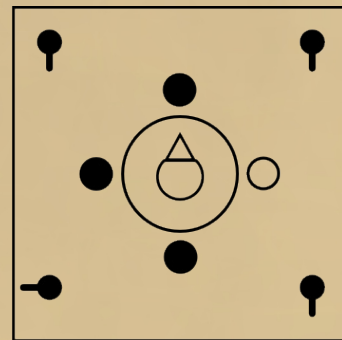


- Obróć B

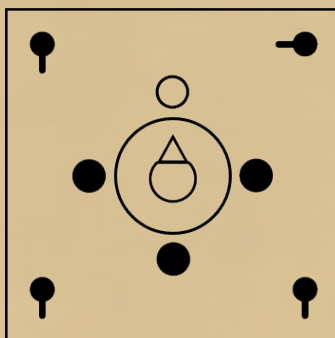


- Obróć A

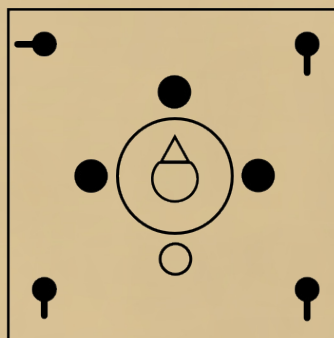


- Obróć C

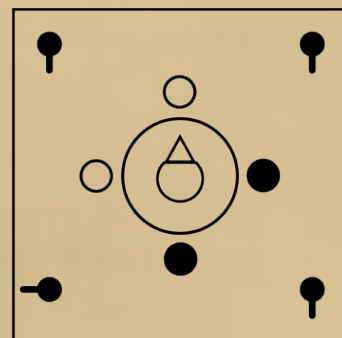

- Obróć B

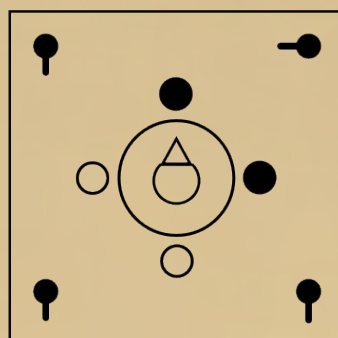


- Obróć D

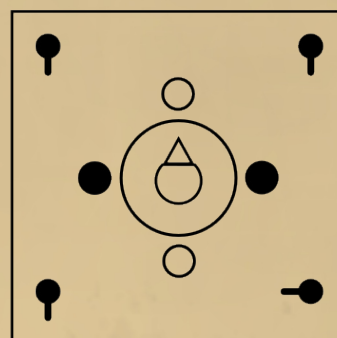

Instrukcje dotyczące fal

• Kolejność, w jakiej zapalają się światła na trzech panelach modułu, określa kolejność rozwiązywania paneli.

• Dla panelu, który należy rozwiązać, wybierz odpowiednią sekcję z poniższej tabeli w zależności od liczby chipów znajdujących się na dole panelu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

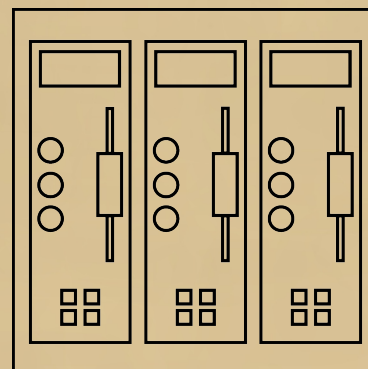

1 chip:

- Jeśli długość fali jest krótka, naciśnij dolny przycisk 1 raz.
- W przeciwnym razie, jeśli są co najmniej 2 źródła zasilania, naciśnij środkowy przycisk 3 razy.
- W przeciwnym razie naciśnij górny przycisk 2 razy.

2 chipy:

- Jeśli amplituda jest wysoka, naciśnij środkowy przycisk 1 raz.
- W przeciwnym razie, jeśli kod zawiera liczbę parzystą, naciśnij górny przycisk 1 raz.
- W przeciwnym razie, jeśli długość fali jest długa, naciśnij najpierw górny przycisk, a następnie od razu środkowy.
- W przeciwnym razie naciśnij dolny przycisk 3 razy.

3 chipy:

- Jeśli priorytet rozwiązania panelu jest 1., naciśnij górny przycisk 2 razy.
- W przeciwnym razie, jeśli długość fali jest krótka i amplituda wysoka, naciśnij najpierw górny, a potem dolny przycisk.
- W przeciwnym razie, jeśli długość fali jest długa lub amplituda niska, naciśnij górny przycisk 2 razy, a następnie środkowy 1 raz.
- W przeciwnym razie naciśnij wszystkie przyciski od dołu do góry.

4 chipy:

- Jeśli amplituda jest niska, naciśnij środkowy przycisk 1 raz.
- W przeciwnym razie, jeśli nie ma fal, naciśnij środkowy przycisk 1 raz, a potem dolny 2 razy.
- W przeciwnym razie, jeśli priorytet jest 2., naciśnij wszystkie przyciski od góry do dołu.
- W przeciwnym razie naciśnij dolny przycisk 3 razy.


ZNIEKSZTAŁCENIA

Gdy niektóre formy życia w laboratorium tracą stabilność, wywołują zniekształcenia w otaczającym środowisku.

Środki zaradcze wobec problemów, które te zniekształcenia mogą powodować w laboratorium, są wymienione poniżej.


Zniekształcenia

- Przytrzymaj przycisk, aż poziom ciśnienia wróci do normy.

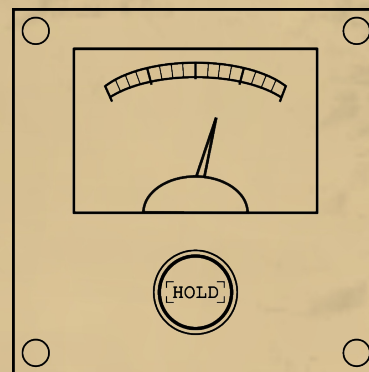


Zniekształcenia

- Naciśnij tylko migający przycisk, aby ustabilizować formę życia.

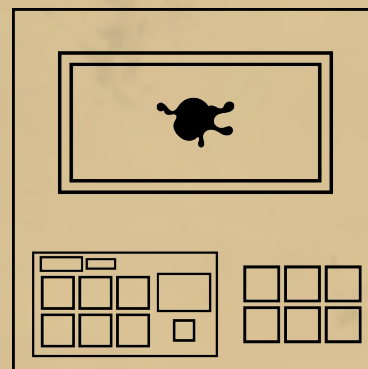


Zniekształcenia

- Włącz tylko te przełączniki na panelu, których kontrolki migają.

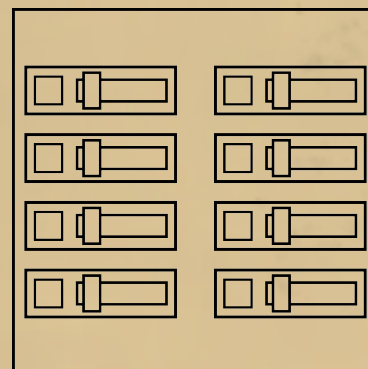


Zniekształcenia

- Umieść wyrzucone rury z powrotem na swoich miejscach, a następnie opuść boczną dźwignię, aby je zabezpieczyć.

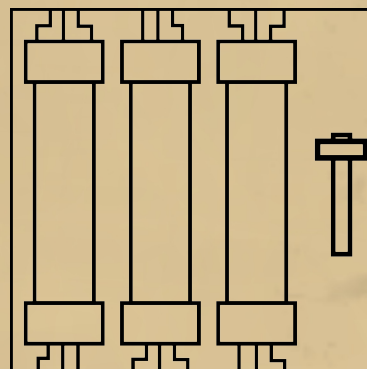

Zniekształcenia

- Włączaj i wyłączaj przełączniki zgodnie z liczbami na nich, aby wyrównać poziom prawego wskaźnika z lewym.

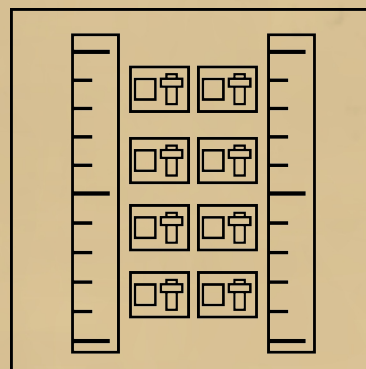

Informacje o wskaźnikach


Wskaźniki RAD i BIO znajdują się na panelu sterowania i dostarczają informacji o obiekcie oraz środowisku, w którym jest on przechowywany.

RAD

BIO

Informacje o źródłach zasilania

Źródła zasilania dostarczają energię do panelu sterowania, a ich liczba może się różnić w zależności od warunków przechowywania obiektu. Znajdują się one na dole panelu sterowania.

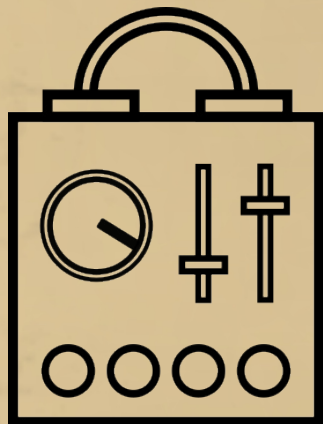

Informacje o kodzie zabezpieczającym

Kod zabezpieczający jest identyfikatorem przypisanym do każdego obiektu i stanowi unikalne odniesienie zawierające informacje o nim. Znajduje się on na górze okna obserwacyjnego.

BZ3-D6X

Lista samogłosek:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informacje o mechanizmie autodestrukcji

Przycisk autodestrukcji służy do zniszczenia zarówno obiektu, jak i komory obserwacyjnej, aby zapobiec ucieczce obiektu. Powinien być używany wyłącznie jako ostateczność.

