

# KEEP IT CONTAINED

## プロトコルマニュアル

このプロトコルマニュアルはゲーム「Keep It Contained」に付属しており、正しい操作のために必須です。

## 重要生物安全プロトコル

このガイドは、未知の生命体が隔離ラインを越えようとした際に、それらを制御するための唯一の支援資料です。

あなたはオペレーターです。遭遇する可能性のあるあらゆる状況への対応手順は、すべてここに文書化されています。

## モジュールに関する一般情報

モジュールは制御パネルの最上部に配置されています。封じ込めるために解決しなければならない主な目標が、これらのモジュールです。

遭遇するモジュールはレベルごとに異なる場合がありますが、基本的にはランダムです。

モジュールの詳細情報は 4～9 ページに記載されています。

## 環境に関する一般情報


環境内で確認できる要素は、モジュールの解決に影響を与えたり、難易度を上げたりする可能性があります。

環境の詳細情報は 10～13 ページに記載されています。

事前に読んでおくことが推奨されます。

## 配線接続に関する指示

- このモジュールには4本のワイヤーと4つの入力スロットがあります。
- 各入力スロットにはシンボルが表示されています。
- シンボルは左から右の順に並んでおり、その順番で記述する必要があります。
- 下の列はシンボルの優先順位を示しています。
- 記述されたシンボルがいずれかの列で最上位にある場合、その列で指定された色のワイヤーに接続しなければなりません。
- すでにワイヤーが接続されている場合、その列は無視します。

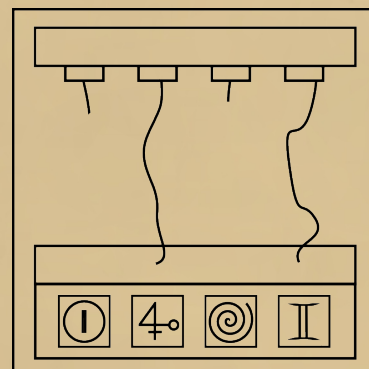

緑：

|     |
|-----|
| ①   |
| ♀   |
| Ⅱ   |
| ☹   |
| ⋅Ⅰ⋅ |
| ☺   |
| ⧻   |
| ♀   |

黄：

|     |
|-----|
| ☺   |
| ☹   |
| ⋅Ⅰ⋅ |
| ♀   |
| ⧻   |
| ♀   |
| ①   |
| Ⅱ   |

青：

|     |
|-----|
| ♀   |
| Ⅱ   |
| ☹   |
| ⧻   |
| ☺   |
| ①   |
| ⋅Ⅰ⋅ |
| ♀   |


赤：

|     |
|-----|
| ☹   |
| ♀   |
| ☺   |
| ♀   |
| ①   |
| ⋅Ⅰ⋅ |
| Ⅱ   |
| ⧻   |



## ガス放出に関する指示


- このモジュールには3つの色付きガス容器があり、それぞれスイッチで制御されています。
- 左上の画面は血液の色を表示します。右上の画面は純度レベルを表示します。
- 放出するガスを選択するには、各ガス容器の下にあるスイッチを下げます。
- 赤いボタンを押して、選択したガスを放出します。
- ルールを上から順に読み、最初に有効な指示を実行してください。

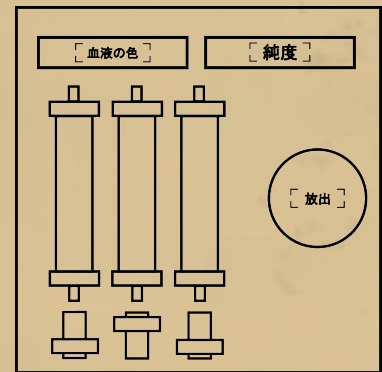

1. I 血液の色が緑色で純度レベルが中程度の場合、左側と中央のガスを放出する。
2. 制御パネルが3つ以上の電源で稼働しており、純度レベルが「純」の場合、すべてのガスを放出します。
3. 血液の色が赤で、RAD インジケーターが3つ以上点灯している場合、ガスは一切放出しません。
4. パネルに電源が1つしかなく、BIO インジケーターが一つも点灯していない場合、中央のガスのみを放出します。
5. 血液の色が黄色、または純度レベルが低の場合、左と右のガスを放出します。
6. 純度レベルがゼロで、RAD インジケーターが2つだけ点灯している場合、左のガスのみを放出します。
7. 血液の色が青で、純度レベルが高の場合、中央と右のガスを放出します。
8. 上記のいずれの条件にも当てはまらない場合、右のガスのみを放出します。


## 異常体に関する指示

1. 画面に表示されているシンボルを確認し、ステップ1の指示に従ってください。
2. 収集した情報をもとに、ステップ2の指示に従って異常体を特定してください。

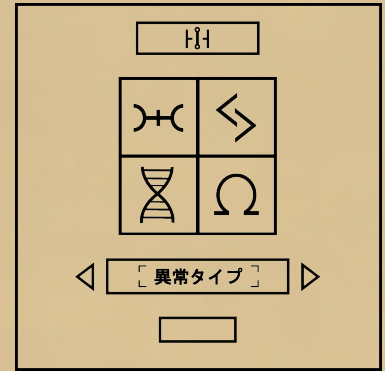

## ステップ 1:

- 画面上のシンボルは、それが属する列を示しています。
- 技術者に表示されている 4 つのシンボルの中から、その列に属さないシンボルのボタンを押してください。
- この作業を必要な回数だけ繰り返し、その後ステップ 2 に進んでください。

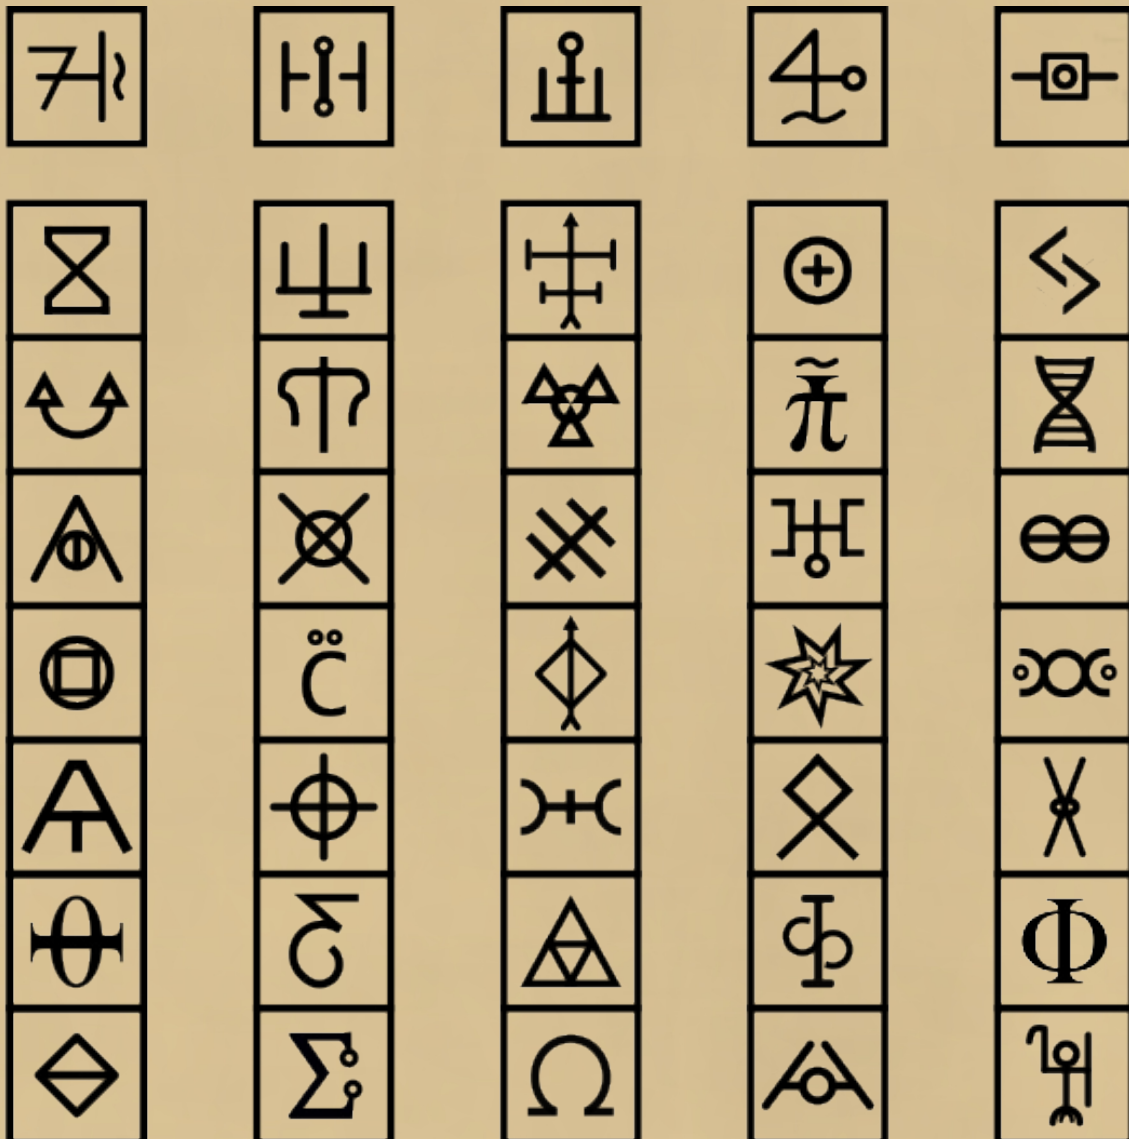

## ステップ 2:


- 押された 3 つすべてのシンボルを含むグループに基づいて異常体を特定し、モジュールの表示に入力して送信してください。

### 異常タイプ :

Leach



Mycrotide

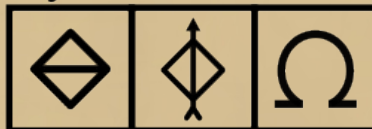

Crack



Loop



Phase



Skin



Breach




Worm



Stink



Glitch

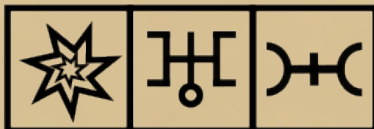

Time




Unknown






## フォースフィールドに関する指示

- ケーブルの色に応じて、以下の指示に従ってください。
- 切断するケーブルが存在しない場合、一番下のケーブルを切断してください。

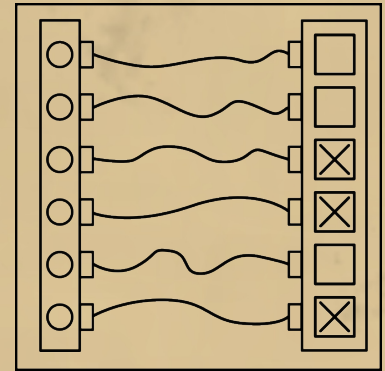


### 赤いケーブル：

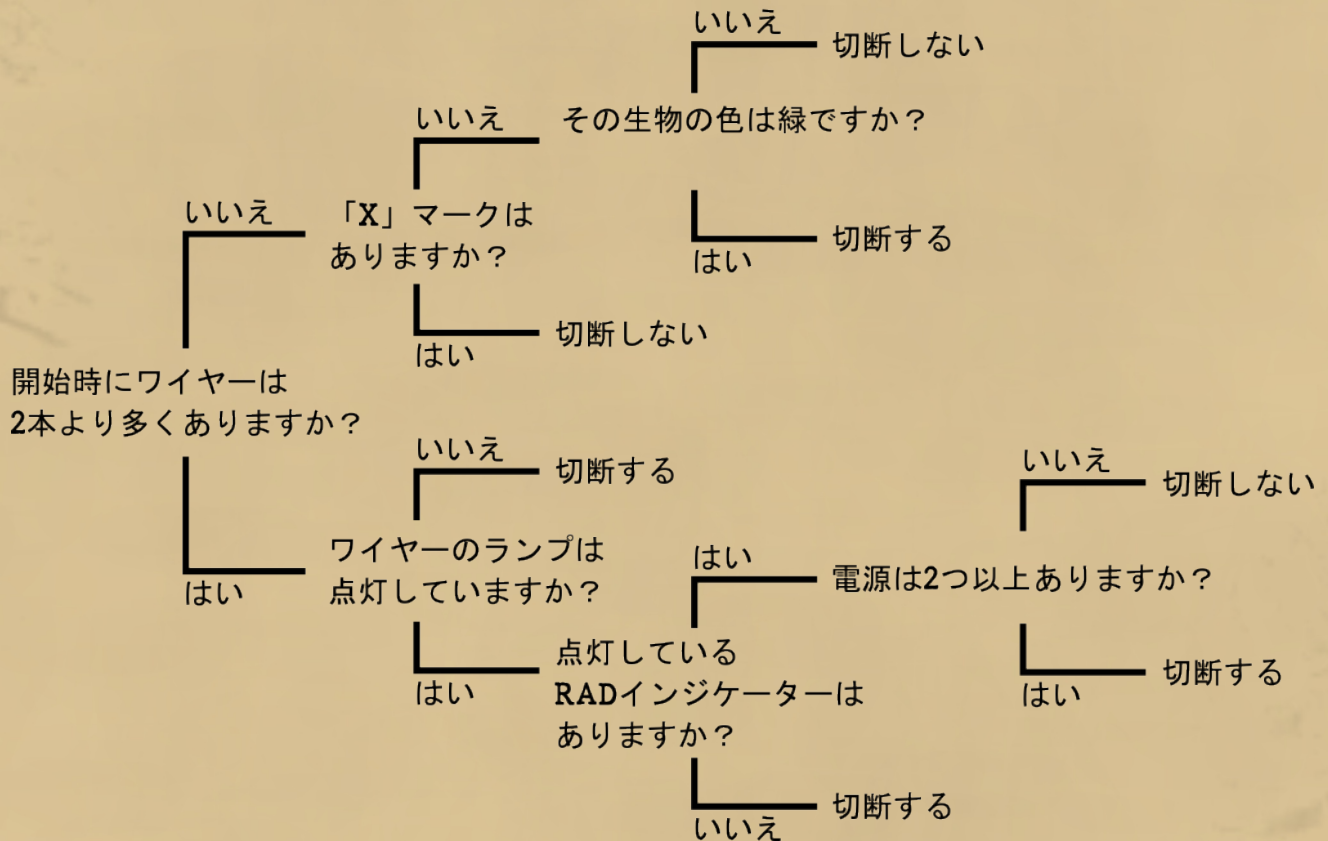




## 青いケーブル：

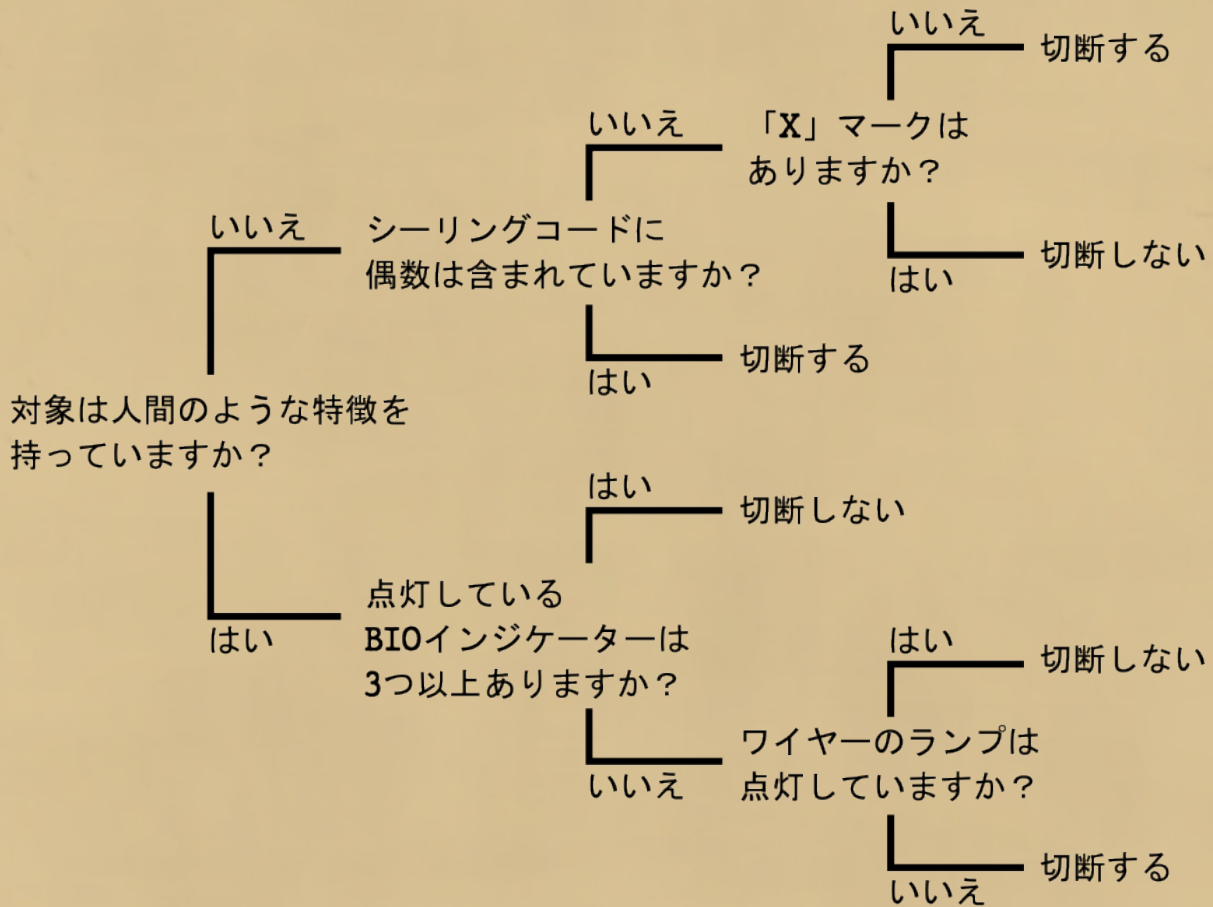


## 黄色いケーブル：

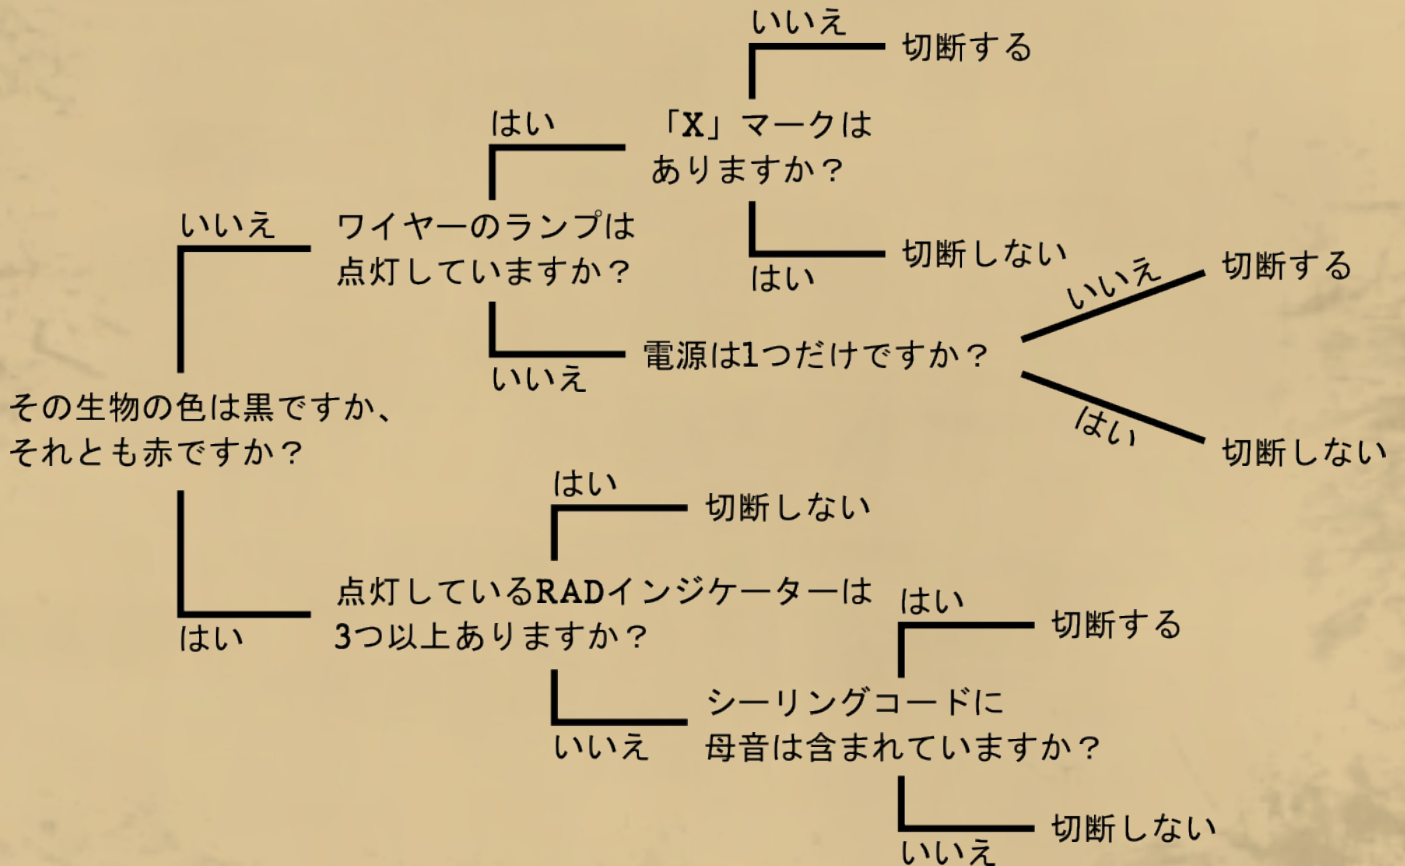

条件に関する指示


- モジュール上の圧力および温度インジケータの情報をを使用して、スライダーを正しい位置に移動してください。
- スライダーが一番上または一番下に達した場合は、反対側から数え続けてください。
- 圧力と温度が変化するため、スライダーは慎重に動かし、誤った位置で離さないようにしてください。

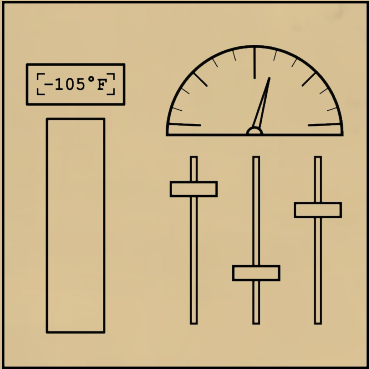

|                     | 温度が150°F~75°Fの間の場合 | 温度が75°F~0°Fの間の場合  | 温度が0°F~-75°Fの間の場合 | 温度が-75°F~-150°Fの間の場合 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 圧力が0~45 PSIの間の場合    | 第2スライダーを+4位置調整する。  | 第1スライダーを-3位置調整する。 | 第3スライダーを+7位置調整する。 | 第2スライダーを-9位置調整する。    |
| 圧力が45~90 PSIの間の場合   | 第1スライダーを+1位置調整する。  | 第3スライダーを-5位置調整する。 | 第2スライダーを+8位置調整する。 | 第1スライダーを+6位置調整する。    |
| 圧力が90~135 PSIの間の場合  | 第3スライダーを-2位置調整する。  | 第2スライダーを-1位置調整する。 | 第1スライダーを-7位置調整する。 | 第3スライダーを+9位置調整する。    |
| 圧力が135~180 PSIの間の場合 | 第2スライダーを+2位置調整する。  | 第1スライダーを-9位置調整する。 | 第3スライダーを+3位置調整する。 | 第2スライダーを-6位置調整する。    |

## DNA 配列に関する指示

1. DNA の色に基づいて正しい表を選択してください。
2. 画面上で点滅している塩基に対応するボタンを押してください。
3. 正しく押すたびに新しい塩基が表示され、以前に入力された塩基の後に追加されて配列が形成されます。
4. 新しい塩基が追加されるたびに、モジュールが完了するまで配列を最初から再入力する必要があります。

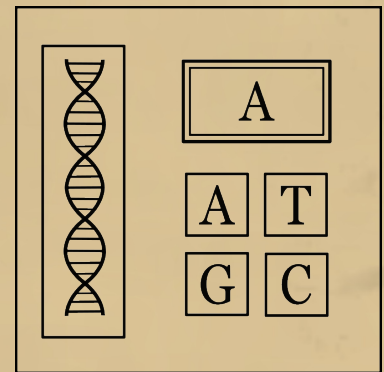

赤いDNA :

シーリングコードに母音が含まれている場合 :

シーリングコードに母音が含まれていない場合 :

| A塩基 | G塩基 | T塩基 | C塩基 |
|-----|-----|-----|-----|
| G   | A   | C   | T   |
| C   | G   | A   | T   |

黄色のDNA :

シーリングコードに偶数が含まれている場合 :

シーリングコードに偶数が含まれていない場合 :

| A塩基 | G塩基 | T塩基 | C塩基 |
|-----|-----|-----|-----|
| A   | C   | G   | T   |
| T   | A   | C   | G   |

青いDNA :

シーリングコード内の数字の合計が偶数の場合 :

シーリングコード内の数字の合計が奇数の場合 :

| A塩基 | G塩基 | T塩基 | C塩基 |
|-----|-----|-----|-----|
| A   | G   | T   | C   |
| G   | A   | T   | C   |

紫のDNA :

シーリングコードの最後の文字が母音の場合 :



シーリングコードの最後の文字が子音の場合 :

| A塩基 | G塩基 | T塩基 | C塩基 |
|-----|-----|-----|-----|
| T   | C   | G   | A   |
| C   | T   | A   | G   |




## キーパッドの指示

- 正しいキーパッドを見つけるために、光っているボタンを黒いボックスと一致させてください。
- 「X」とマークされたボタンを押してください。
- モジュールが完了するまで繰り返してください。

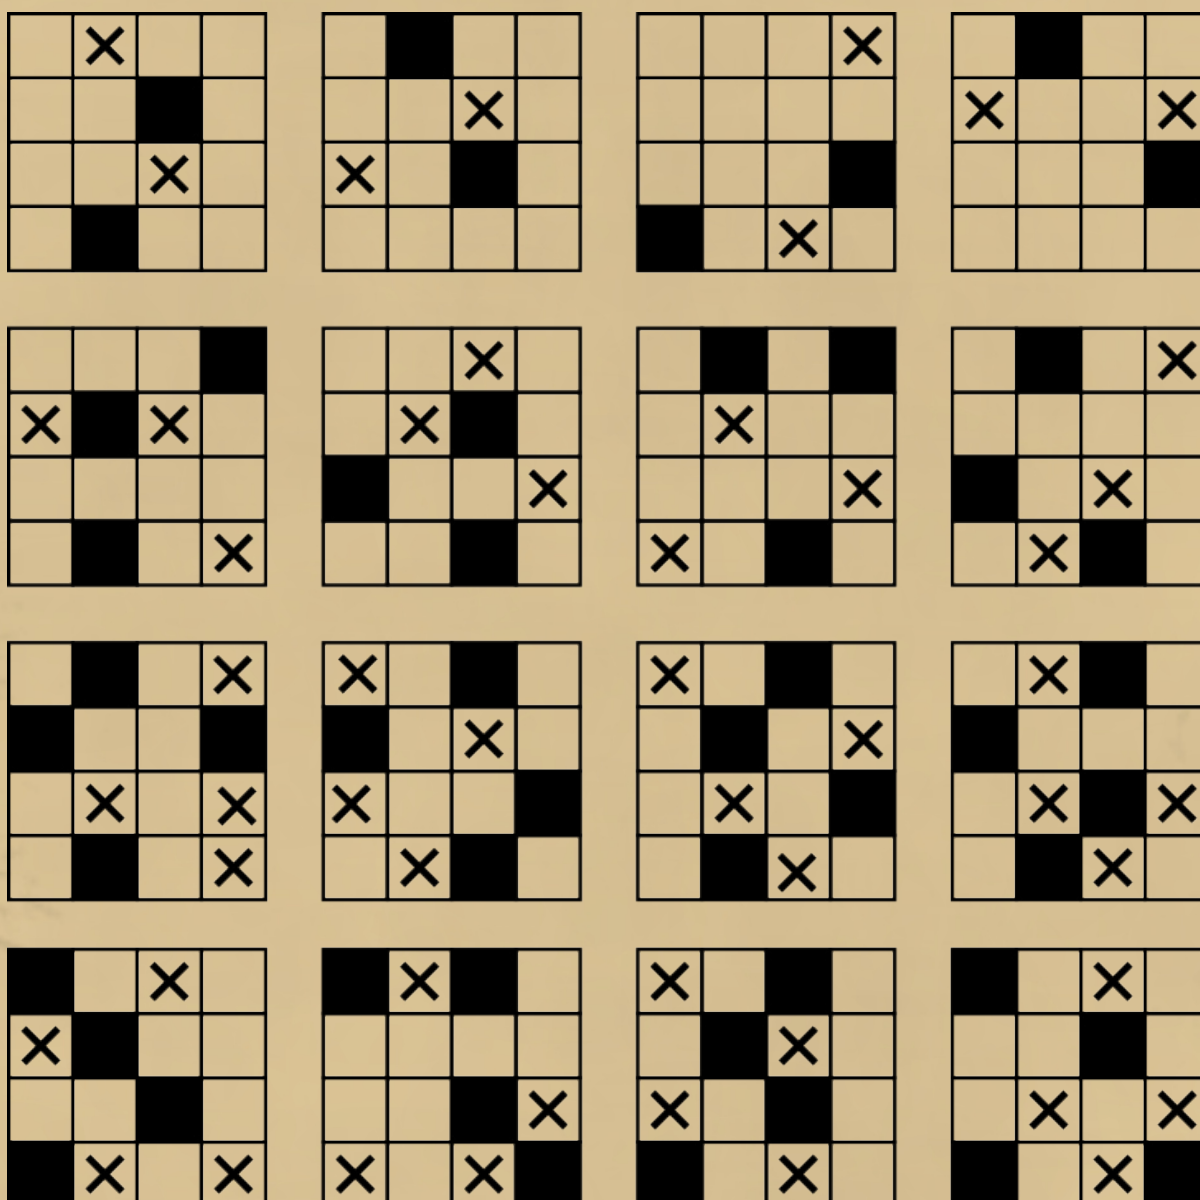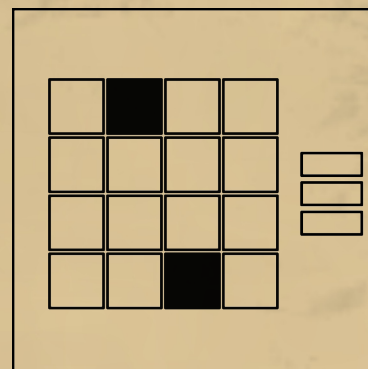


## コンパスの説明


- コンパスの周りには、4つのスイッチのうちどれを回すべきかを示します。
- ライトの位置は、コンパスが向いている方向に基づいて決まります。
- すべてのスイッチを回すと、モジュールは完了します。

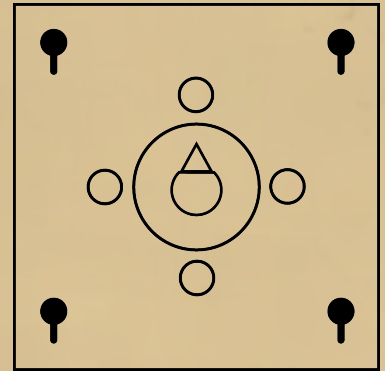


- スwitchのコード順序：




- Dを回す

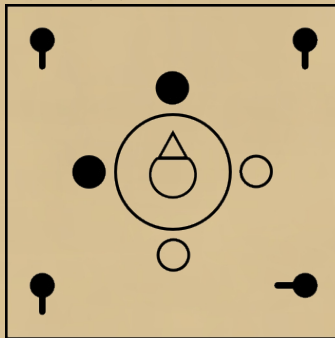


- Aを回す

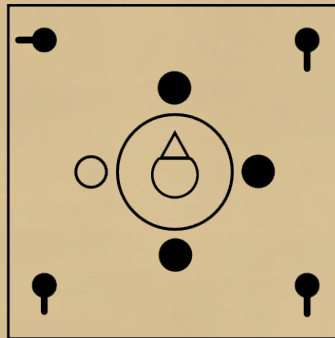


- Cを回す

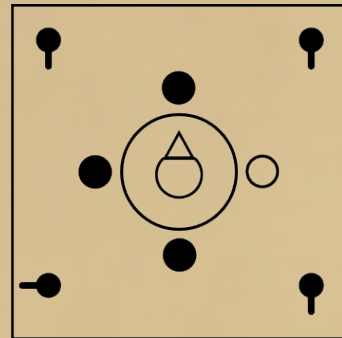


- Bを回す

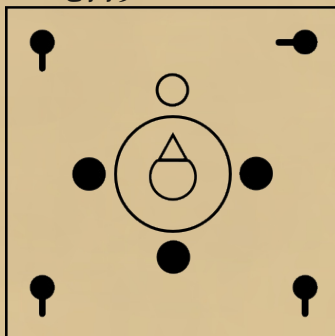


- Aを回す

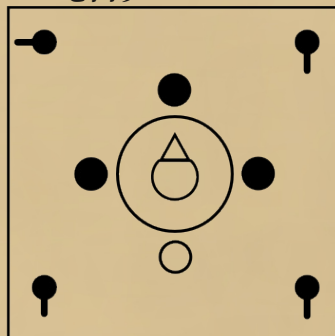


- Cを回す

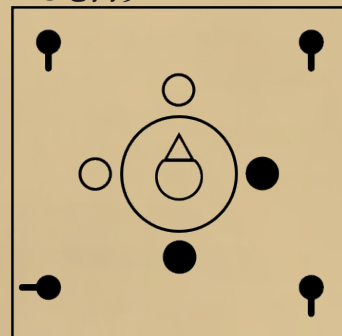

- Bを回す

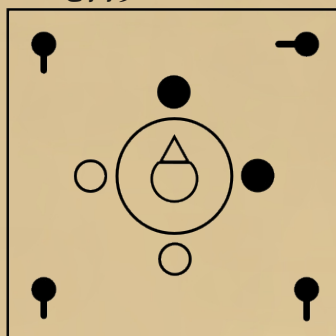


- Dを回す

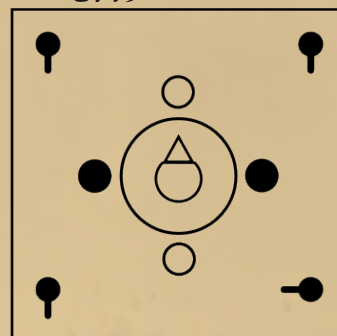

## 波に関する指示

- モジュール上の3つのパネルのライトが点灯する順番が、パネルを解く順番を決定します。
- 解くべきパネルについては、そのパネルの下部にあるチップの数に応じて、下の表から適切な項目を選び、指示に従ってください。

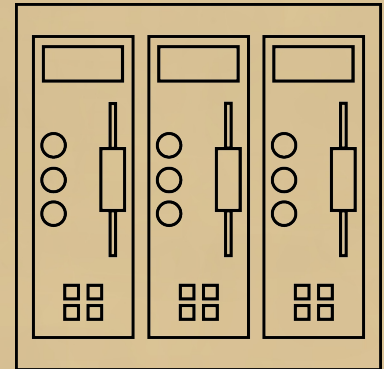

### 1チップ:

- 波長が短い場合、下のボタンを1回押す。
- それ以外で、電源が2つ以上ある場合、中のボタンを3回押す。
- それ以外の場合、上のボタンを2回押す。

### 2チップ:

- 振幅が高い場合、中のボタンを1回押す。
- それ以外で、コードに偶数が含まれている場合、上のボタンを1回押す。
- それ以外で、波長が長い場合、上のボタンを押してすぐ中のボタンを押す。
- それ以外の場合、下のボタンを3回押す。

### 3チップ:

- 優先順位が1位の場合、上のボタンを2回押す。
- それ以外で、波長が短く振幅が高い場合、上のボタンを押してすぐ下のボタンを押す。
- それ以外で、波長が長い、または振幅が低い場合、上のボタンを2回押してから中のボタンを1回押す。
- それ以外の場合、下から上へすべてのボタンを押す。

### 4チップ:

- 振幅が低い場合、中のボタンを1回押す。
- それ以外で、波がない場合、中のボタンを1回押してから下のボタンを2回押す。
- それ以外で、優先順位が2位の場合、上から下へすべてのボタンを押す。
- それ以外の場合、下のボタンを3回押す。




## 歪み

研究所内の特定の生命体が安定性を失うと、周囲の環境に歪みが発生します。

これらの歪みによって研究所内で発生する可能性のある問題への対策は、以下に示されています。


## 歪み

- 圧力レベルが正常に戻るまでボタンを押し続けてください。

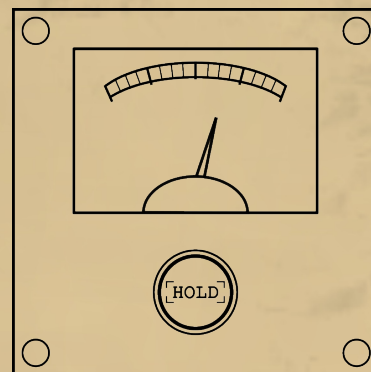

## 歪み


- 生命体を安定させるために、点滅しているボタンのみを押してください。

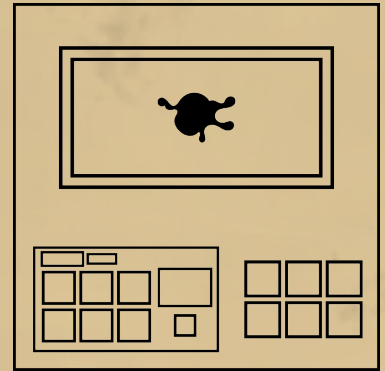




## 歪み

- パネル上でライトが点滅しているスイッチのみをオンにしてください。

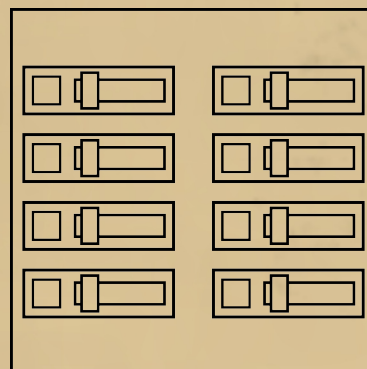


## 歪み

- 飛び出したチューブを元の位置に戻し、側面のレバーを下げて固定してください。

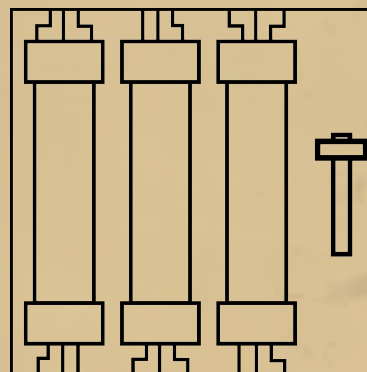

## 歪み

- スイッチの数字に従ってオン・オフを切り替え、右側のメーターのレベルを左側と揃えてください。

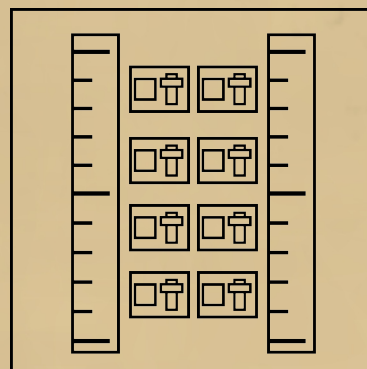



# インジケータに関する情報


RAD および BIO インジケータは制御パネルに配置されており、対象およびその収容環境に関する情報を示します。

RAD

BIO

## 電源に関する情報

電源は制御パネルに電力を供給し、その数は対象の収容条件によって異なります。それらは制御パネルの下部に配置されています。

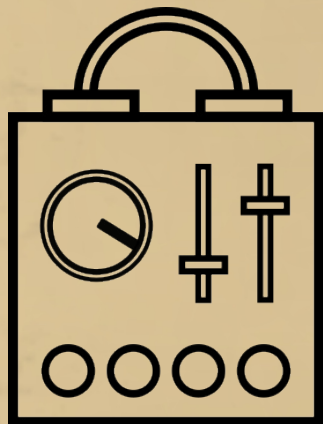

## シーリングコードに関する情報

シーリングコードは各対象に割り当てられた固有識別子であり、その対象に関する情報を示す参照コードです。観察ウィンドウの上部に表示されています。

**BZ3-D6X**



## 自爆装置に関する情報

自爆ボタンは、対象の逃走を防ぐために、対象および観察室の両方を破壊するために使用されます。これは最終手段としてのみ使用してください。

