

KEEP IT CONTAINED

协议手册

本协议手册随游戏《Keep It Contained》一同提供，是正确操作所必需的文件。

关键生物安全协议

本指南将是你唯一的支持来源，用于在未知生命体试图越过隔离线时对其进行控制。

你是操作员；你可能遇到的所有情况的对应协议都可以在这里找到。

模块的一般信息

模块位于控制面板的顶部。你需要解决的主要目标就是这些模块，以成功控制生物体。

你在每一关中遇到的模块可能不同，并且通常是随机的。

有关模块的详细信息请参阅第 4–9 页。

环境的一般信息


你在环境中看到的细节可能会影响模块的解法，或增加解题难度。

有关环境的详细信息请参阅第 10–13 页。

建议提前阅读，以做好准备。

线路连接说明

- 该模块包含四根电线和四个输入插槽。
- 每个输入插槽都有一个符号标记。
- 符号从左到右排列，必须按此顺序描述。
- 下方的列表示符号的优先级顺序。
- 如果描述的符号在某一列中处于最高位置，则必须连接该列所指定颜色的电线。
- 如果某根电线已经被连接，则应忽略该列。

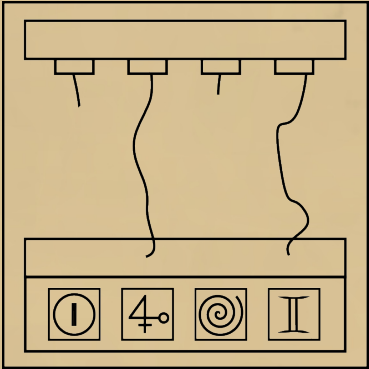

绿色

①
4♀
II
☉
⋅I⋅
☉
⧻
4♀

黄色

☉
☉
⋅I⋅
4♀
⧻
4♀
①
II

蓝色


4♀
II
☉
⧻
☉
①
⋅I⋅
4♀

红色

☉
4♀
☉
4♀
①
⋅I⋅
II
⧻

气体释放说明


- 该模块包含三种颜色的气体罐，每个都由一个开关控制。
- 左上角屏幕显示血液颜色，右上角显示纯度等级。
- 要选择释放的气体，请将对应气体罐下方的开关拨下。
- 按下红色按钮以释放选定的气体。
- 请按顺序阅读规则，并执行最先满足条件的指令。

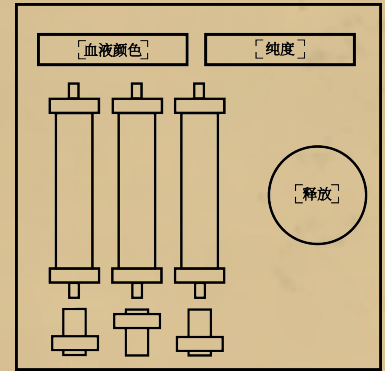

1. 如果血液颜色是绿色且纯度为中等，释放左侧和中间气体。
2. 如果控制面板由两个以上的电源供电，且纯度为纯净，释放所有气体。
3. 如果血液颜色是红色，且至少有三个 RAD 指示灯亮起，不释放任何气体。
4. 如果只有一个电源，且没有任何 BIO 指示灯亮起，仅释放中间气体。
5. 如果血液颜色是黄色，或纯度为低，释放左侧和右侧气体。
6. 如果纯度为零，且只有两个 RAD 指示灯亮起，仅释放左侧气体。
7. 如果血液颜色是蓝色，且纯度为高，释放中间和右侧气体。
8. 如果以上条件均不适用，仅释放右侧气体。


异常现象说明

- 1. 查看屏幕上显示的符号，并按照步骤 1 的说明操作。
- 2. 根据你收集的信息，按照步骤 2 确定异常类型。

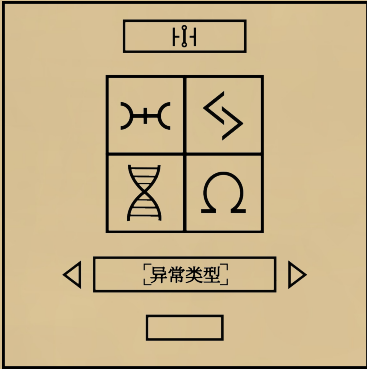

步骤 1

- 屏幕上的符号表示其所在的列。
- 从显示给技术员的四个符号中，按下不属于该列的符号按钮。
- 根据需要重复此过程，然后进入步骤 2。

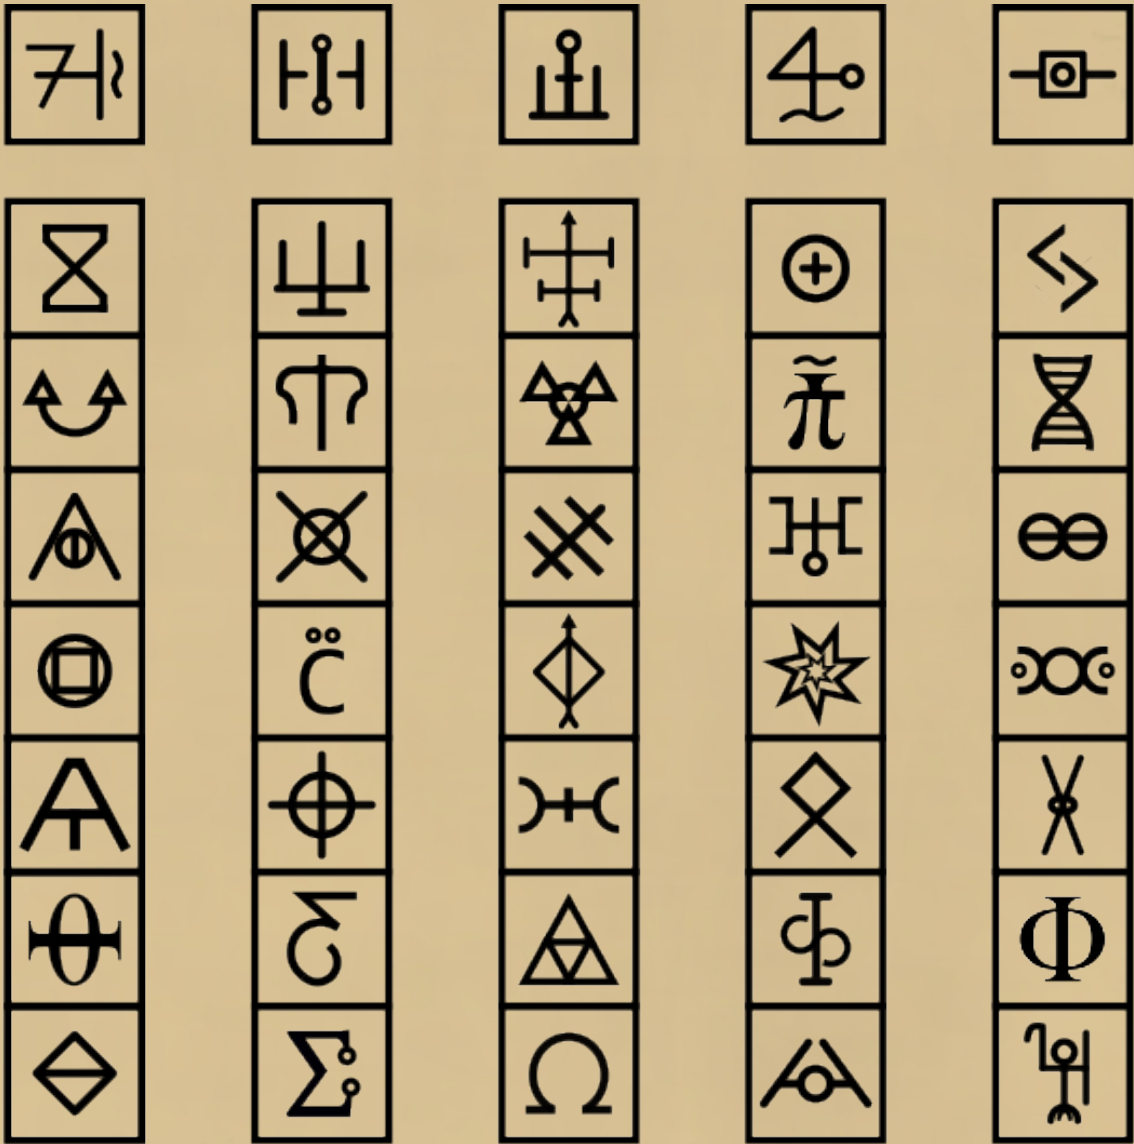

步骤 2

- 根据包含全部三个已按下符号的分组来识别异常。在模块显示屏上输入异常名称并提交。

异常类型

Leach

		
---	---	---

Mycrotide

		
---	---	---

Crack

		
---	---	---


Loop

		
---	---	---

Phase

		
---	---	---


Skin

		
---	---	---

Breach

		
--	--	--


Worm

		
--	--	--


Stink

		
--	--	--

Glitch

		
---	---	---

Time


		
---	---	---

Unknown


		
---	---	---

力场说明


- 根据电缆颜色执行以下指令。
- 如果没有电缆可剪，剪断最底部的电缆。

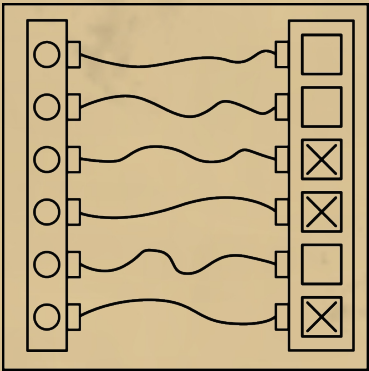


红色电缆

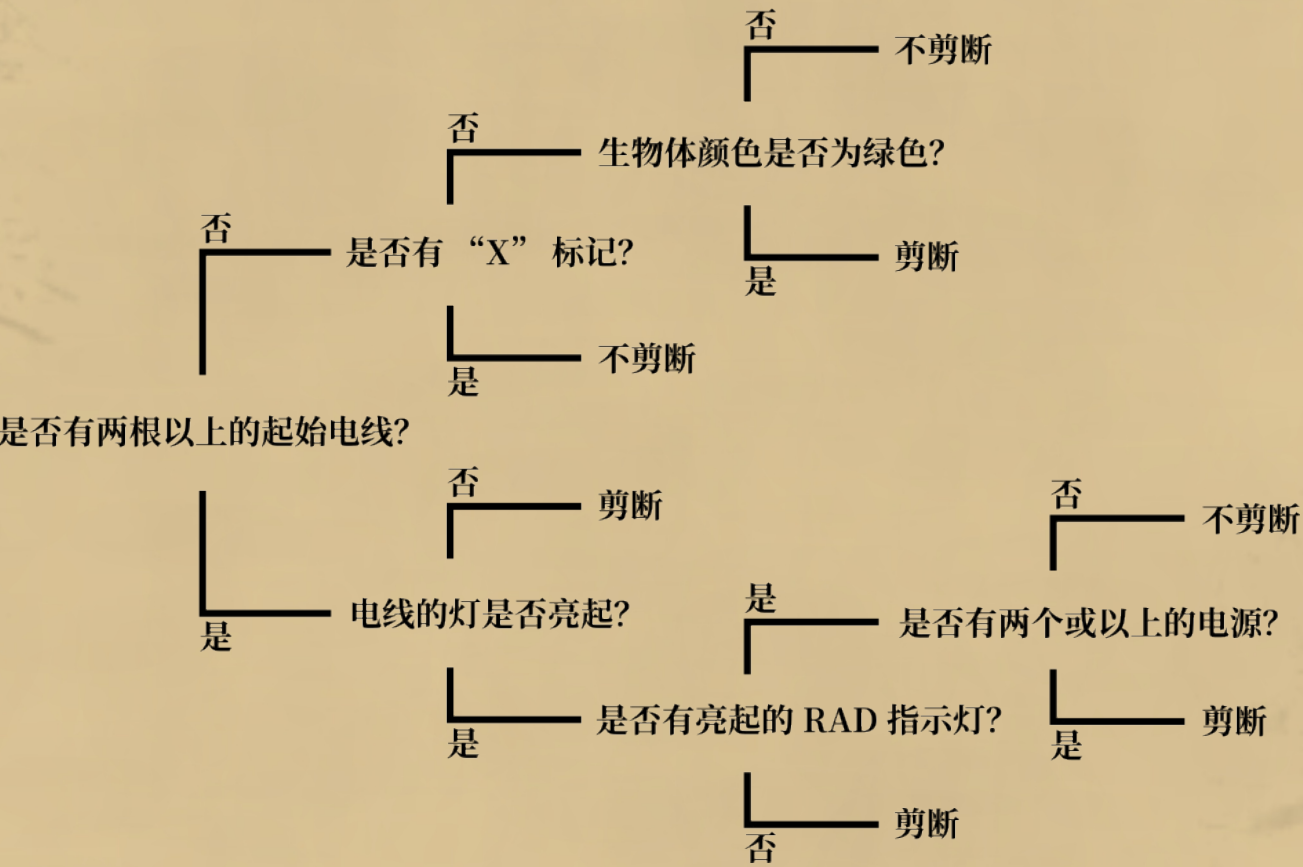

蓝色电缆

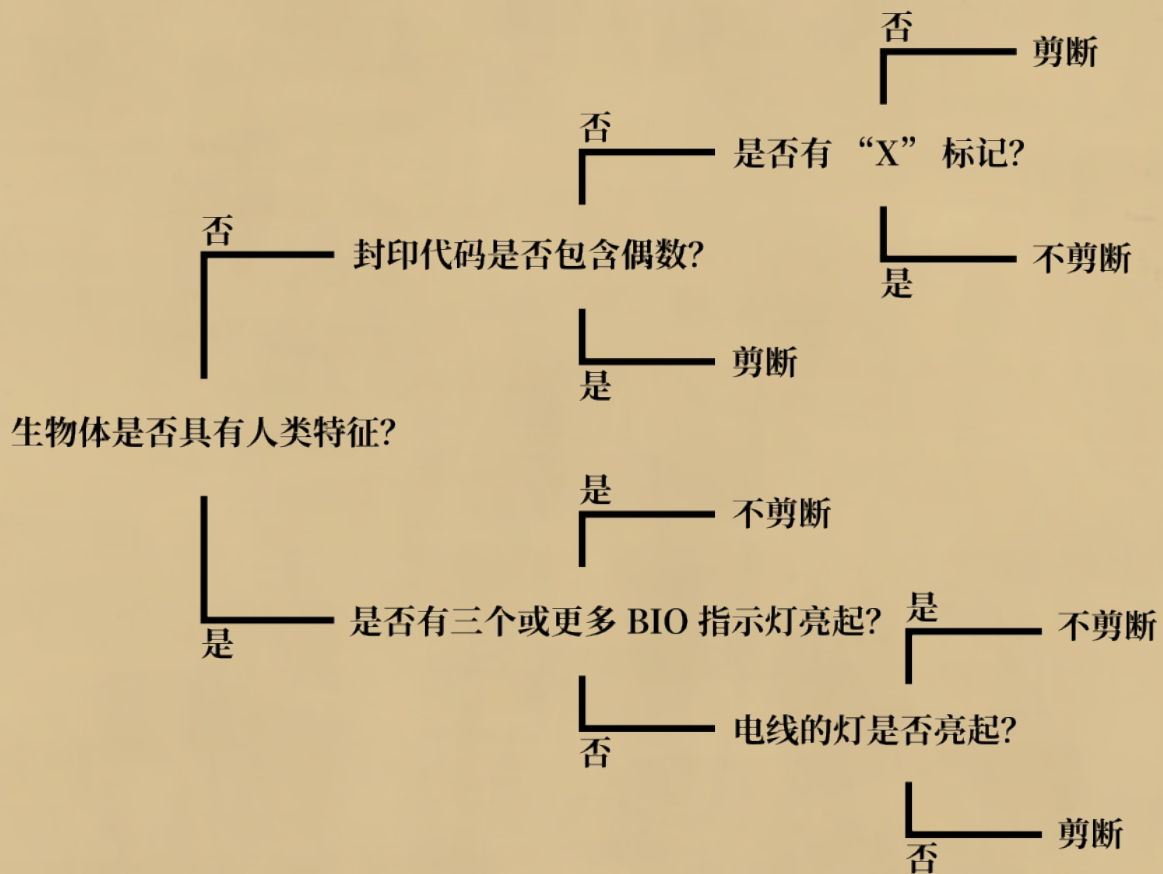


黄色电缆

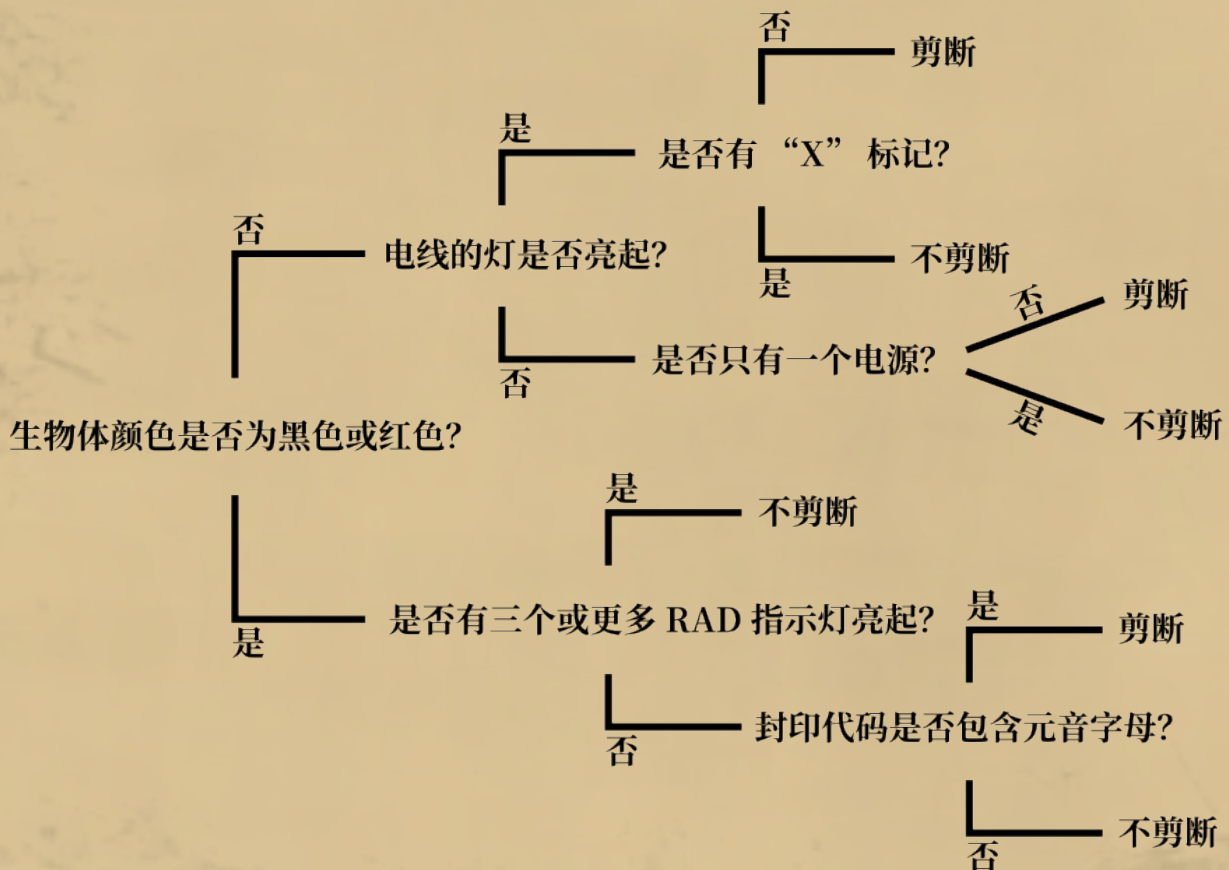

条件说明


- 使用模块上压力和温度指示器的信息，将滑块移动到正确的位置。
- 如果滑块到达最顶部或最底部，请从另一端继续计数。
- 请小心移动每个滑块，因为压力和温度会发生变化，且不能在错误的位置释放。

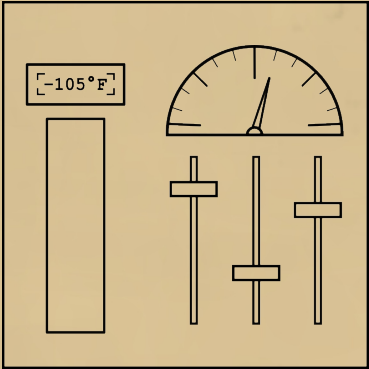

	如果温度在以下范围内 150°F 到 75°F	如果温度在以下范围内 75°F 到 0°F	如果温度在以下范围内 0°F 到 -75°F	如果温度在以下范围内 -75°F 到 -150°F
如果压力在以下范围内 0 到 45 PSI	将第2个滑块 调整 +4 个位置。	将第1个滑块 调整 -3 个位置。	将第3个滑块 调整 +7 个位置。	将第2个滑块 调整 -9 个位置。
如果压力在以下范围内 45 到 90 PSI	将第1个滑块 调整 +1 个位置。	将第3个滑块 调整 -5 个位置。	将第2个滑块 调整 +8 个位置。	将第1个滑块 调整 +6 个位置。
如果压力在以下范围内 90 到 135 PSI	将第3个滑块 调整 -2 个位置。	将第2个滑块 调整 -1 个位置。	将第1个滑块 调整 -7 个位置。	将第3个滑块 调整 +9 个位置。
如果压力在以下范围内 135 到 180 PSI	将第2个滑块 调整 +2 个位置。	将第1个滑块 调整 -9 个位置。	将第3个滑块 调整 +3 个位置。	将第2个滑块 调整 -6 个位置。

DNA 序列说明

- 1. 根据 DNA 的颜色选择正确的表格。
- 2. 按下与屏幕上闪烁的碱基对应的按钮。
- 3. 每次正确按下后，会出现一个新的碱基，并添加在之前输入的碱基之后，形成一个序列。
- 4. 每次添加新的碱基时，都必须从头重新输入整个序列，直到模块完成。

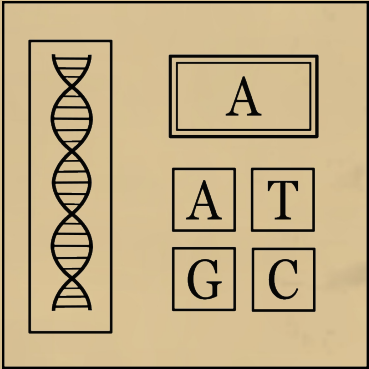

红色DNA：

如果封印代码包含元音：

如果封印代码不包含元音：

A碱基	G碱基	T碱基	C碱基
G	A	C	T
C	G	A	T

黄色DNA：

如果封印代码包含偶数：

如果封印代码不包含偶数：

A碱基	G碱基	T碱基	C碱基
A	C	G	T
T	A	C	G

蓝色DNA：

如果封印代码中数字的总和为偶数：

如果封印代码中数字的总和为奇数：

A碱基	G碱基	T碱基	C碱基
A	G	T	C
G	A	T	C

紫色DNA：



如果封印代码的最后一个字母是元音：

如果封印代码的最后一个字母是辅音：

A碱基	G碱基	T碱基	C碱基
T	C	G	A
C	T	A	G



键盘说明

- 将发光的按钮与黑色方框匹配，以找到正确的键盘。
- 按下标有“X”的按钮。
- 重复直到模块完成。

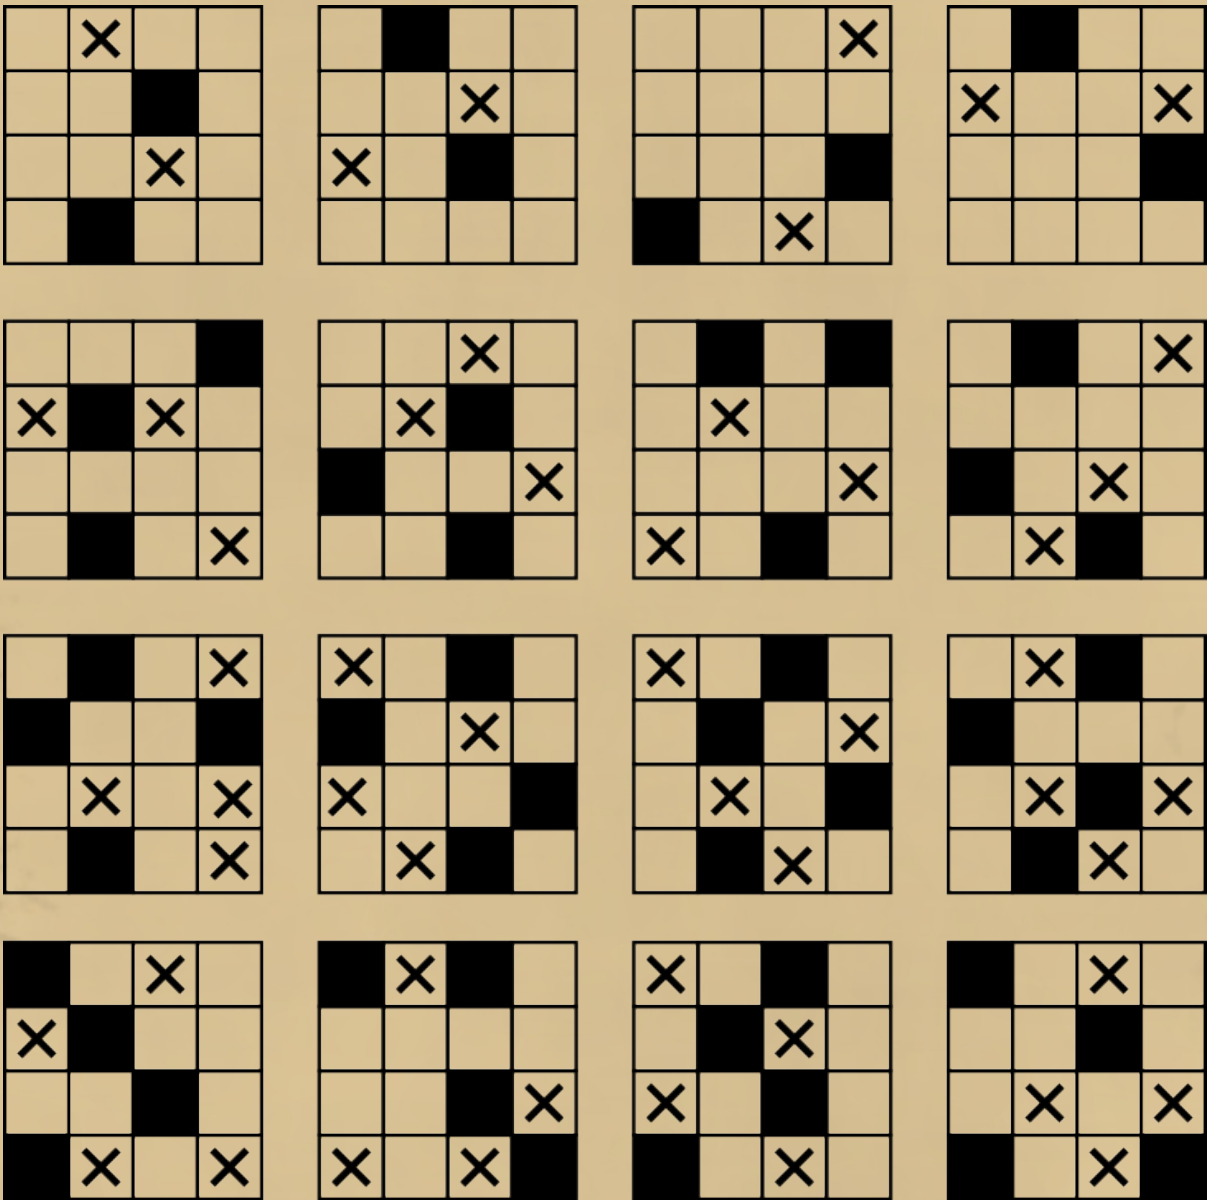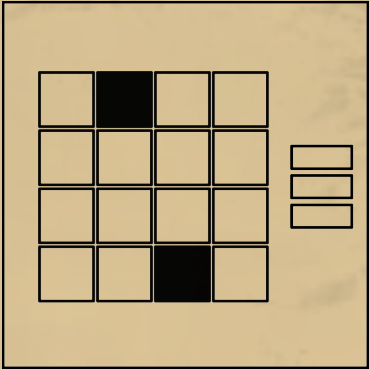


指南针说明


- 指南针周围灯光的位置指示应转动 4 个开关中的哪一个。
- 灯光的位置根据指南针所指的方向确定。
- 当所有开关都被转动后，模块完成。
- 开关编码顺序：

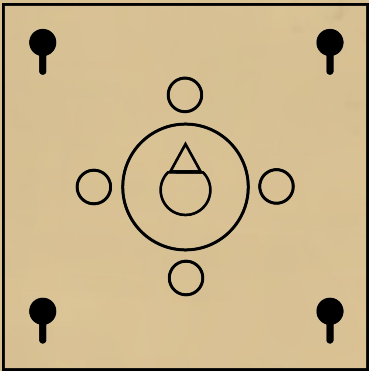


· 转动 D

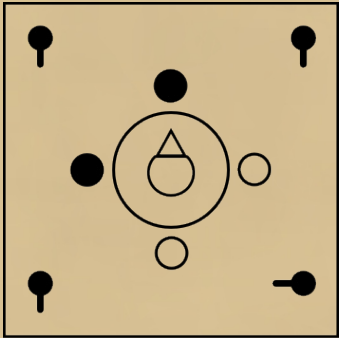


· 转动 A

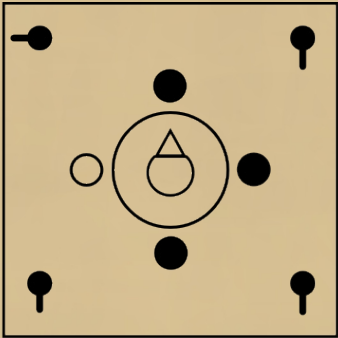


· 转动 C

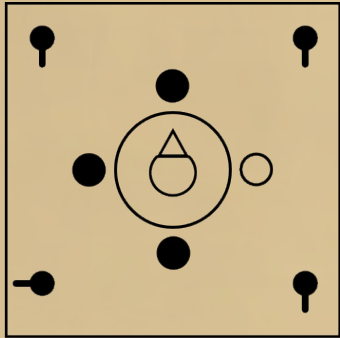


· 转动 B

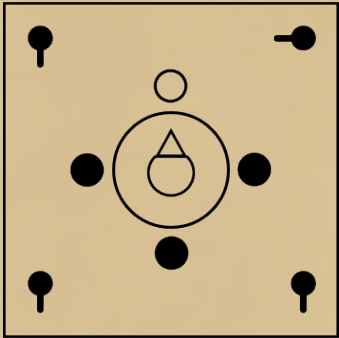


· 转动 A

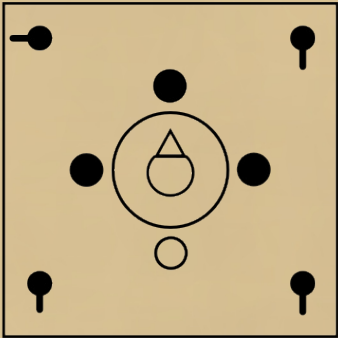


· 转动 C

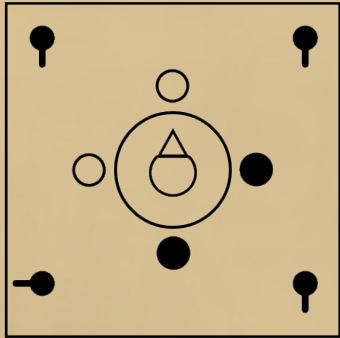

· 转动 B

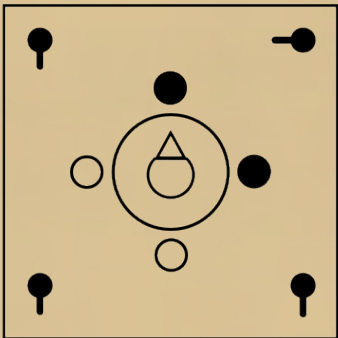


· 转动 D

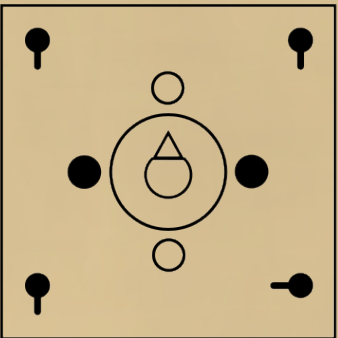

波动相关说明

- 模块上三个面板的指示灯亮起的顺序决定了解决面板的顺序。
- 对于需要解决的面板，根据该面板底部芯片的数量，从下表中选择相应的部分并按照说明操作。

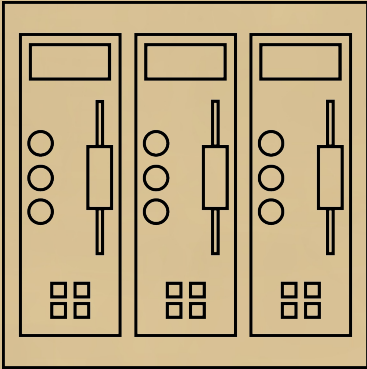

<u>1 芯片：</u> ●如果波长较短，按下方按钮1次。 ●否则，如果至少有2个电源，按中间按钮3次。 ●否则，按上方按钮2次。
<u>2 芯片：</u> ●如果振幅较高，按中间按钮1次。 ●否则，如果代码包含偶数，按上方按钮1次。 ●否则，如果波长较长，先按上方按钮，然后立即按中间按钮。 ●否则，按下方按钮3次。
<u>3 芯片：</u> ●如果优先级为第1位，按上方按钮2次。 ●否则，如果波长较短且振幅较高，先按上方按钮，然后立即按下方按钮。 ●否则，如果波长较长或振幅较低，按上方按钮2次，然后按中间按钮1次。 ●否则，从下到上按所有按钮。
<u>4 芯片：</u> ●如果振幅较低，按中间按钮1次。 ●否则，如果没有波，先按中间按钮1次，然后按下方按钮2次。 ●否则，如果优先级为第2位，从上到下按所有按钮。 ●否则，按下方按钮3次。


畸变

当实验室内的某些生命体失去稳定性时，它们会在周围环境中引发畸变。

针对这些畸变可能在实验室内引发的问题的应对措施列于下方。


畸变

- 按住按钮，直到压力水平恢复正常。

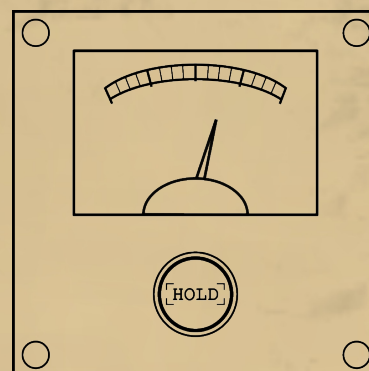


畸变

- 仅按下闪烁的按钮以稳定该生命体。

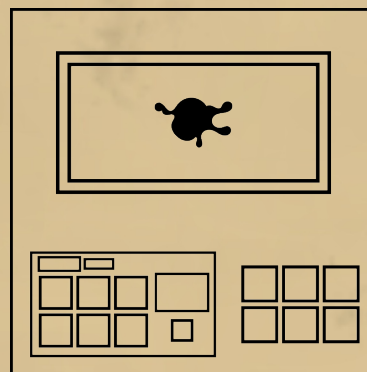


畸变

- 只打开面板上灯光闪烁的开关。

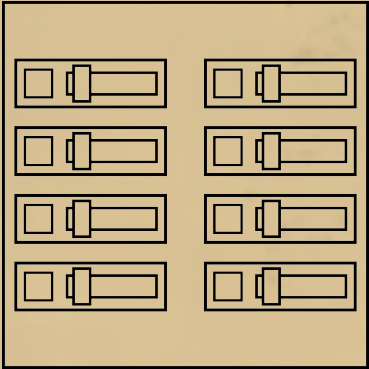


畸变

- 将弹出的管子放回原位，然后拉下侧边的杆将其固定。

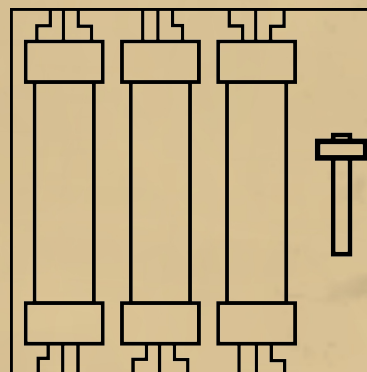


畸变

- 根据开关上的数字进行开关操作，使右侧计量器的液位与左侧对齐。

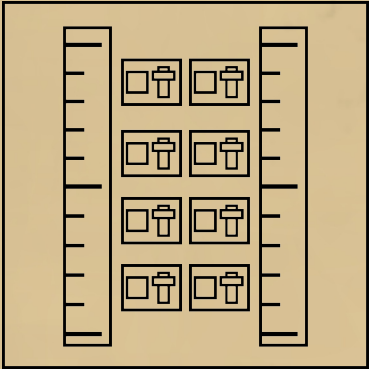


指示灯信息

RAD 和 BIO 指示灯位于控制面板上，用于提供关于实验对象及其环境的信息。

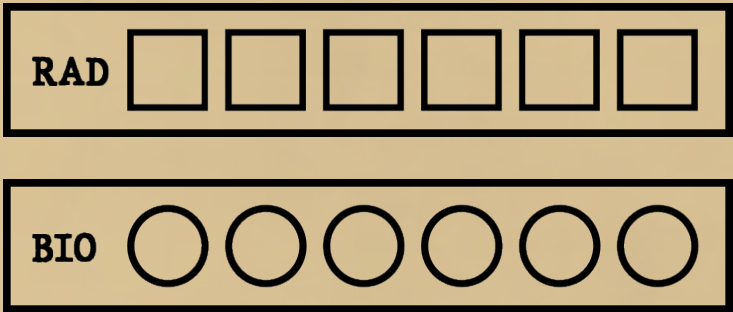

电源信息

电源为控制面板供电，其数量可能会根据收容对象的收容条件而变化。它们位于控制面板的底部。

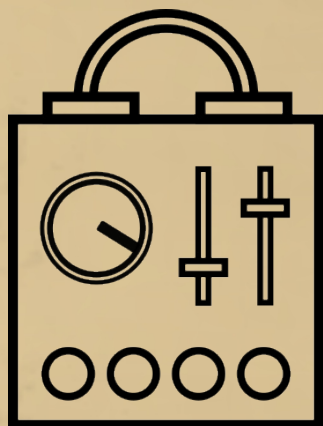

封印代码信息

封印代码是分配给每个实验对象的专属识别码。它作为唯一参考，并提供有关该对象的信息。封印代码位于观察窗口的顶部

BZ3-D6X

自毁机制信息

自毁按钮用于摧毁实验对象及观察舱，以防止其逃脱。 仅在万不得已时使用。

