

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLOVÁ PŘÍRUČKA

**Tato protokolová příručka doprovází hru Keep It Contained a je nezbytná
pro její správné používání.**

KRITICKÉ PROTOKOLY BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

Tato příručka bude vaším jediným zdrojem podpory při udržování neznámých forem života pod kontrolou, pokud se pokusí překročit karanténní hranici.

Jste operátor; příslušné protokoly pro každý scénář, se kterým se můžete setkat, naleznete zde.

OBECNÉ INFORMACE O MODULECH

Moduly se nacházejí v horní části ovládacího panelu. Hlavní cíle, které musíte vyřešit k zadržení organismů, jsou moduly.

Moduly, se kterými se setkáte, se mohou v každé úrovni lišit a jsou obvykle náhodné.

Podrobné informace o modulech jsou uvedeny na stranách 4-9.

OBECNÉ INFORMACE O PROSTŘEDÍ


Detaily, které vidíte ve svém prostředí, mohou ovlivnit řešení modulů nebo jejich řešení ztížit.

Podrobné informace o prostředí jsou uvedeny na stranách 10-13.

Doporučuje se si je předem přečíst, abyste byli připraveni.

Pokyny k zapojení vodičů

- Modul obsahuje čtyři vodiče a čtyři vstupní sloty.
- Každý vstupní slot je označen symbolem.
- Symboly jsou uspořádány zleva doprava a musí být popsány v tomto pořadí.
- Sloupce níže označují pořadí priority symbolů.
- Pokud je popsán symbol na nejvyšší pozici v některém sloupci, musí být připojen k vodiči barvy uvedené v daném sloupci.
- Pokud je některý vodič již připojen k symbolu, daný sloupec se ignoruje.

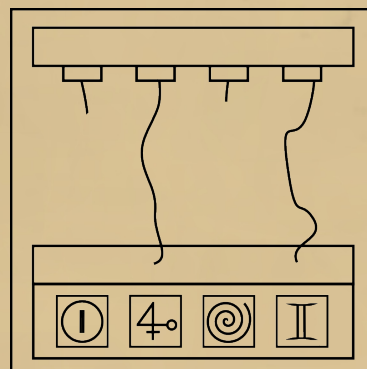

Zelená:

Ⓢ
♀♂
II
☹
⋅I⋅
☹
⌘
♀♂

Žlutá:

☹
☹
⋅I⋅
♀♂
⌘
♀♂
Ⓢ
II

Modrá:


♀♂
II
☹
⌘
☹
Ⓢ
⋅I⋅
♀♂

Červená:

☹
♀♂
☹
♀♂
Ⓢ
⋅I⋅
II
⌘

Pokyny k uvolnění plynu

- Modul obsahuje tři barevné plynové nádrže, z nichž každá je ovládána přepínačem.
- Obrazovka vlevo nahoře zobrazuje barvu krve. Obrazovka vpravo nahoře zobrazuje úroveň čistoty.

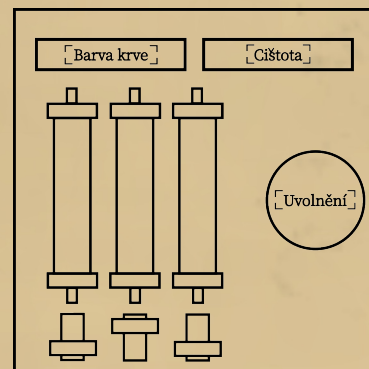


- Pro výběr plynů k uvolnění je třeba přepínače pod jednotlivými nádržemi přepnout dolů.
- Stiskněte červené tlačítko pro uvolnění vybraných plynů.
- Přečtěte si pravidla v daném pořadí a proveďte první platnou instrukci.

1. Pokud je barva krve zelená a úroveň čistoty střední, uvolněte levý a prostřední plyn.
2. Pokud je ovládací panel napájen více než dvěma zdroji energie a úroveň čistoty je čistá, uvolněte všechny plyny.
3. Pokud je barva krve červená a svítí alespoň tři indikátory RAD, neuvolňujte žádný plyn.
4. Pokud je na panelu pouze jeden zdroj energie a nesvítí žádné indikátory BIO, uvolněte pouze prostřední plyn.
5. Pokud je barva krve žlutá nebo je úroveň čistoty nízká, uvolněte levý a pravý plyn.
6. Pokud je úroveň čistoty nulová a svítí pouze dva indikátory RAD, uvolněte pouze levý plyn.
7. Pokud je barva krve modrá a úroveň čistoty vysoká, uvolněte prostřední a pravý plyn.
8. Pokud neplatí žádná z výše uvedených podmínek, uvolněte pouze pravý plyn.

Pokyny k anomáliím


1. Podívejte se na symbol zobrazený na obrazovce a postupujte podle pokynů v Kroku 1.

2. Pomocí získaných informací postupujte podle pokynů v Kroku 2 a určete, o kterou anomálii se jedná.

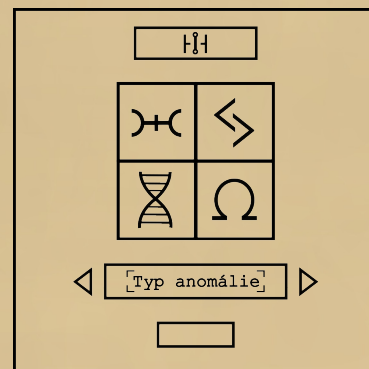

Krok 1:

- Symbol na obrazovce představuje sloupec, ve kterém se nachází.
- Ze čtyř symbolů zobrazených technikovi stisknete tlačítko se symbolem, který do daného sloupce nepatří.
- Tento postup opakuje tolikrát, kolikrát je potřeba, poté pokračujte ke

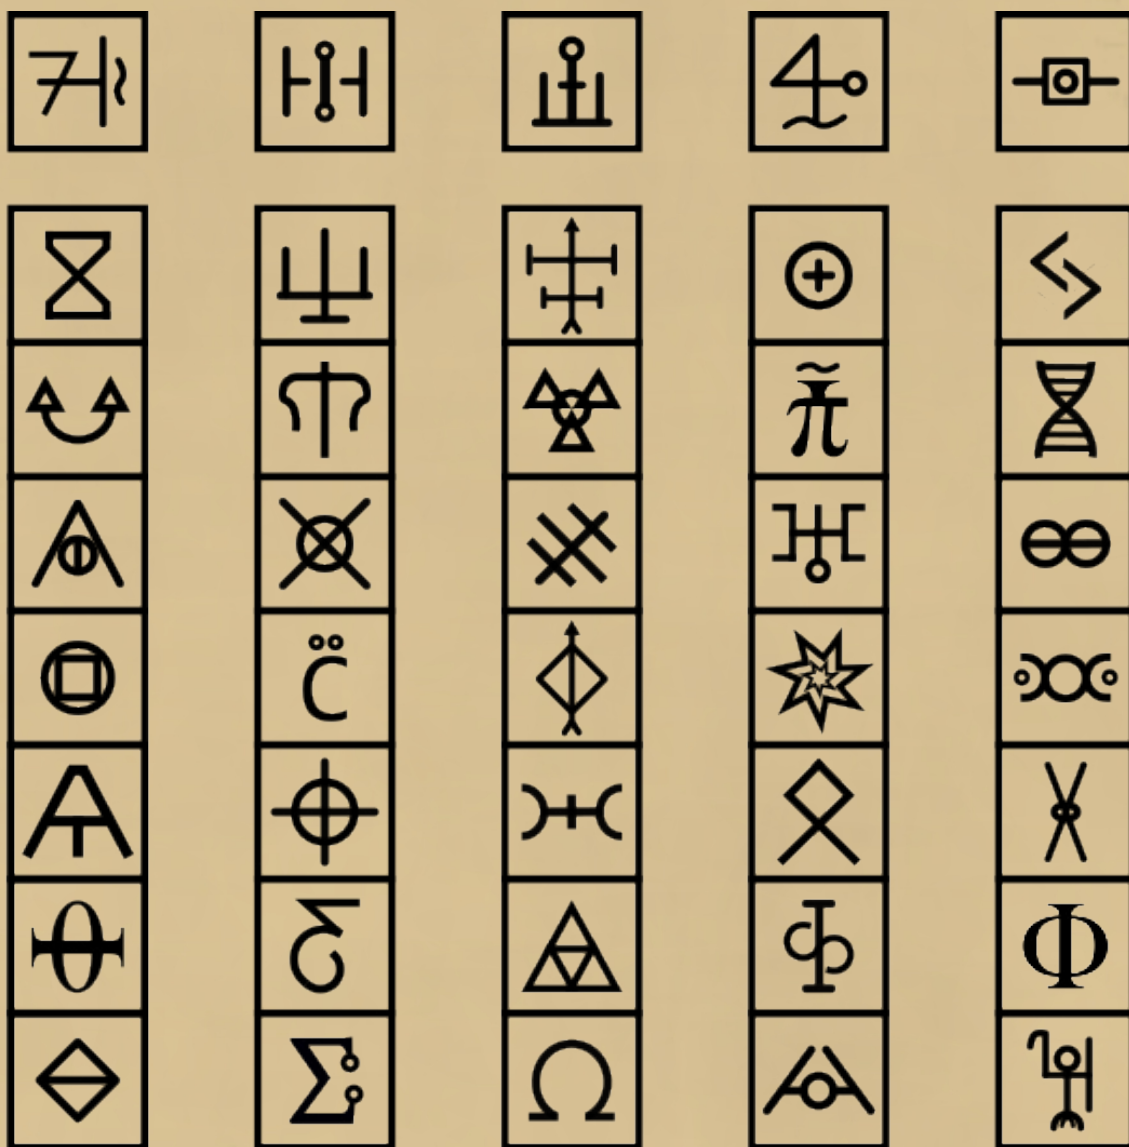

Krok 2:

- Identifikujte anomálii na základě skupiny, která obsahuje všechny tři stisknuté symboly, poté ji zadejte na displeji modulu a potvrďte.

Typy anomálií:


Leach



Mycrotide



Crack

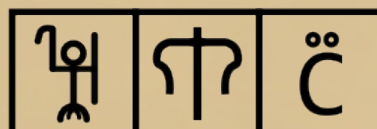

Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink




Glitch



Time




Unknown

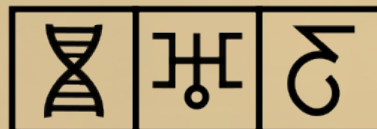


Pokyny k silovým polím


- Postupujte podle níže uvedených pokynů podle barvy kabelu.
- Pokud není žádný kabel k přestřižení, přestřihněte nejspodnější kabel.

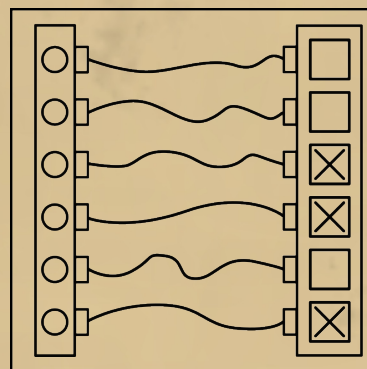


Červený kabel:

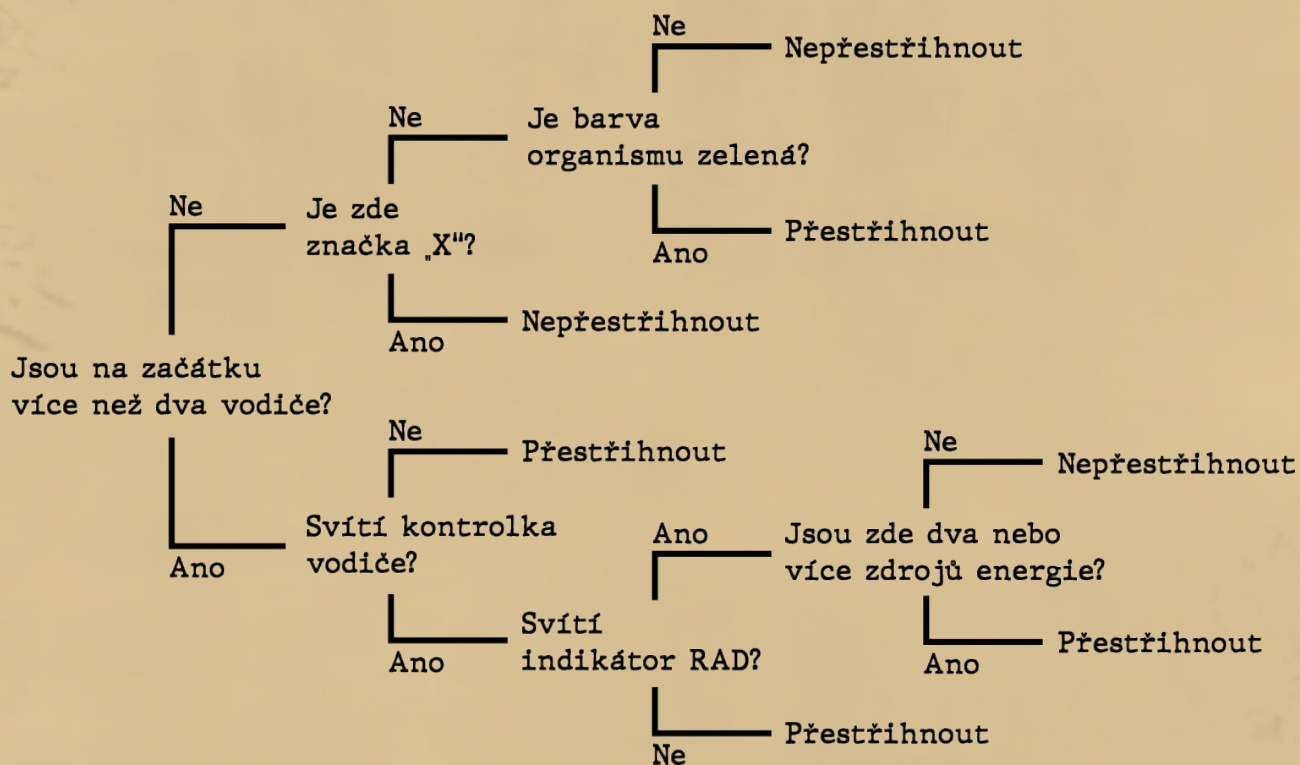

Modrý kabel:

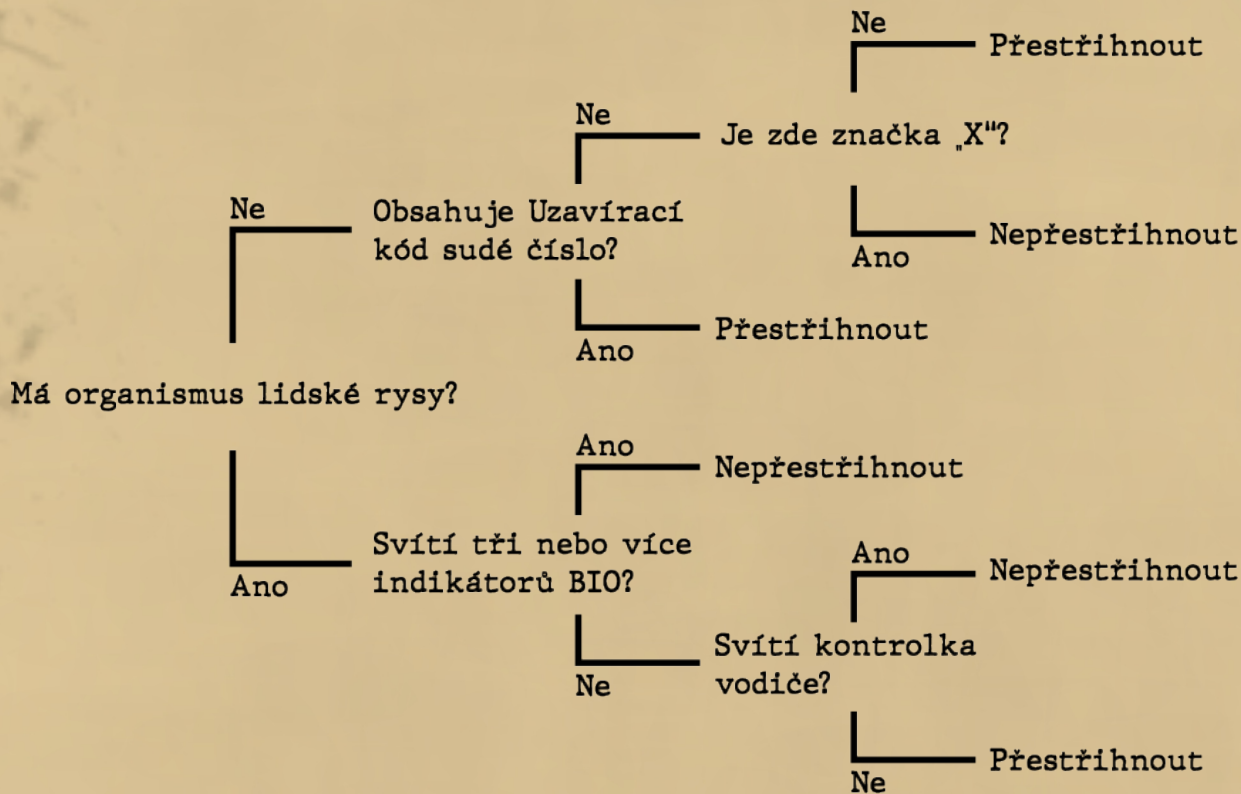


Žlutý kabel:

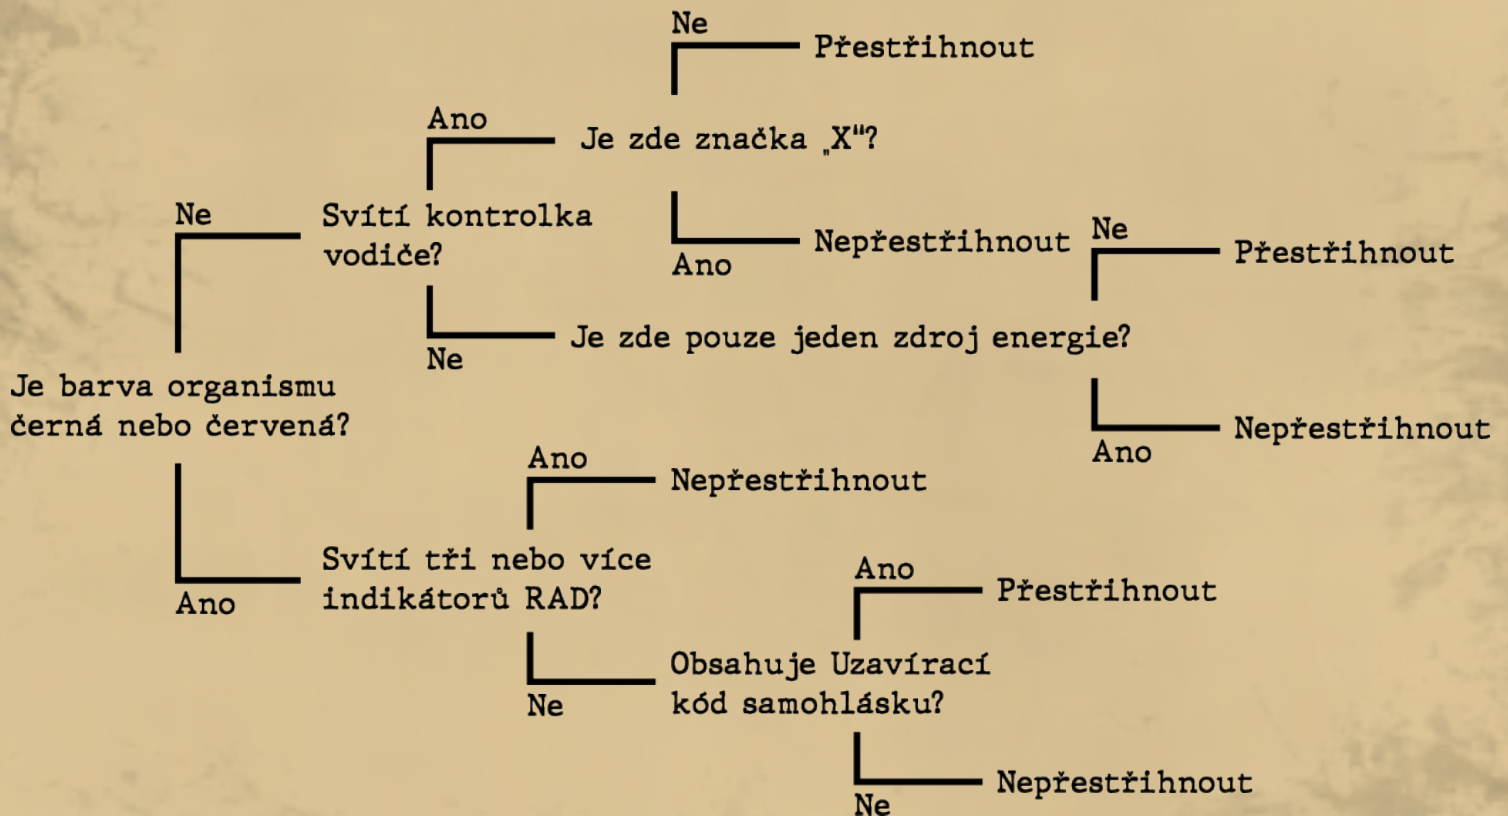

Pokyny k podmínkám


- Použijte informace z ukazatelů tlaku a teploty na modulu k přesunutí posuvníků do správných poloh.
- Pokud posuvník dosáhne úplně nahoře nebo dole, pokračujte v počítání z opačného konce.
- Každý posuvník posouvejte opatrně, protože tlak a teplota se budou měnit a nesmí být uvolněn ve špatné poloze.

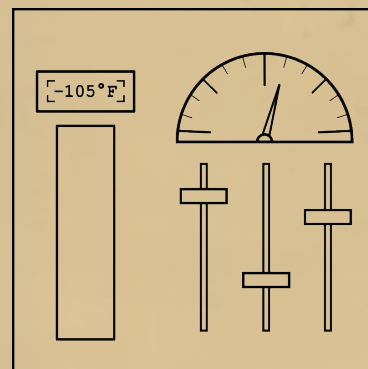

	Pokud je teplota mezi 150°F a 75°F	Pokud je teplota mezi 75°F a 0°F	Pokud je teplota mezi 0°F a -75°F	Pokud je teplota mezi -75°F a -150°F
Pokud je tlak mezi 0 a 45 PSI	Nastavte 2. posuvník o +4 pozice.	Nastavte 1. posuvník o -3 pozice.	Nastavte 3. posuvník o +7 pozic.	Nastavte 2. posuvník o -9 pozic.
Pokud je tlak mezi 45 a 90 PSI	Nastavte 1. posuvník o +1 pozici.	Nastavte 3. posuvník o -5 pozic.	Nastavte 2. posuvník o +8 pozic.	Nastavte 1. posuvník o +6 pozic.
Pokud je tlak mezi 90 a 135 PSI	Nastavte 3. posuvník o -2 pozice.	Nastavte 2. posuvník o -1 pozici.	Nastavte 1. posuvník o -7 pozic.	Nastavte 3. posuvník o +9 pozic.
Pokud je tlak mezi 135 a 180 PSI	Nastavte 2. posuvník o +2 pozice.	Nastavte 1. posuvník o -9 pozic.	Nastavte 3. posuvník o +3 pozice.	Nastavte 2. posuvník o -6 pozic.

Pokyny k sekvenci DNA

1. Vyberte správnou tabulku podle barvy DNA.
2. Stiskněte tlačítko odpovídající bázi, která bliká na obrazovce.
3. Při každém správném stisknutí se objeví nová báze a přidá se za dříve zadanou, čímž vznikne sekvence.

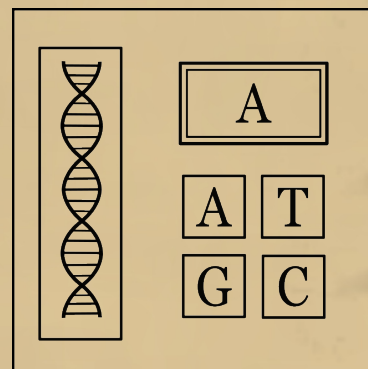

Červená DNA:

Pokud kód pečetění obsahuje samohlásku:

Pokud kód pečetění neobsahuje samohlásku:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
G	A	C	T
C	G	A	T

Žlutá DNA:

Pokud kód pečetění obsahuje sudé číslo:

Pokud kód pečetění neobsahuje sudé číslo:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
A	C	G	T
T	A	C	G

Modrá DNA:

Pokud je součet čísel v kódu pečetění sudý:

Pokud je součet čísel v kódu pečetění lichý:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
A	G	T	C
G	A	T	C

Fialová DNA:



Pokud je poslední písmeno kódu pečetění samohláska:

Pokud je poslední písmeno kódu pečetění souhláska:

Báze A	Báze G	Báze T	Báze C
T	C	G	A
C	T	A	G


Pokyny pro klávesnici

- Přiřaďte svítící tlačítka k černým políčkům, abyste našli správnou klávesnici.
- Stiskněte tlačítka označená „X“.
- Opakujte, dokud není modul dokončen.

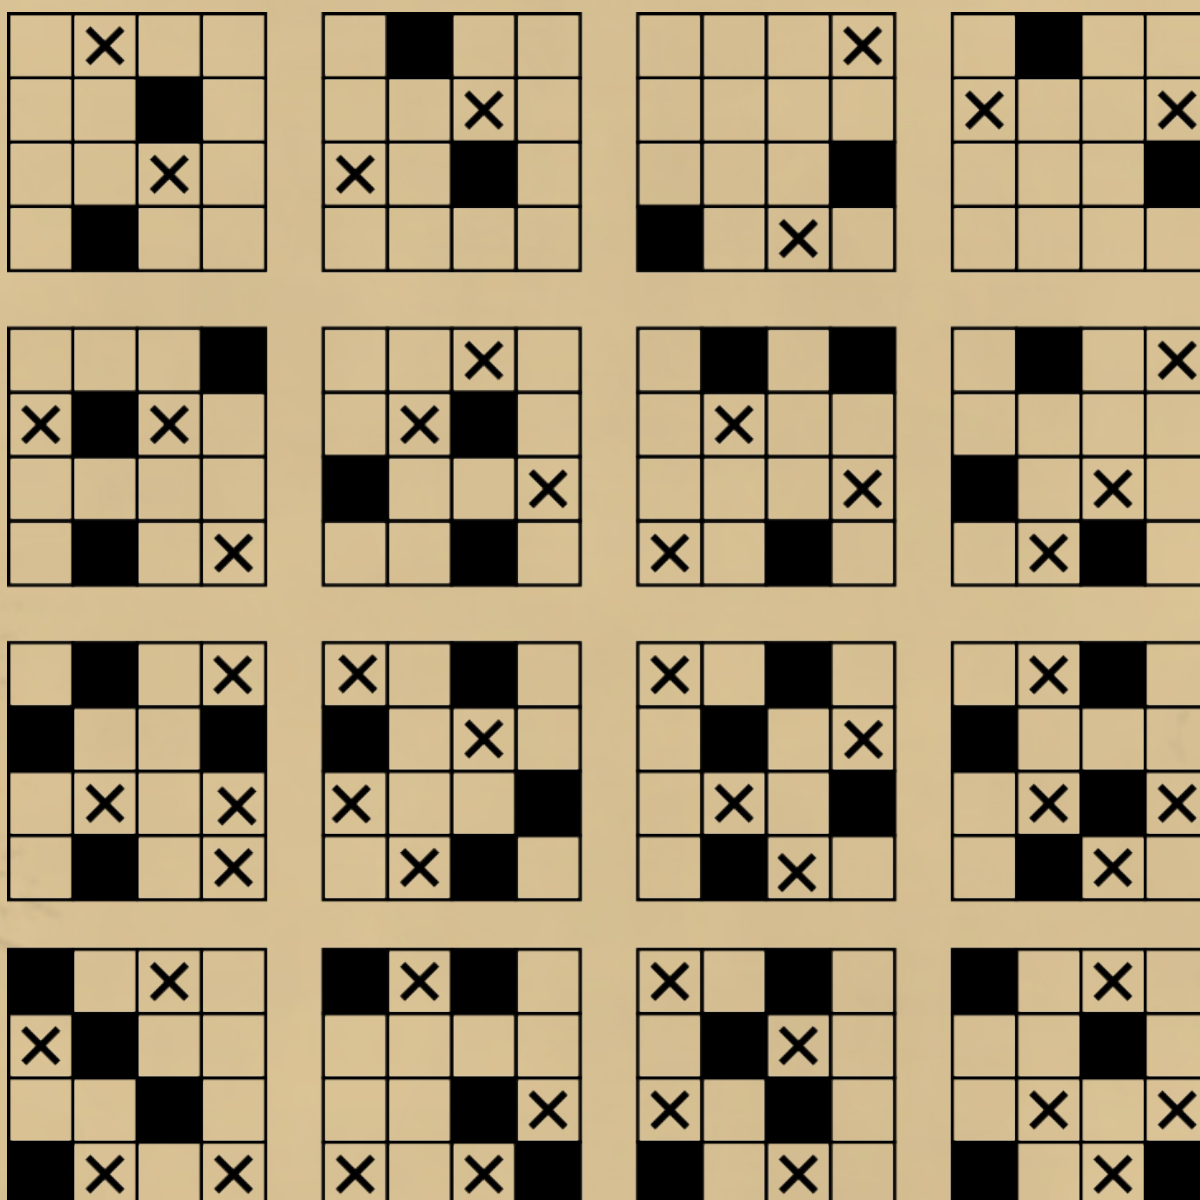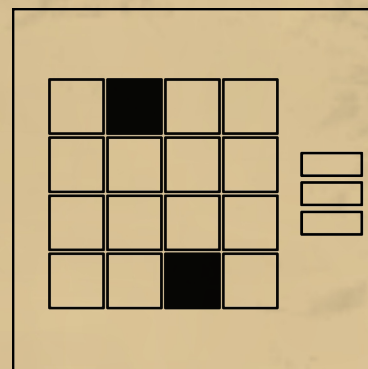


Pokyny ke kompasu


- Poloha světél kolem kompasu ukazuje, který ze 4 přepínačů je třeba otočit.
- Polohy světél jsou určeny směrem, kterým kompas ukazuje.
- Jakmile jsou všechny přepínače otočeny, modul je dokončen.

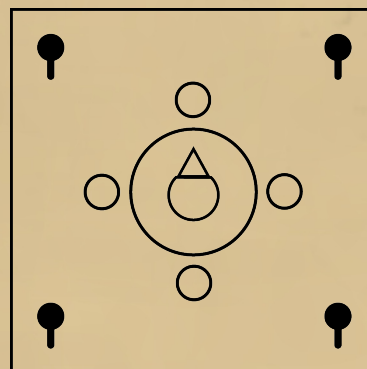


- Pořadí kódování přepínačů:




- Otočte D

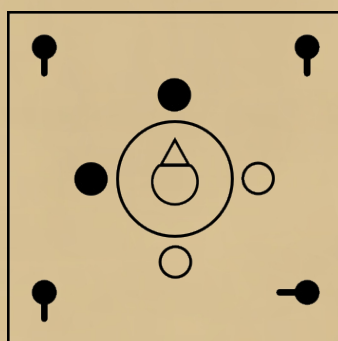


- Otočte A

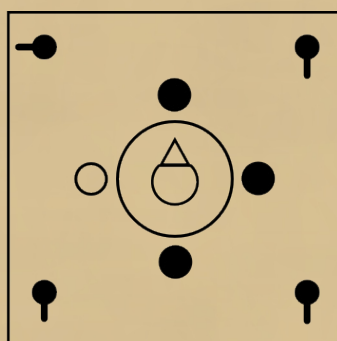


- Otočte C

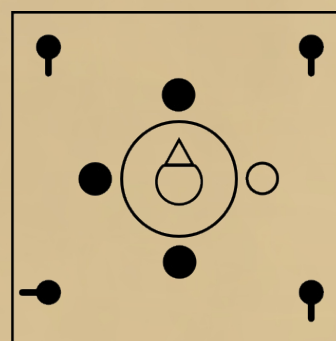


- Otočte B

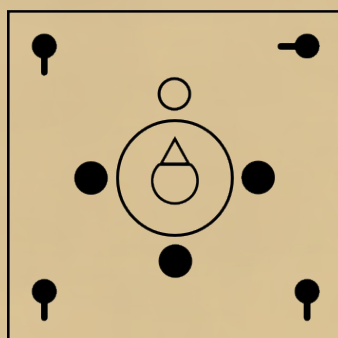


- Otočte A

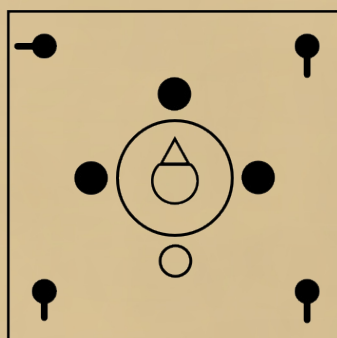


- Otočte C

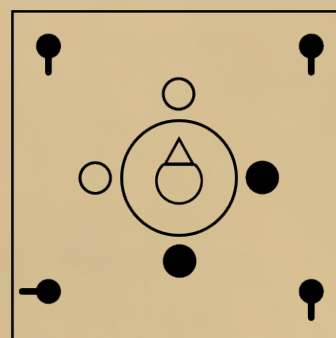

- Otočte B

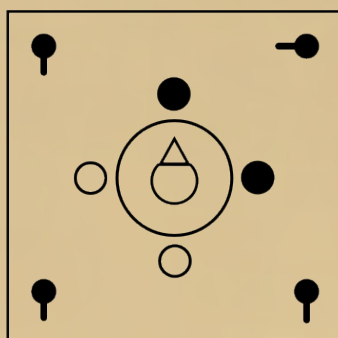


- Otočte D

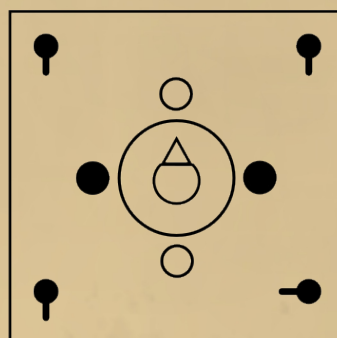

Pokyny týkající se vln

- Pořadí, ve kterém se rozsvěcují světla na třech panelech modulu, určuje pořadí, ve kterém mají být panely vyřešeny.
- Pro panel, který má být vyřešen, vyberte odpovídající část z tabulky níže podle počtu čipů umístěných ve spodní části panelu a postupujte podle pokynů.

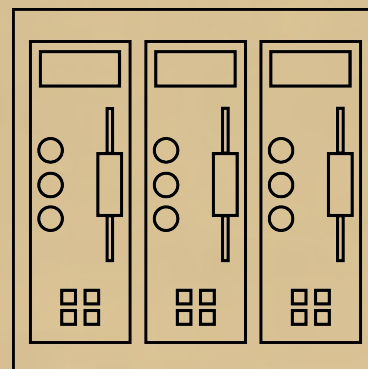

1 čip:

- Pokud je vlnová délka krátká, stiskni spodní tlačítko 1×.
- Jinak, pokud jsou alespoň 2 zdroje energie, stiskni prostřední tlačítko 3×.
- Jinak stiskni horní tlačítko 2×.

2 čipy:

- Pokud je amplituda vysoká, stiskni prostřední tlačítko 1×.
- Jinak, pokud kód obsahuje sudé číslo, stiskni horní tlačítko 1×.
- Jinak, pokud je vlnová délka dlouhá, stiskni nejprve horní tlačítko a poté ihned prostřední.
- Jinak stiskni spodní tlačítko 3×.

3 čipy:

- Pokud je priorita 1., stiskni horní tlačítko 2×.
- Jinak, pokud je vlnová délka krátká a amplituda vysoká, stiskni horní tlačítko a poté ihned spodní.
- Jinak, pokud je vlnová délka dlouhá nebo amplituda nízká, stiskni horní tlačítko 2× a poté prostřední 1×.
- Jinak stiskni všechna tlačítka odspodu nahoru.

4 čipy:

- Pokud je amplituda nízká, stiskni prostřední tlačítko 1×.
- Jinak, pokud nejsou žádné vlny, stiskni prostřední tlačítko 1× a poté spodní 2×.
- Jinak, pokud je priorita 2., stiskni všechna tlačítka shora dolů.
- Jinak stiskni spodní tlačítko 3×.


DEFORMACE

Když některé formy života v laboratoři ztratí stabilitu, způsobují deformace v okolním prostředí.

Protiopatření k problémům, které tyto deformace mohou v laboratoři způsobit, jsou uvedena níže.


Deformace

- **Podržte tlačítko, dokud se úroveň tlaku nevrátí do normálu.**

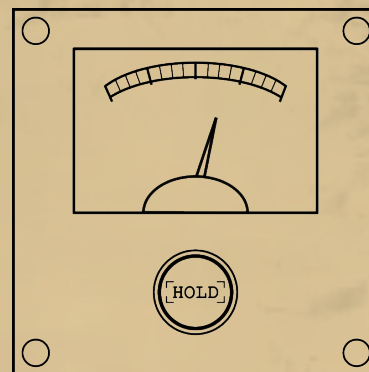


Deformace

- Stiskněte pouze blikající tlačítko, abyste stabilizovali formu života.

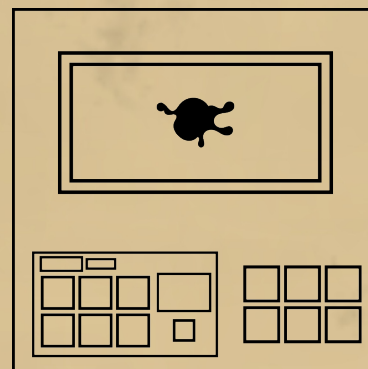


Deformace

- Zapínejte pouze ty přepínače na panelu, jejichž kontrolky blikají.

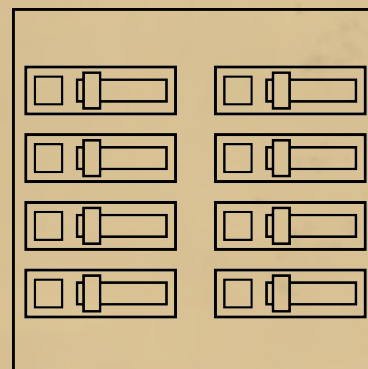


Deformace

- Vraťte vysunuté trubice zpět na jejich místo a poté spustěte boční páku, abyste je zajistili.

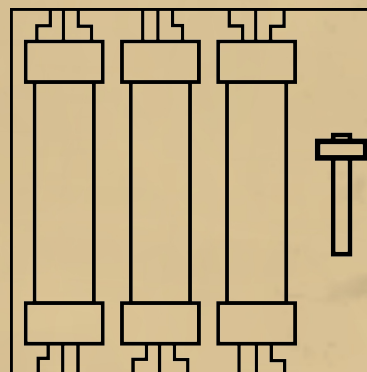

Deformace

- Zapínejte a vypínejte přepínače podle čísel na nich, abyste vyrovnali úroveň pravého měřidla s levým.

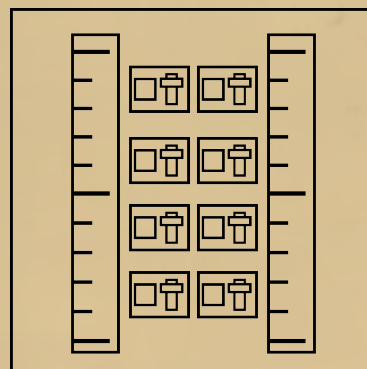

Informace o indikátorech


Indikátory RAD a BIO se nacházejí na ovládacím panelu a poskytují informace o subjektu a prostředí, ve kterém je subjekt držen.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informace o zdrojích energie

Zdroje energie napájejí ovládací panel a jejich počet se může lišit v závislosti na podmínkách zadržení subjektu. Nacházejí se ve spodní části ovládacího panelu.

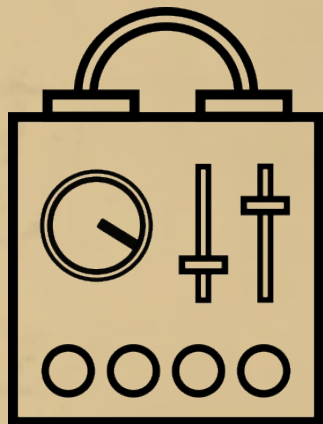

Informace o Uzavíracím kódu

Uzavírací kód je identifikátor specifický pro subjekt, přidělený každému subjektu, který slouží jako jedinečný odkaz poskytující o něm informace. Nachází se v horní části pozorovacího okna.

BZ3-D6X

Seznam samohlásek:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informace o mechanismu sebezničení

Tlačítko sebezničení se používá ke zničení jak subjektu, tak pozorovací komory, aby se zabránilo jeho úniku. Mělo by být použito pouze jako poslední možnost.

