

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLMANUAL

Denne protokolmanual følger med spillet Keep It Contained og er påkrævet for korrekt drift.

KRITISKE BIOLOGISKE SIKKERHEDSPROTOKOLLER

Denne vejledning vil være din eneste støtte til at holde ukendte livsformer under kontrol, når de forsøger at krydse karantænelinjen.

Du er operatøren; de gældende protokoller for enhver situation, du måtte møde, kan findes her.

GENEREL INFORMATION OM MODULER

Modulerne er placeret øverst på kontrolpanelet. De primære mål, du skal løse for at indeslutte organismerne, er modulerne.

De moduler, du møder, kan variere på hvert niveau og er generelt tilfældige.

Detaljerede oplysninger om modulerne findes på siderne 4-9.


GENEREL INFORMATION OM MILJØET

De detaljer, du ser i dit miljø, kan påvirke løsningen af modulerne eller gøre dem sværere at løse.


Detaljerede oplysninger om miljøet findes på siderne 10-13. Det anbefales at læse dem på forhånd for at være forberedt.

Instruktioner om ledningsforbindelser

- Modulet indeholder fire ledninger og fire indgangsslots.
- Hver indgang er markeret med et symbol.
- Symbolerne er ordnet fra venstre mod højre og skal beskrives i denne rækkefølge.
- Kolonnerne nedenfor angiver symbolernes prioritetsrækkefølge.
- Hvis det beskrevne symbol står øverst i en kolonne, skal det forbindes med ledningen i den farve, der er angivet i den kolonne. Hvis en ledning allerede er forbundet med et symbol, skal den kolonne ignoreres.

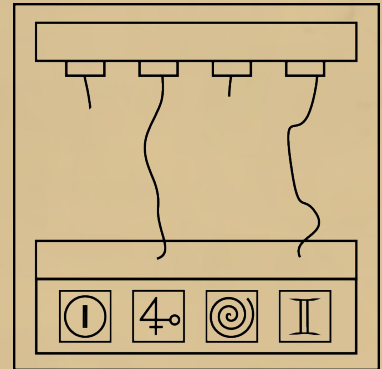


Grøn:

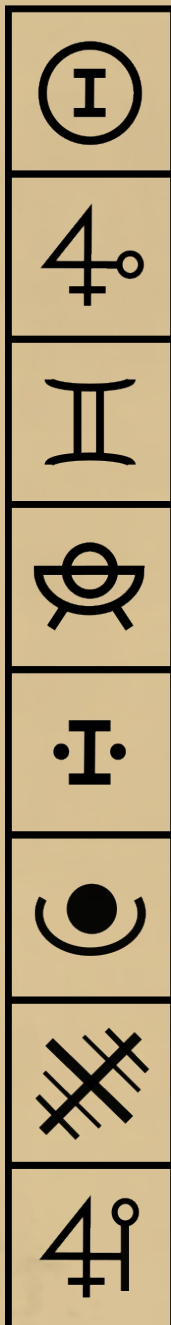


Gul:



Blå:

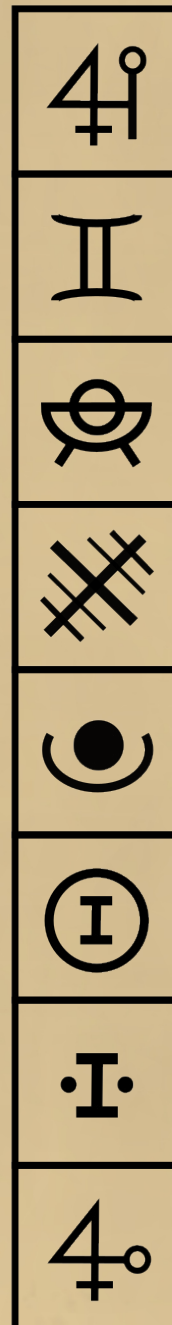


Rød:

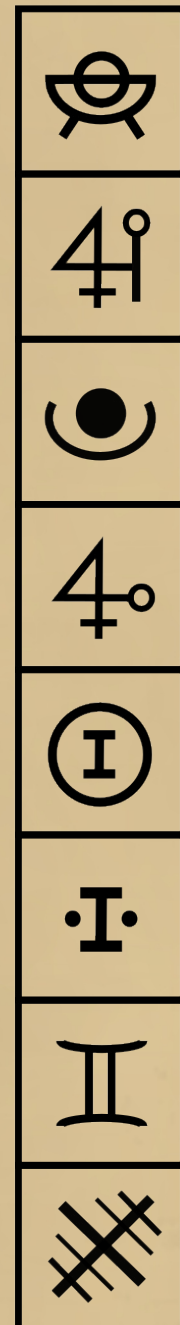

Instruktioner om gasudslip

- Modulet indeholder tre farvede gasbeholdere, hver styret af en kontakt.
- Skærmen øverst til venstre viser blodets farve. Den øverst til højre viser renhedsniveauet.
- For at vælge de gasser, der skal frigives, skal kontakterne under hver gasbeholder sænkes.
- Tryk på den røde knap for at frigive de valgte gasser.
- Læs reglerne i rækkefølge og udfør den første gyldige instruktion.

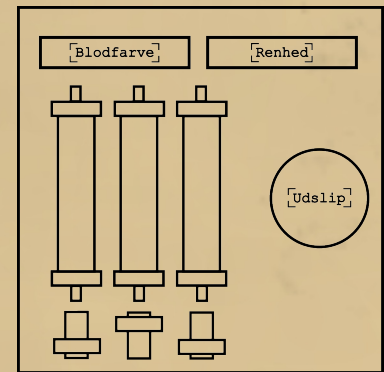


1. Hvis blodfarven er grøn og renhedsniveauet er middel, frigiv den venstre og den midterste gas.
2. Hvis kontrolpanelet drives af mere end to strømforsyninger, og renhedsniveauet er rent, frigiv alle gasser.
3. Hvis blodfarven er rød og mindst tre RAD-indikatorer lyser, frigiv ingen gasser.
4. Hvis der kun er én strømforsyning på panelet, og ingen BIO-indikatorer lyser, frigiv kun den midterste gas.
5. Hvis blodfarven er gul, eller renhedsniveauet er lavt, frigiv den venstre og den højre gas.
6. Hvis renhedsniveauet er nul, og kun to RAD-indikatorer lyser, frigiv kun den venstre gas.
7. Hvis blodfarven er blå, og renhedsniveauet er højt, frigiv den midterste og den højre gas.
8. Hvis ingen af ovenstående betingelser gælder, frigiv kun den højre gas.

Instruktioner om anomalier


1. Se på symbolet på skærmen og følg instruktionerne fra Trin 1.

2. Brug de oplysninger, du har indsamlet, og følg instruktionerne fra Trin 2 for at afgøre, hvilken anomali det er.

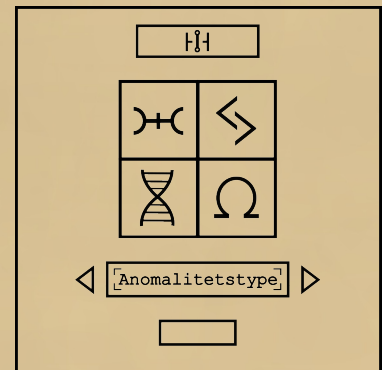

Trin 1:

- Symbolet på skærmen repræsenterer den kolonne, det er placeret i.
- Af de fire symboler, der vises for teknikeren, skal du trykke på knappen med det symbol, der ikke hører til den kolonne.
- Gentag denne proces så mange gange som nødvendigt, og fortsæt derefter til Trin 2.

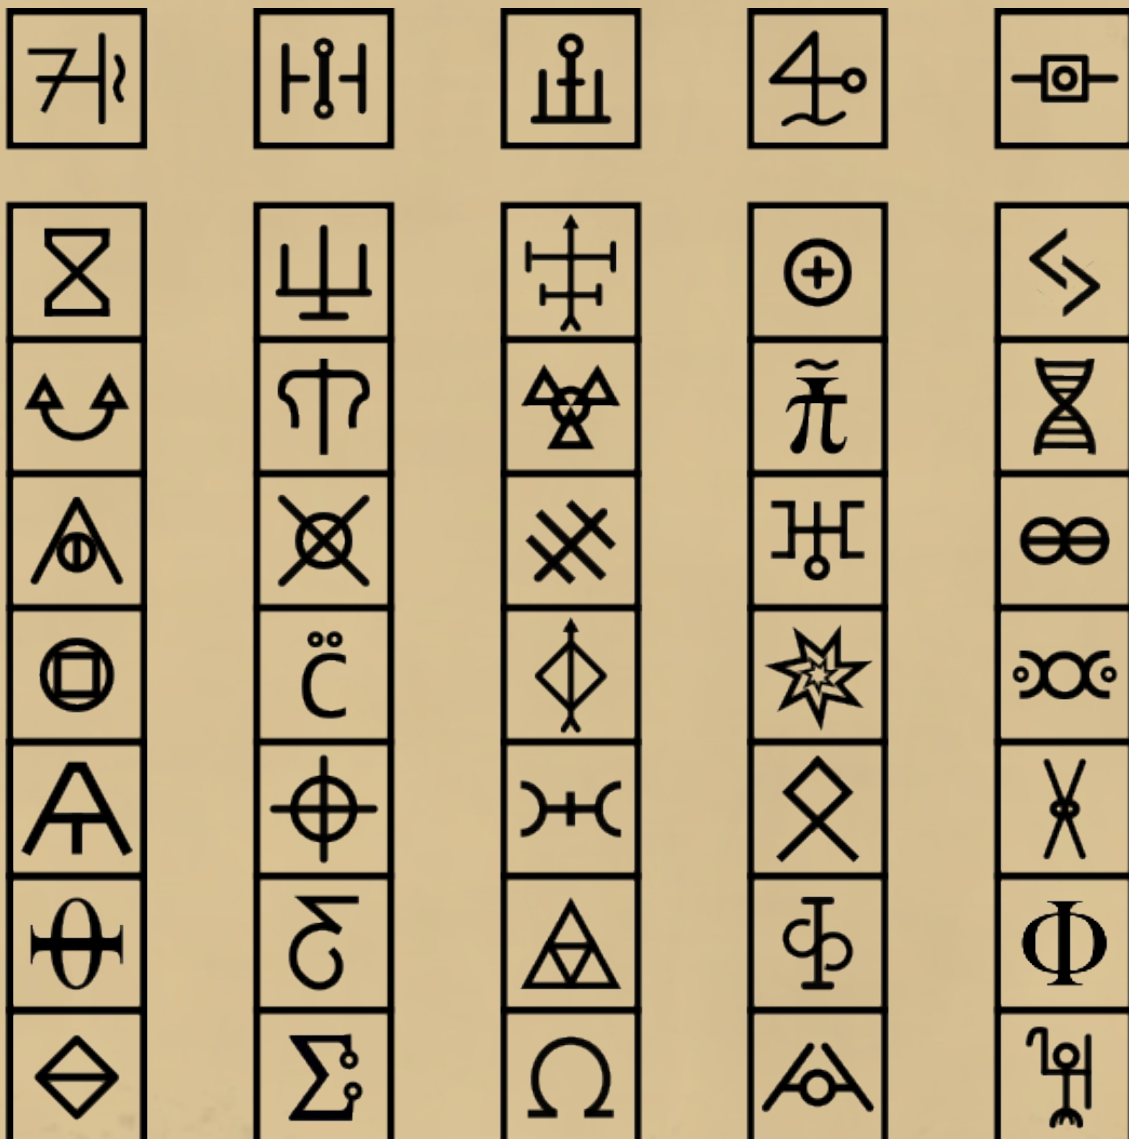

Trin 2:

- Identificér anomalien ud fra den gruppe, der indeholder alle tre trykkede symboler, indtast den på modulets display, og bekræft.

Anomalitetstyper:


Leach



Mycrotide



Crack

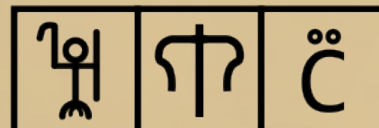

Loop



Phase




Skin



Breach



Worm

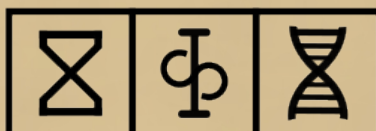

Stink



Glitch



Time




Unknown




Instruktioner om kraftfelter


- Følg instruktionerne nedenfor baseret på kabelens farve.
- Hvis der ikke er noget kabel at klippe, skal du klippe det nederste kabel.

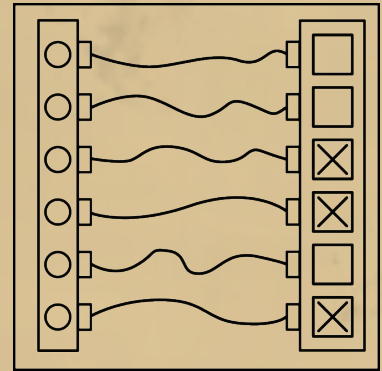


Rødt kabel:

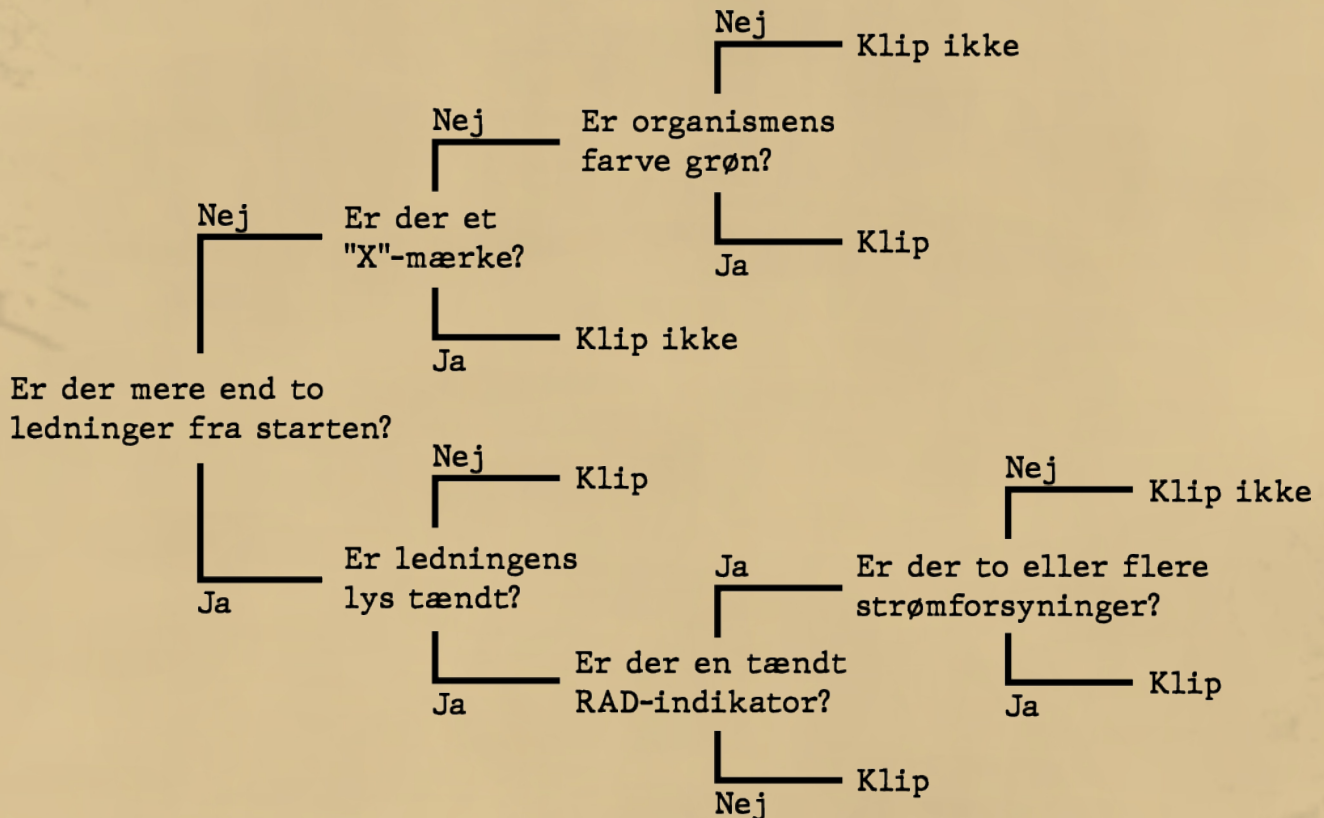

Blåt kabel:

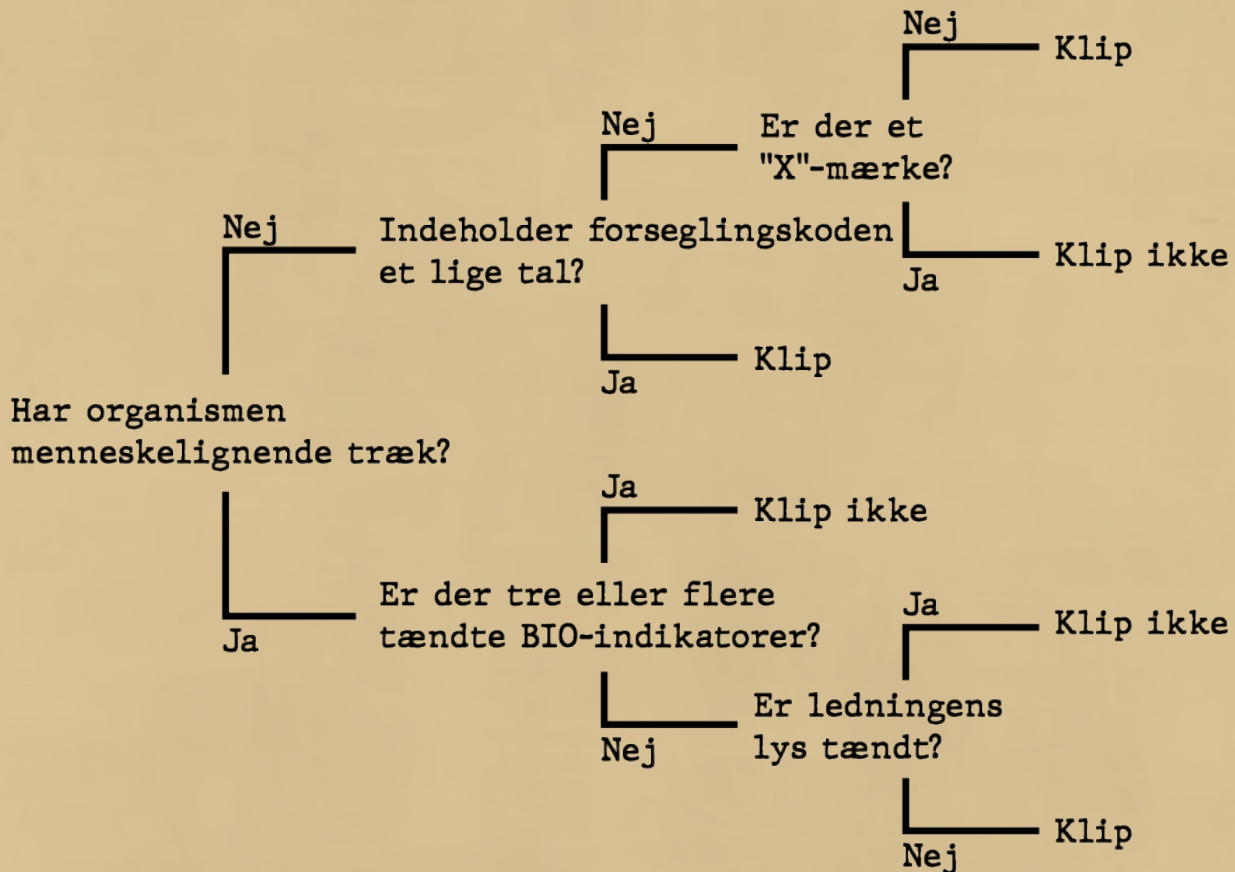


Gult kabel:

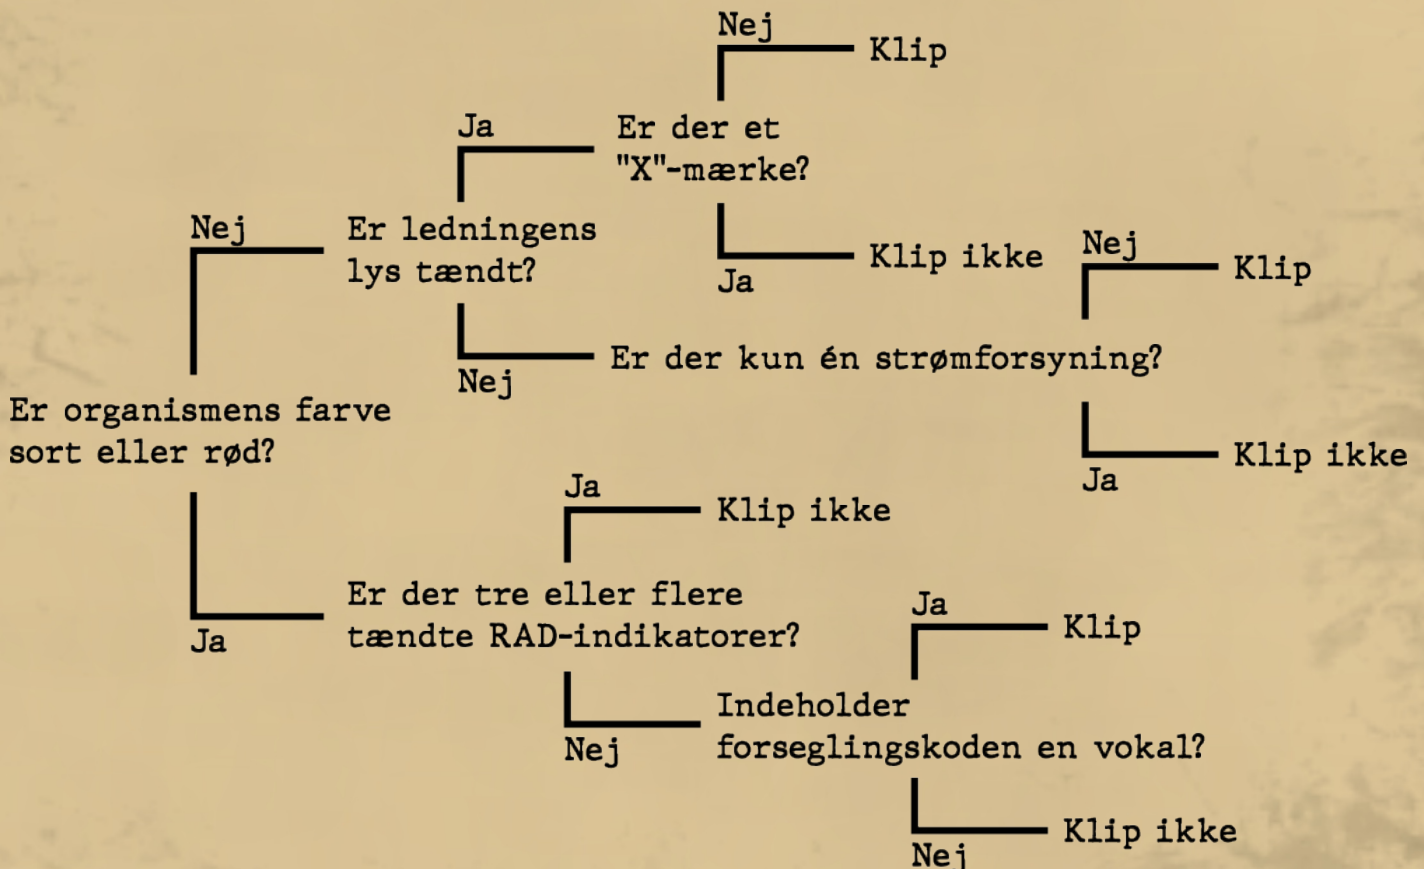

Instruktioner om forholdene

• Brug oplysningerne fra tryk- og temperaturindikatorerne på modulet til at flytte skyderne til de korrekte positioner.

• Hvis en skyder når helt til toppen eller bunden, skal du fortsætte med at tælle fra den modsatte ende.

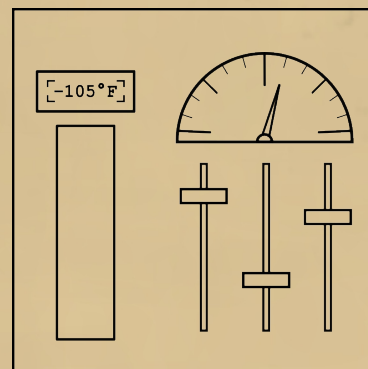

• Flyt hver skyder forsigtigt, da trykket og temperaturen vil ændre sig, og den må ikke slippes i en forkert position.

	Hvis temperaturen er mellem 150°F og 75°F	Hvis temperaturen er mellem 75°F og 0°F	Hvis temperaturen er mellem 0°F og -75°F	Hvis temperaturen er mellem -75°F og -150°F
Hvis trykket er mellem 0 og 45 PSI	Juster den 2. skyder med +4 positioner.	Juster den 1. skyder med -3 positioner.	Juster den 3. skyder med +7 positioner.	Juster den 2. skyder med -9 positioner.
Hvis trykket er mellem 45 og 90 PSI	Juster den 1. skyder med +1 position.	Juster den 3. skyder med -5 positioner.	Juster den 2. skyder med +8 positioner.	Juster den 1. skyder med +6 positioner.
Hvis trykket er mellem 90 og 135 PSI	Juster den 3. skyder med -2 positioner.	Juster den 2. skyder med -1 position.	Juster den 1. skyder med -7 positioner.	Juster den 3. skyder med +9 positioner.
Hvis trykket er mellem 135 og 180 PSI	Juster den 2. skyder med +2 positioner.	Juster den 1. skyder med -9 positioner.	Juster den 3. skyder med +3 positioner.	Juster den 2. skyder med -6 positioner.


Instruktioner om DNA-sekvensen

1. Vælg den korrekte tabel baseret på DNA-farven.

2. Tryk på knappen, der svarer til den base, der blinker på skærmen.

3. Ved hvert korrekt tryk vises en ny base, som tilføjes efter den tidligere indtastede base og danner en sekvens.

4. Hver gang en ny base tilføjes, skal sekvensen indtastes igen fra begyndelsen, indtil modulet er fuldført.

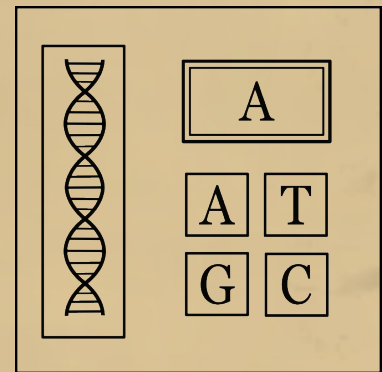

Rødt DNA:

Hvis forseglingsskoden indeholder en vokal:

Hvis forseglingsskoden ikke indeholder en vokal:

Base A	Base G	Base T	Base C
G	A	C	T
C	G	A	T

Gult DNA:

Hvis forseglingsskoden indeholder et lige tal:

Hvis forseglingsskoden ikke indeholder et lige tal:

Base A	Base G	Base T	Base C
A	C	G	T
T	A	C	G

Blåt DNA:

Hvis summen af tallene i forseglingsskoden er lige:

Hvis summen af tallene i forseglingsskoden er ulige:

Base A	Base G	Base T	Base C
A	G	T	C
G	A	T	C

Lilla DNA:



Hvis det sidste bogstav i forseglingsskoden er en vokal:

Hvis det sidste bogstav i forseglingsskoden er en konsonant:

Base A	Base G	Base T	Base C
T	C	G	A
C	T	A	G



Instruktioner til tastaturet

- Match de lysende knapper med de sorte felter for at finde det korrekte tastatur.
- Tryk på knapperne markeret med "X".
- Gentag indtil modulet er fuldført.

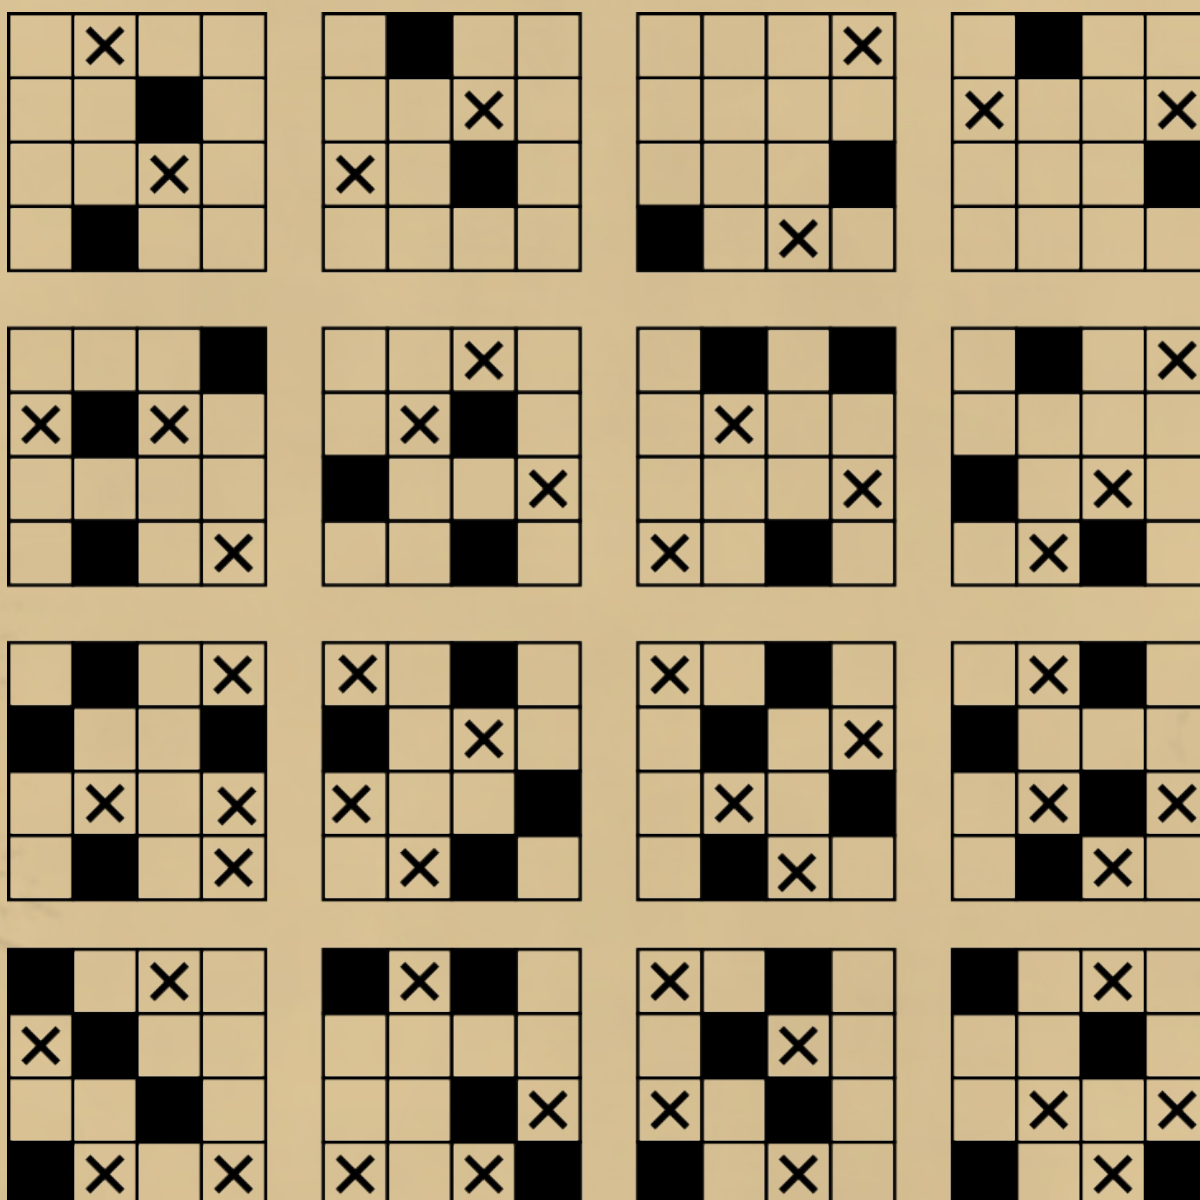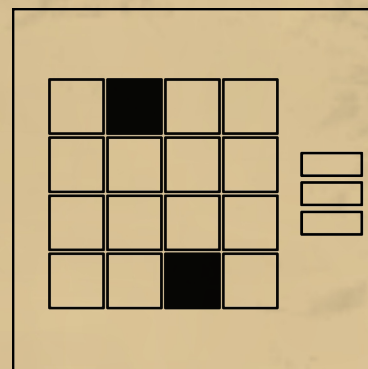


Instruktioner for kompasset


- Placeringen af lysene omkring kompasset angiver, hvilken af de 4 kontakter der skal drejes.
- Lysenes placering bestemmes af den retning, kompasset peger i.
- Når alle kontakter er drejet, er modulet fuldført.
- Kodningsrækkefølge for kontakterne:

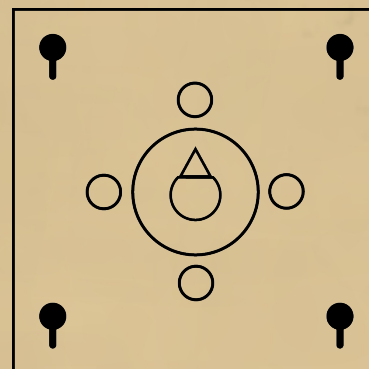


• Drej D

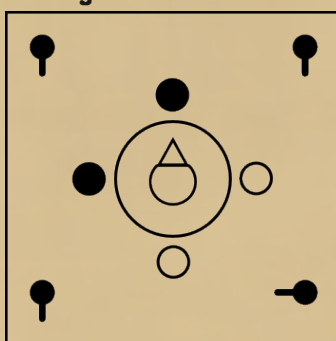


• Drej A

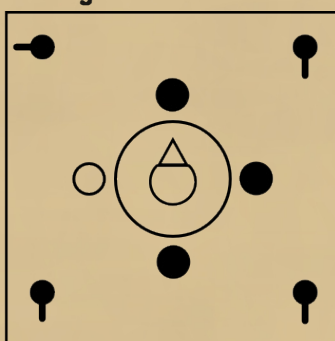


• Drej C

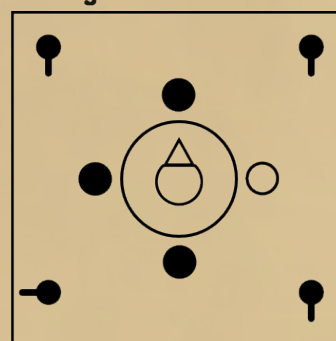


• Drej B

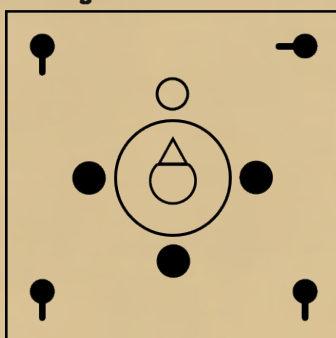


• Drej A

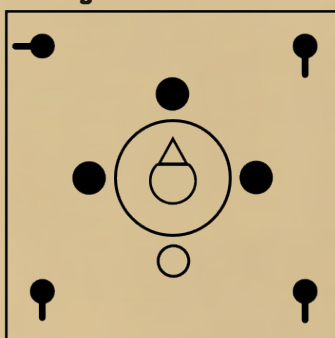


• Drej C

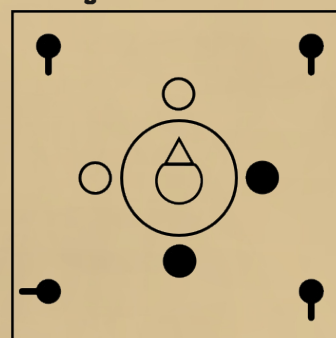

• Drej B

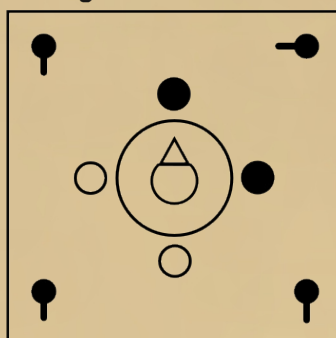


• Drej D

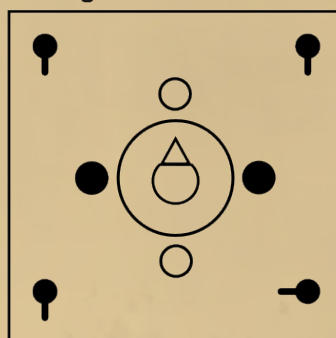

Instruktioner om bølger

- Rækkefølgen, som lysene på modulets tre paneler tændes i, bestemmer den rækkefølge, panelerne skal løses i.
- For panelet, der skal løses, skal du vælge den relevante sektion fra tabellen nedenfor baseret på antallet af chips nederst på panelet og følge instruktionerne.

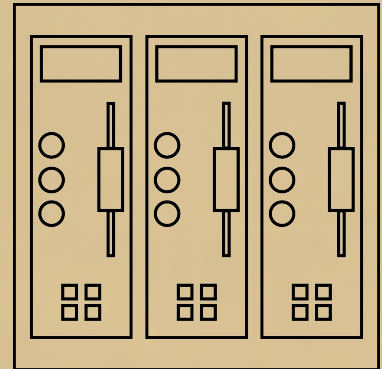

1 chip:

- Hvis bølgelængden er kort, tryk på den nederste knap 1 gang.
- Ellers, hvis der er mindst 2 strømkilder, tryk på den midterste knap 3 gange.
- Ellers, tryk på den øverste knap 2 gange.

2 chip:

- Hvis amplituden er høj, tryk på den midterste knap 1 gang.
- Ellers, hvis koden indeholder et lige tal, tryk på den øverste knap 1 gang.
- Ellers, hvis bølgelængden er lang, tryk først på den øverste knap og derefter straks på den midterste knap.
- Ellers, tryk på den nederste knap 3 gange.

3 chip:

- Hvis prioriteten er 1., tryk på den øverste knap 2 gange.
- Ellers, hvis bølgelængden er kort og amplituden er høj, tryk først på den øverste knap og derefter straks på den nederste knap.
- Ellers, hvis bølgelængden er lang eller amplituden er lav, tryk på den øverste knap 2 gange og derefter den midterste knap 1 gang.
- Ellers, tryk på alle knapper fra nederst til øverst.

4 chip:

- Hvis amplituden er lav, tryk på den midterste knap 1 gang.
- Ellers, hvis der ikke er nogen bølger, tryk på den midterste knap 1 gang og derefter den nederste knap 2 gange.
- Ellers, hvis prioriteten er 2., tryk på alle knapper fra øverst til nederst.
- Ellers, tryk på den nederste knap 3 gange.


FORVRÆNGNINGER

Når visse livsformer i laboratoriet mister stabilitet, udløser de forvrængninger i det omgivende miljø.

Modforanstaltningerne for de problemer, som disse forvrængninger kan skabe i laboratoriet, er angivet nedenfor.


Forvrængninger

- Hold knappen nede, indtil trykniveauet vender tilbage til normalt.

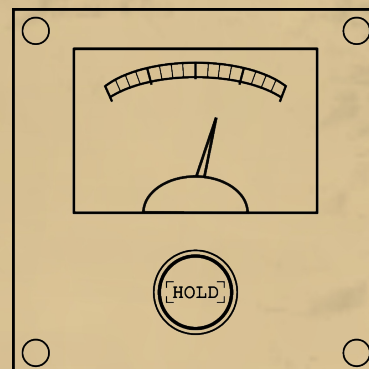


Forvrængninger

- Tryk kun på den blinkende knap for at stabilisere livsformen.

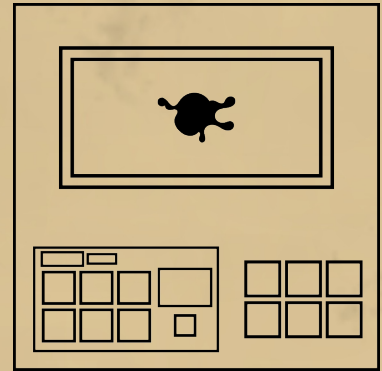


Forvrængninger

- Tænd kun for kontakterne på panelet, hvis lys blinker.

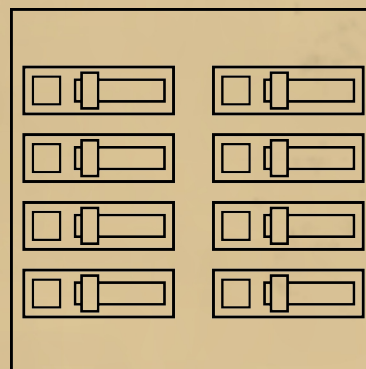


Forvrængninger

- Sæt de udslyngede rør tilbage i deres pladser, og sænk derefter håndtaget på siden for at fastgøre dem.

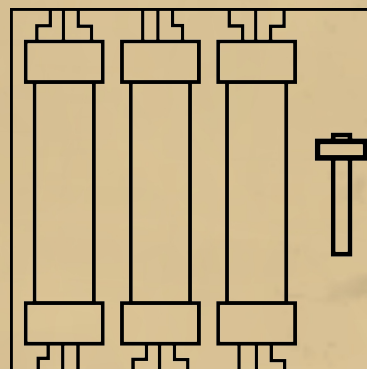

Forvrængninger

- Tænd og sluk for kontakterne i henhold til tallene på dem for at justere niveauet på den højre måler, så det matcher den venstre.

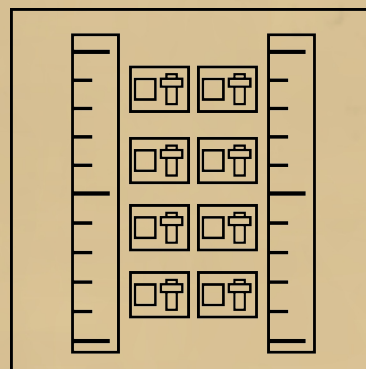

Information om indikatorer


RAD- og BIO-indikatorer er placeret på kontrolpanelet og giver information om subjektet og det miljø, hvori subjektet opbevares.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Information om strømforsyninger

Strømforsyninger leverer strøm til kontrolpanelet, og deres antal kan variere afhængigt af indeslutningsforholdene for objektet. De er placeret nederst på kontrolpanelet.

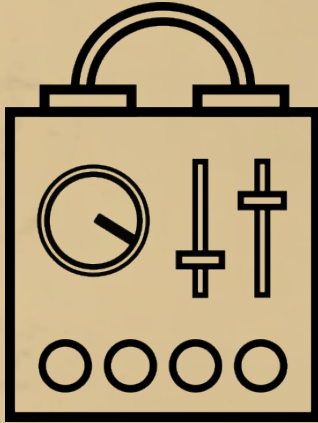

Information om forseglingskoden

Forseglingskoden er en subjekt-specifik identifikator, der tildeles hvert subjekt og fungerer som en unik reference, der giver information om dem. Den er placeret øverst i observationsvinduet.

BZ3-D6X

Liste over vokaler:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Information om selvdestruktionsmekanismen

Selvdestruktionsknappen bruges til at ødelægge både subjektet og observationskammeret for at forhindre, at subjektet undslipper. Den bør kun anvendes som en sidste udvej.

