

KEEP IT CONTAINED

BUKU PROTOKOL

Buku protokol ini menyertai permainan Keep It Contained dan diperlukan untuk pengoperasian yang benar.

PROTOKOL KESELAMATAN BIOLOGIS KRITIS

Panduan ini akan menjadi satu-satunya sumber dukungan Anda untuk menjaga bentuk kehidupan tak dikenal tetap terkendali ketika mereka mencoba melewati garis karantina.

Anda adalah operator; protokol yang berlaku untuk setiap skenario yang mungkin Anda hadapi dapat ditemukan di sini.

INFORMASI UMUM TENTANG MODUL

Modul terletak di bagian atas panel kontrol. Tujuan utama yang harus Anda selesaikan untuk menahan organisme adalah modul-modul tersebut.

Modul yang Anda temui dapat berbeda di setiap level dan umumnya bersifat acak.

Informasi rinci tentang modul tersedia pada halaman 4-9.

INFORMASI UMUM TENTANG LINGKUNGAN


Detail yang Anda lihat di lingkungan dapat memengaruhi penyelesaian modul atau membuatnya lebih sulit untuk diselesaikan.

Informasi rinci tentang lingkungan tersedia pada halaman 10-13.

Disarankan untuk membacanya terlebih dahulu agar Anda siap.

Petunjuk Tentang Koneksi Kabel

- Modul ini berisi empat kabel dan empat slot input.
- Setiap slot input ditandai dengan sebuah simbol.
- Simbol diurutkan dari kiri ke kanan dan harus dijelaskan dalam urutan ini.
- Kolom di bawah menunjukkan urutan prioritas simbol.
- Jika simbol yang dijelaskan berada pada posisi tertinggi di salah satu kolom, simbol tersebut harus dihubungkan ke kabel dengan warna yang ditentukan di kolom tersebut. Jika ada kabel yang sudah terhubung ke sebuah simbol, kolom tersebut harus diabaikan.

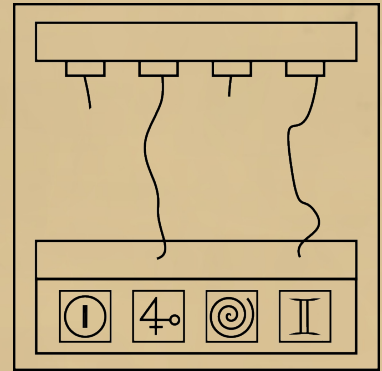

Hijau

Kuning

Biru

Merah

Ⓢ
♀°
Ⅱ
☉
⋅Ⅰ⋅
☉
⧻
♀°

☉
☉
⋅Ⅰ⋅
♀°
⧻
♀°
Ⓢ
Ⅱ


♀°
Ⅱ
☉
⧻
☉
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
♀°

☉
♀°
☉
♀°
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
Ⅱ
⧻

Petunjuk Tentang Pelepasan Gas

- Modul ini berisi tiga tabung gas berwarna, masing-masing dikendalikan oleh sebuah sakelar.

- Layar di kiri atas menunjukkan warna darah. Layar di kanan atas menunjukkan tingkat kemurnian.

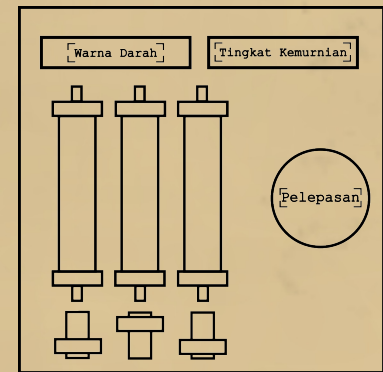

- Untuk memilih gas yang akan dilepaskan, sakelar di bawah setiap tabung gas harus diturunkan.

- Tekan tombol merah untuk melepaskan gas yang dipilih.

- Baca aturan secara berurutan dan jalankan instruksi pertama yang berlaku.

1. Jika warna darah hijau dan tingkat kemurnian sedang, lepaskan gas kiri dan tengah.

2. Jika panel kontrol ditenagai oleh lebih dari dua sumber daya dan tingkat kemurnian murni, lepaskan semua gas.

3. Jika warna darah merah dan setidaknya tiga indikator RAD menyala, jangan lepaskan gas apa pun.

4. Jika hanya ada satu sumber daya di panel dan tidak ada indikator BIO yang menyala, lepaskan hanya gas tengah.

5. Jika warna darah kuning atau tingkat kemurnian rendah, lepaskan gas kiri dan kanan.


6. Jika tingkat kemurnian nol dan hanya dua indikator RAD yang menyala, lepaskan hanya gas kiri.

7. Jika warna darah biru dan tingkat kemurnian tinggi, lepaskan gas tengah dan kanan.

8. Jika tidak ada kondisi di atas yang berlaku, lepaskan hanya gas kanan.


Petunjuk Tentang Anomali

1. Lihat simbol yang muncul di layar dan ikuti instruksi pada Langkah 1.
2. Dengan menggunakan informasi yang telah Anda kumpulkan, ikuti instruksi pada Langkah 2 untuk menentukan jenis anomali.

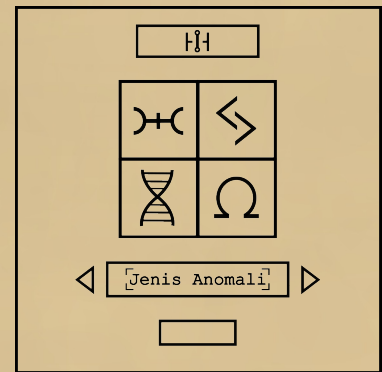

Langkah 1

- Simbol di layar mewakili kolom tempat simbol tersebut berada.
- Dari empat simbol yang ditunjukkan kepada teknisi, tekan tombol dengan simbol yang tidak termasuk dalam kolom tersebut.
- Ulangi proses ini sebanyak yang diperlukan, lalu lanjut ke Langkah 2.

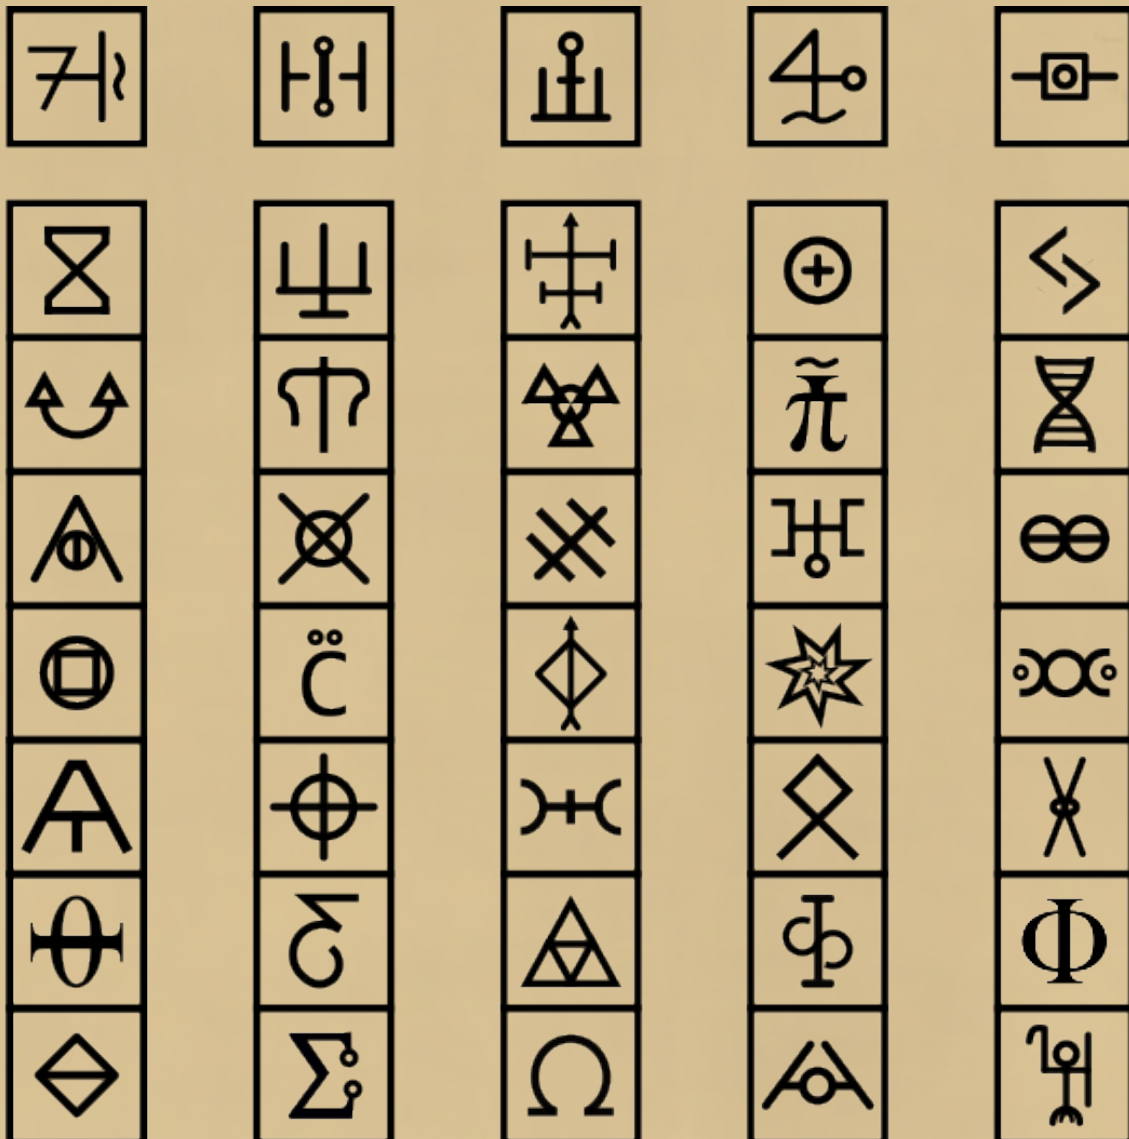

Langkah 2


- Identifikasi anomali berdasarkan kelompok yang berisi ketiga simbol yang ditekan, lalu masukkan ke layar modul dan konfirmasi.

Jenis-Jenis Anomali

Leach




Mycrotide

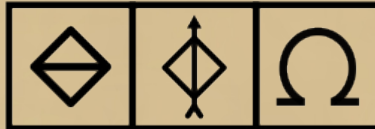

Crack



Loop

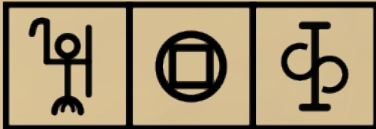

Phase




Skin



Breach



Worm

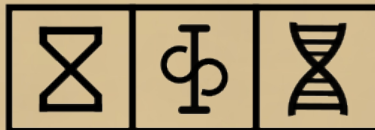

Stink



Glitch



Time




Unknown




Petunjuk Tentang Medan Gaya


- Ikuti instruksi di bawah ini berdasarkan warna kabel.
- Jika tidak ada kabel untuk dipotong, potong kabel yang paling bawah.

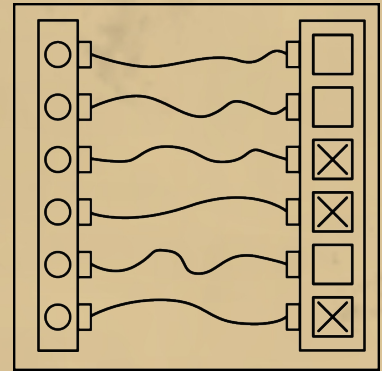


Kabel Merah

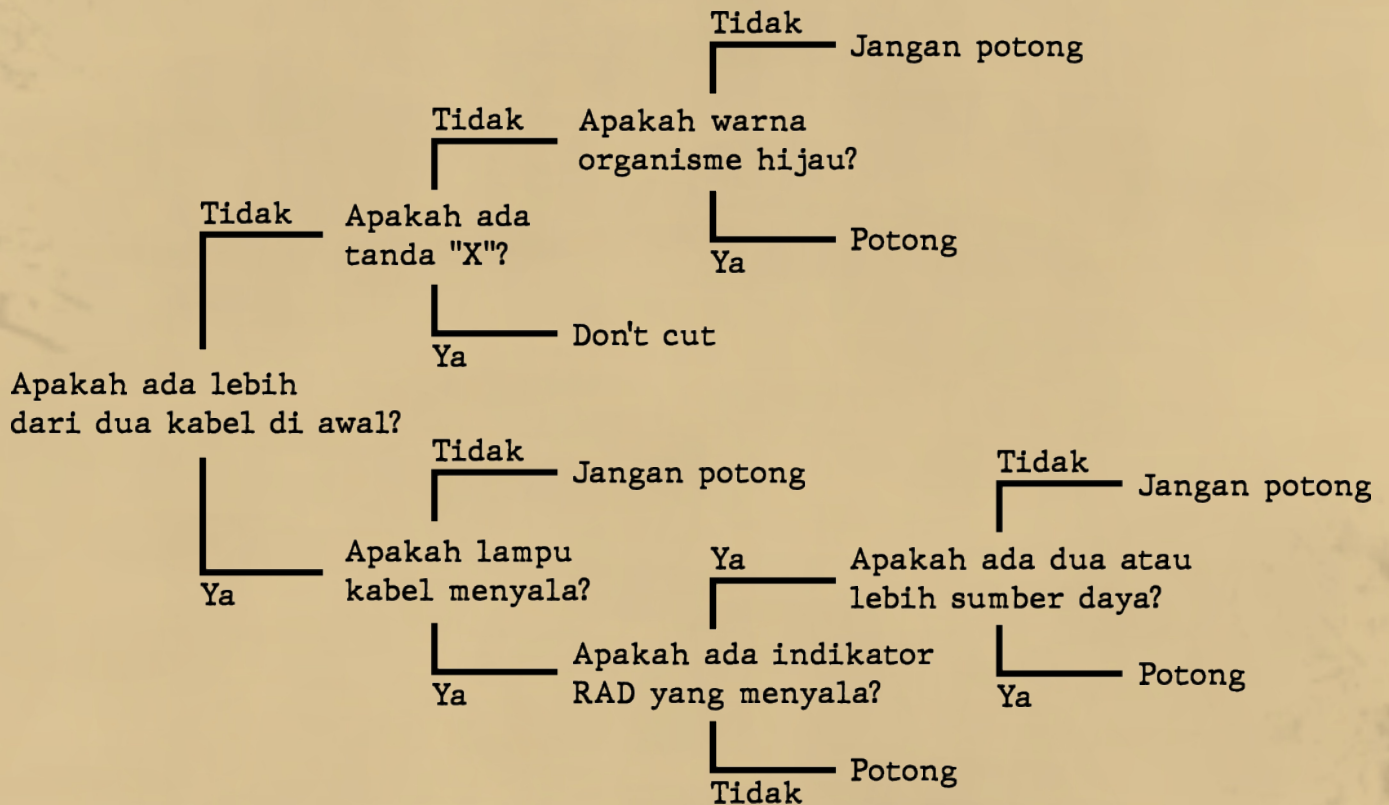

Kabel Biru

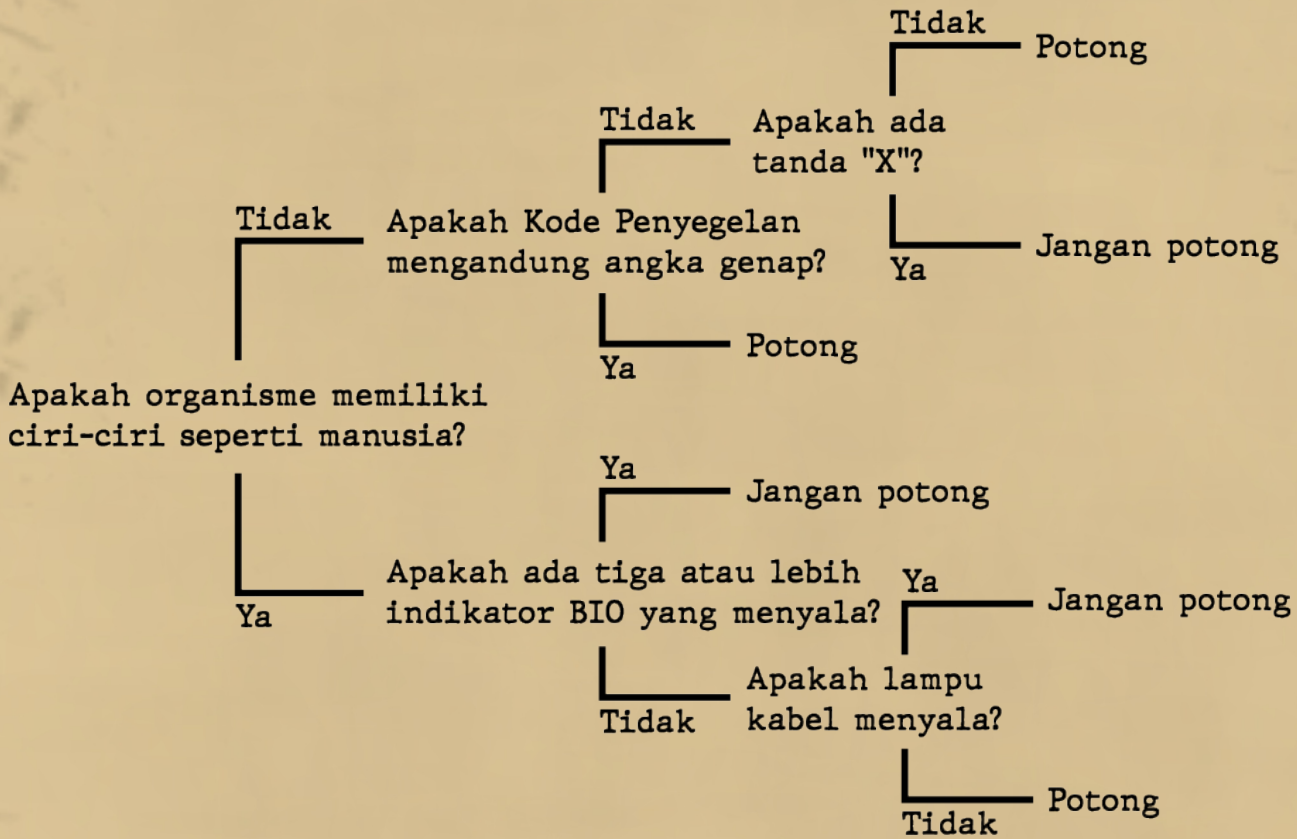

Kabel Kuning

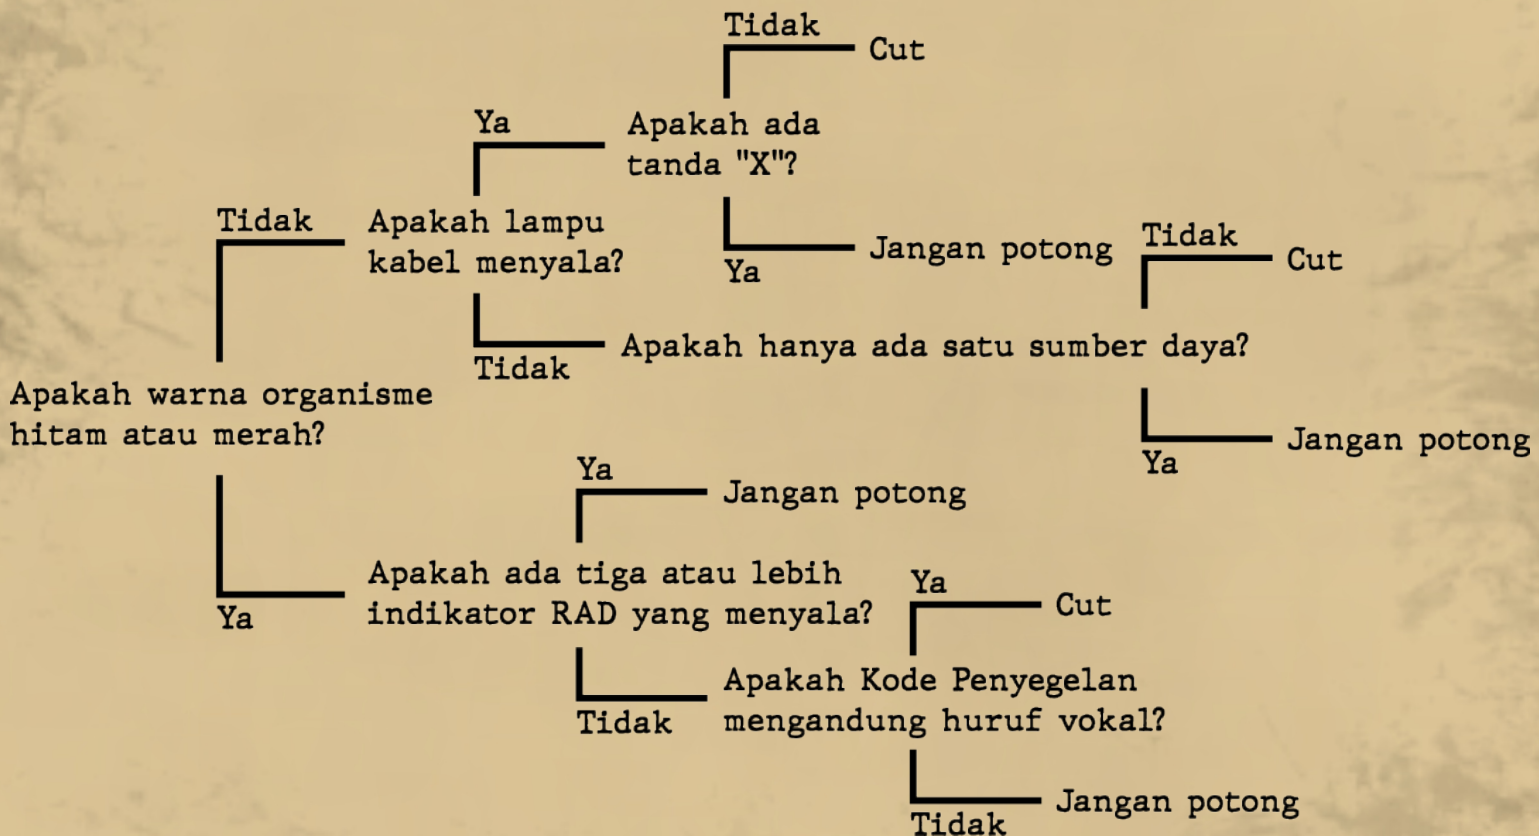


Instruksi tentang kondisi

• Gunakan informasi dari indikator tekanan dan suhu pada modul untuk memindahkan slider ke posisi yang benar.

• Jika slider mencapai bagian paling atas atau bawah, lanjutkan menghitung dari sisi yang berlawanan.

• Pindahkan setiap slider dengan hati-hati, karena tekanan dan suhu akan berubah dan tidak boleh dilepaskan pada posisi yang salah.

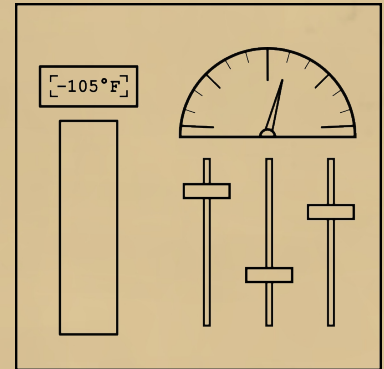

	Jika suhu berada antara 150°F dan 75°F	Jika suhu berada antara 75°F dan 0°F	Jika suhu berada antara 0°F dan -75°F	Jika suhu berada antara -75°F dan -150°F
Jika tekanan berada antara 0 dan 45 PSI	Sesuaikan slider ke-2 sebesar +4 posisi.	Sesuaikan slider ke-1 sebesar -3 posisi.	Sesuaikan slider ke-3 sebesar +7 posisi.	Sesuaikan slider ke-2 sebesar -9 posisi.
Jika tekanan berada antara 45 dan 90 PSI	Sesuaikan slider ke-1 sebesar +1 posisi.	Sesuaikan slider ke-3 sebesar -5 posisi.	Sesuaikan slider ke-2 sebesar +8 posisi.	Sesuaikan slider ke-1 sebesar +6 posisi.
Jika tekanan berada antara 90 dan 135 PSI	Sesuaikan slider ke-3 sebesar -2 posisi.	Sesuaikan slider ke-2 sebesar -1 posisi.	Sesuaikan slider ke-1 sebesar -7 posisi.	Sesuaikan slider ke-3 sebesar +9 posisi.
Jika tekanan berada antara 135 dan 180 PSI	Sesuaikan slider ke-2 sebesar +2 posisi.	Sesuaikan slider ke-1 sebesar -9 posisi.	Sesuaikan slider ke-3 sebesar +3 posisi.	Sesuaikan slider ke-2 sebesar -6 posisi.


Instruksi tentang urutan DNA

1. Pilih tabel yang benar berdasarkan warna DNA.

2. Tekan tombol yang sesuai dengan basa yang berkedip di layar.

3. Setiap kali menekan dengan benar, basa baru akan muncul dan ditambahkan setelah basa sebelumnya, membentuk sebuah urutan.

4. Setiap kali basa baru ditambahkan, urutan harus dimasukkan kembali dari awal hingga modul selesai.

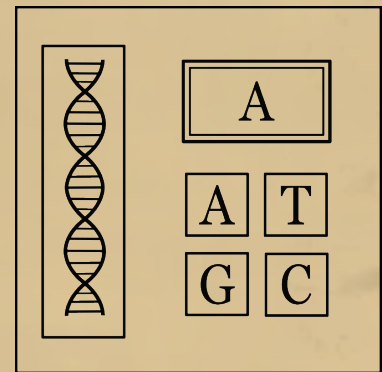

DNA merah:

Jika kode penyegelan mengandung huruf vokal:

Jika kode penyegelan tidak mengandung huruf vokal:

Basa A	Basa G	Basa T	Basa C
G	A	C	T
C	G	A	T

DNA kuning:

Jika kode penyegelan mengandung angka genap:

Jika kode penyegelan tidak mengandung angka genap:

Basa A	Basa G	Basa T	Basa C
A	C	G	T
T	A	C	G

DNA biru:

Jika jumlah angka dalam kode penyegelan adalah genap:

Jika jumlah angka dalam kode penyegelan adalah ganjil:

Basa A	Basa G	Basa T	Basa C
A	G	T	C
G	A	T	C

DNA ungu:


















Jika huruf terakhir dari kode penyegelan adalah vokal:

Jika huruf terakhir dari kode penyegelan adalah konsonan:

Basa A	Basa G	Basa T	Basa C
T	C	G	A
C	T	A	G


Instruksi pada keypad

- Cocokkan tombol yang menyala dengan kotak hitam untuk menemukan keypad yang benar.
- Tekan tombol yang bertanda "X".
- Ulangi hingga modul selesai.

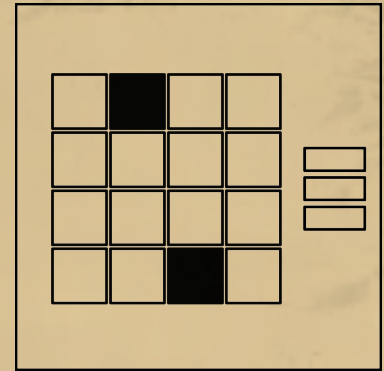


Instruksi pada kompas


- Posisi lampu di sekitar kompas menunjukkan sakelar mana dari 4 yang harus diputar.
- Posisi lampu ditentukan berdasarkan arah yang dihadapi kompas.
- Ketika semua sakelar telah diputar, modul selesai.

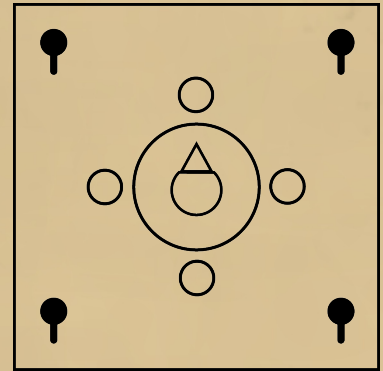


- Urutan pengkodean sakelar:




- Putar D

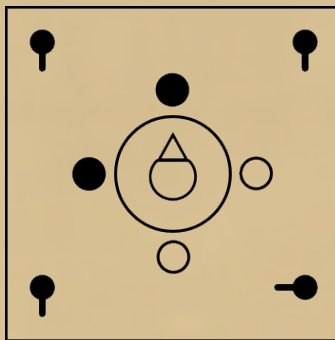


- Putar A

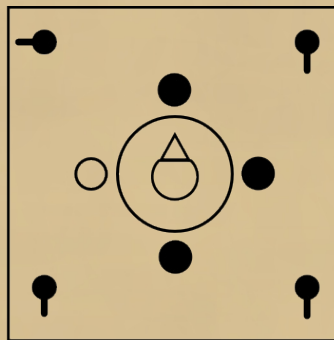


- Putar C

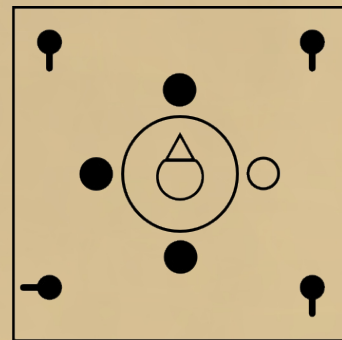


- Putar B

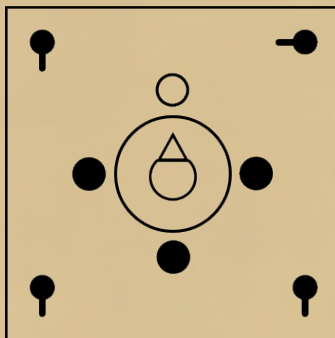


- Putar A

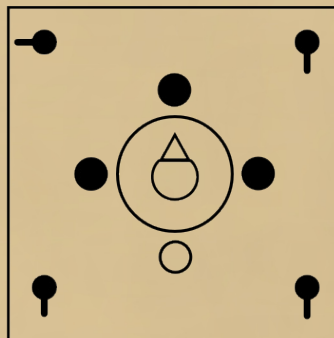


- Putar C

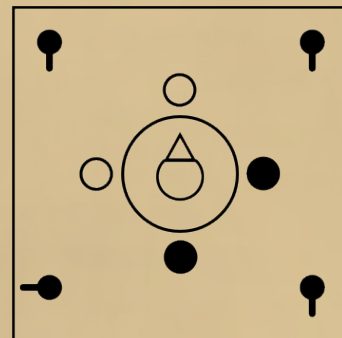

- Putar B

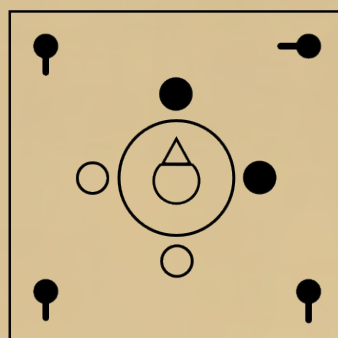


- Putar D

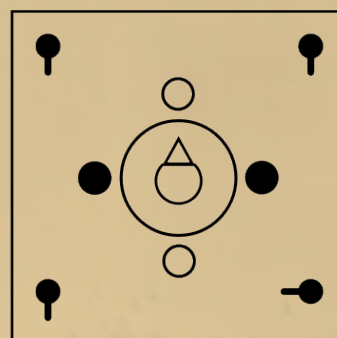

Instruksi tentang gelombang

- Urutan lampu pada tiga panel di modul menyala menentukan urutan panel yang harus diselesaikan.
- Untuk panel yang akan diselesaikan, pilih bagian yang sesuai dari tabel di bawah ini berdasarkan jumlah chip yang terletak di bagian bawah panel tersebut dan ikuti instruksi.

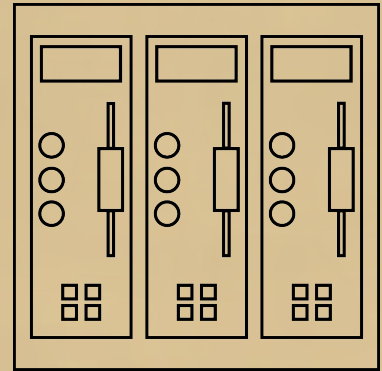

1 chip:

- Jika panjang gelombang pendek, tekan tombol bawah 1 kali.
- Jika tidak, jika ada minimal 2 sumber daya, tekan tombol tengah 3 kali.
- Jika tidak, tekan tombol atas 2 kali.

2 chip:

- Jika amplitudo tinggi, tekan tombol tengah 1 kali.
- Jika tidak, jika kode berisi angka genap, tekan tombol atas 1 kali.
- Jika tidak, jika panjang gelombang panjang, tekan tombol atas lalu segera tombol tengah.
- Jika tidak, tekan tombol bawah 3 kali.

3 chip:

- Jika prioritas adalah ke-1, tekan tombol atas 2 kali.
- Jika tidak, jika panjang gelombang pendek dan amplitudo tinggi, tekan tombol atas lalu segera tombol bawah.
- Jika tidak, jika panjang gelombang panjang atau amplitudo rendah, tekan tombol atas 2 kali lalu tombol tengah 1 kali.
- Jika tidak, tekan semua tombol dari bawah ke atas.

4 chip:

- Jika amplitudo rendah, tekan tombol tengah 1 kali.
- Jika tidak, jika tidak ada gelombang, tekan tombol tengah 1 kali lalu tombol bawah 2 kali.
- Jika tidak, jika prioritas ke-2, tekan semua tombol dari atas ke bawah.
- Jika tidak, tekan tombol bawah 3 kali.


DISTORSI

Ketika bentuk kehidupan tertentu di dalam laboratorium kehilangan stabilitas, mereka memicu distorsi di lingkungan sekitarnya.

Tindakan penanggulangan untuk masalah yang mungkin ditimbulkan oleh distorsi ini di dalam laboratorium tercantum di bawah ini.


Distorsi

- Tahan tombol hingga tingkat tekanan kembali normal.

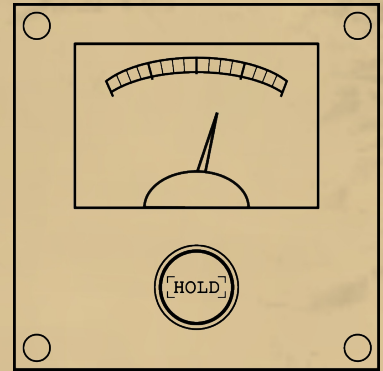


Distorsi

- Tekan hanya tombol yang berkedip untuk menstabilkan bentuk kehidupan.

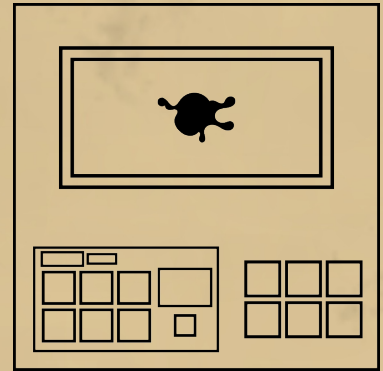


Distorsi

- Nyalakan hanya sakelar pada panel yang lampunya berkedip.

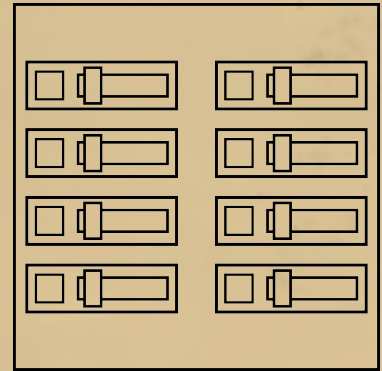


Distorsi

- Masukkan kembali tabung yang terlepas ke tempatnya, lalu turunkan tuas di samping untuk menguncinya.

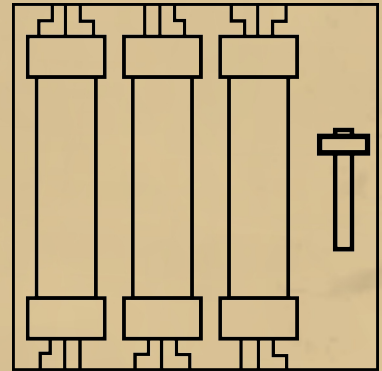



Distorsi

- Nyalakan dan matikan sakelar sesuai angka yang tertera untuk menyamakan level meter kanan dengan yang kiri.

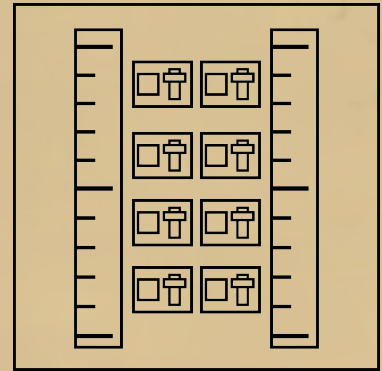


Informasi Tentang Indikator

Indikator RAD dan BIO terletak di panel kontrol dan memberikan informasi tentang subjek serta lingkungan tempat subjek tersebut disimpan.

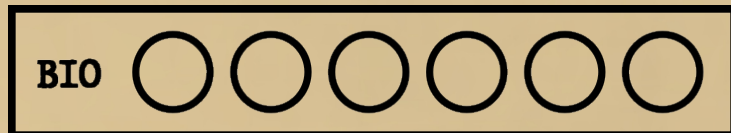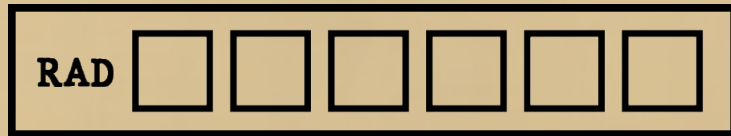

Informasi Tentang Sumber Daya

Sumber daya menyediakan listrik untuk panel kontrol, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi penahanan subjek. Sumber daya tersebut terletak di bagian bawah panel kontrol.

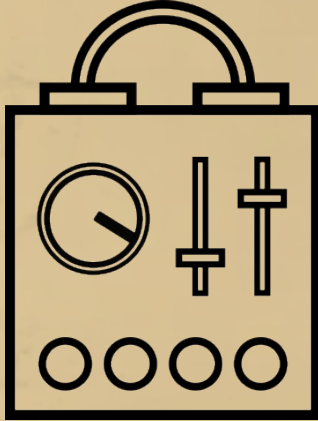

Informasi Tentang Kode Penyegelan

Kode Penyegelan adalah pengenal khusus yang diberikan kepada setiap subjek, berfungsi sebagai referensi unik yang memberikan informasi tentang mereka. Kode ini terletak di bagian atas jendela observasi.

BZ3-D6X

Daftar huruf vokal:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informasi Tentang Mekanisme Penghancuran Diri

Tombol Penghancuran Diri digunakan untuk menghancurkan subjek dan ruang observasi guna mencegah subjek melarikan diri. Tombol ini hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir.

