

KEEP IT CONTAINED

PROTOCOLHANDLEIDING

Deze protocolhandleiding hoort bij het spel Keep It Contained
en is vereist voor een correcte werking.

KRITIEKE BIOLOGISCHE VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN

Deze handleiding is je enige hulpmiddel om onbekende levensvormen onder controle te houden wanneer zij proberen de quarantainelijns te overschrijden.

Jij bent de operator; de toepasselijke protocollen voor elk scenario dat je kunt tegenkomen, zijn hier te vinden.

ALGEMENE INFORMATIE OVER MODULES

Modules bevinden zich bovenaan het bedieningspaneel. De modules zijn de hoofddoelen die je moet oplossen om de organismen in te dammen.

De modules die je tegenkomt kunnen per niveau verschillen en zijn over het algemeen willekeurig.

Gedetailleerde informatie over de modules staat op pagina 4-9.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OMGEVING


De details die je in je omgeving ziet kunnen de oplossing van de modules beïnvloeden of het oplossen ervan moeilijker maken.

Gedetailleerde informatie over de omgeving staat op pagina 10-13.

Het wordt aanbevolen dit vooraf te lezen om goed voorbereid te zijn.

Instructies voor draadverbindingen

- De module bevat vier draden en vier invoerslots.
- Elk invoerslot is gemarkeerd met een symbool.
- Symbolen zijn van links naar rechts gerangschikt en moeten in deze volgorde worden beschreven.
- De onderstaande kolommen geven de prioriteitsvolgorde van de symbolen aan.
- Als het beschreven symbool zich op de hoogste positie in een kolom bevindt, moet het worden verbonden met de draad van de kleur die in die kolom is aangegeven. Als een draad al met een symbool is verbonden, moet die kolom worden genegeerd.

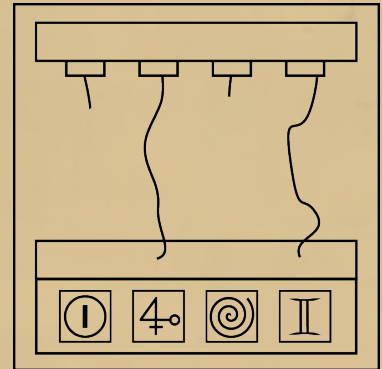

Groen

Geel

Blauw

Rood

Ⓢ
♀
Ⅱ
☉
⋅Ⅰ⋅
☉
⌘
♀


☉
☉
⋅Ⅰ⋅
♀
⌘
♀
Ⓢ
Ⅱ

♀
Ⅱ
☉
⌘
☉
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
♀

☉
♀
☉
♀
Ⓢ
⋅Ⅰ⋅
Ⅱ
⌘

Instructies voor gasvrijgave


- De module bevat drie gekleurde gascilinders, elk bediend door een schakelaar.
- Het scherm linksboven toont de kleur van het bloed. Het scherm rechtsboven toont het zuiverheidsniveau.

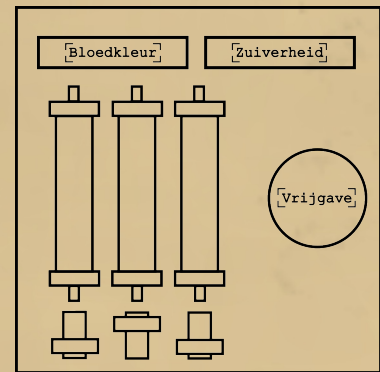

- Om de vrij te geven gassen te selecteren, moeten de schakelaars onder elke gascilinder omlaag worden gezet.
 - Druk op de rode knop om de geselecteerde gassen vrij te geven.
 - Lees de regels in volgorde en voer de eerste geldige instructie uit.
1. Als de bloedkleur groen is en het zuiverheidsniveau gemiddeld is, laat dan het linker- en middengas vrij.
 2. Als het bedieningspaneel wordt gevoed door meer dan twee stroomvoorzieningen en het zuiverheidsniveau zuiver is, laat dan alle gassen vrij.
 3. Als de bloedkleur rood is en er minstens drie RAD-indicatoren branden, laat dan geen gassen vrij.
 4. Als er slechts één stroomvoorziening op het paneel is en er geen BIO-indicatoren branden, laat dan alleen het middengas vrij.
 5. Als de bloedkleur geel is of het zuiverheidsniveau laag is, laat dan het linker- en rechtergas vrij.
 6. Als het zuiverheidsniveau nul is en slechts twee RAD-indicatoren branden, laat dan alleen het linkergas vrij.
 7. Als de bloedkleur blauw is en het zuiverheidsniveau hoog is, laat dan het midden- en rechtergas vrij.
 8. Als geen van de bovenstaande voorwaarden van toepassing is, laat dan alleen het rechtergas vrij.


Instructies voor anomalieën

1. Kijk naar het symbool dat op het scherm verschijnt en volg de instructies van Stap 1.
2. Gebruik de verzamelde informatie en volg de instructies van Stap 2 om te bepalen welke anomalie het is.

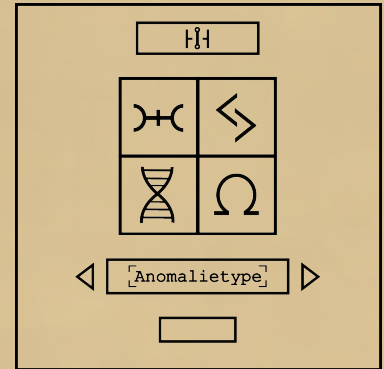

Stap 1

- Het symbool op het scherm vertegenwoordigt de kolom waarin het zich bevindt.
- Van de vier symbolen die aan de technicus worden getoond, druk je op de knop met het symbool dat niet bij die kolom hoort.
- Herhaal dit proces zo vaak als nodig en ga daarna verder naar Stap 2.

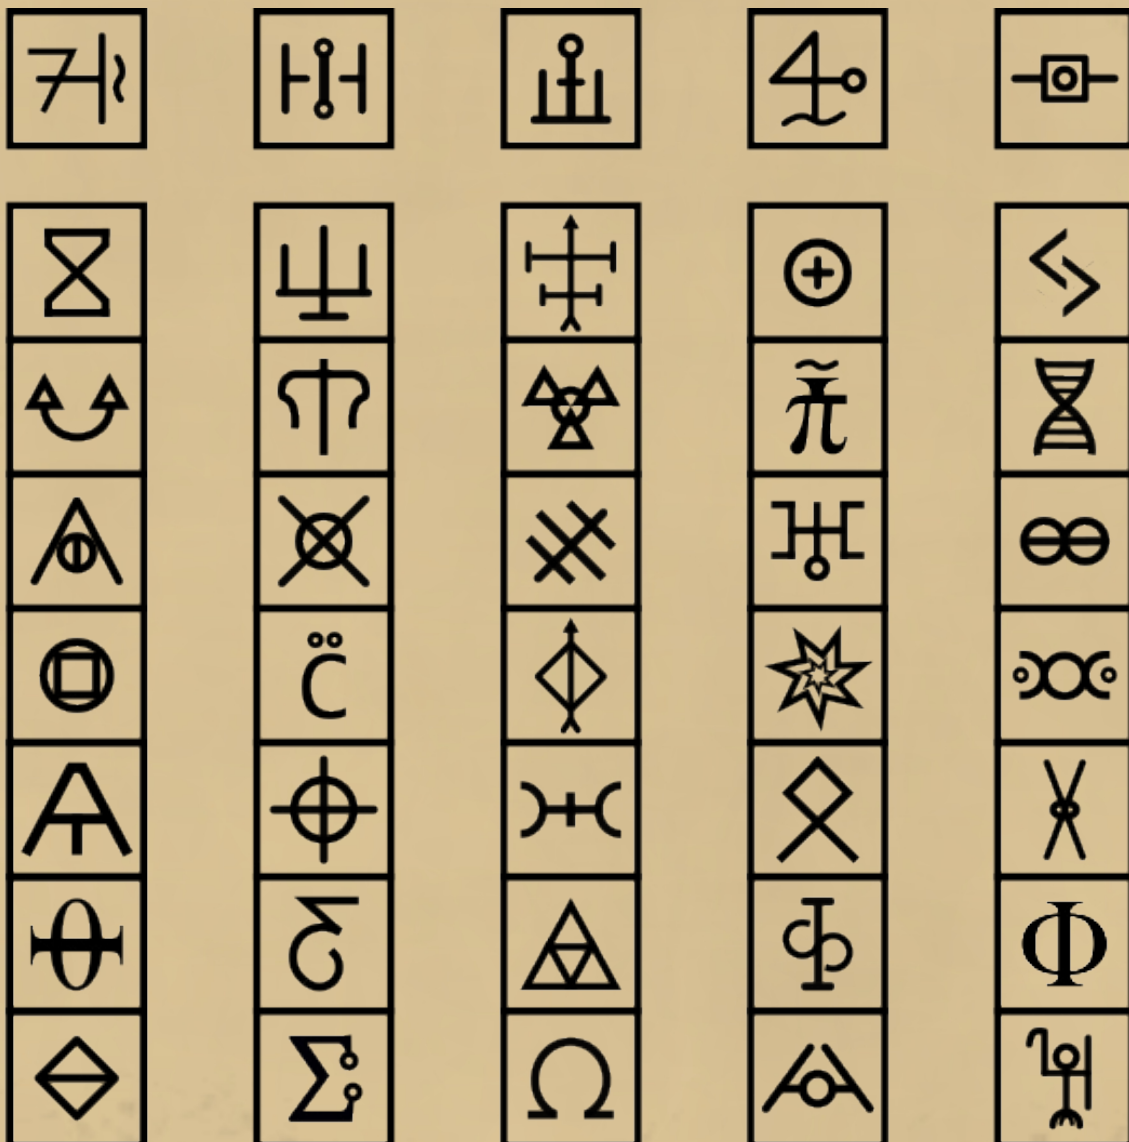

Stap 2


- **Identificeer de anomalie op basis van de groep die alle drie de ingedrukte symbolen bevat, voer deze in op het display van de module in en bevestig.**

Anomalietypen

Leach




Mycrotide

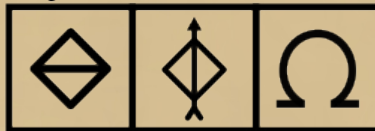

Crack



Loop

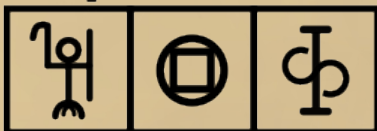

Phase




Skin



Breach



Worm

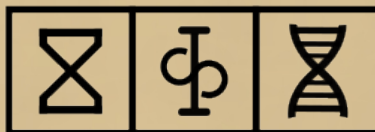

Stink



Glitch



Time




Unknown



Instructies voor krachtvelden

- Volg de onderstaande instructies op basis van de kleur van de kabel.
- Als er geen kabel is om door te knippen, knip dan de onderste kabel door.

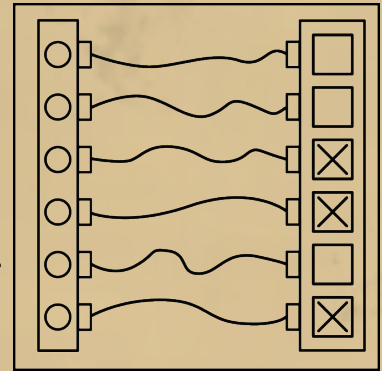


Rode kabel



Blauwe kabel




Gele kabel

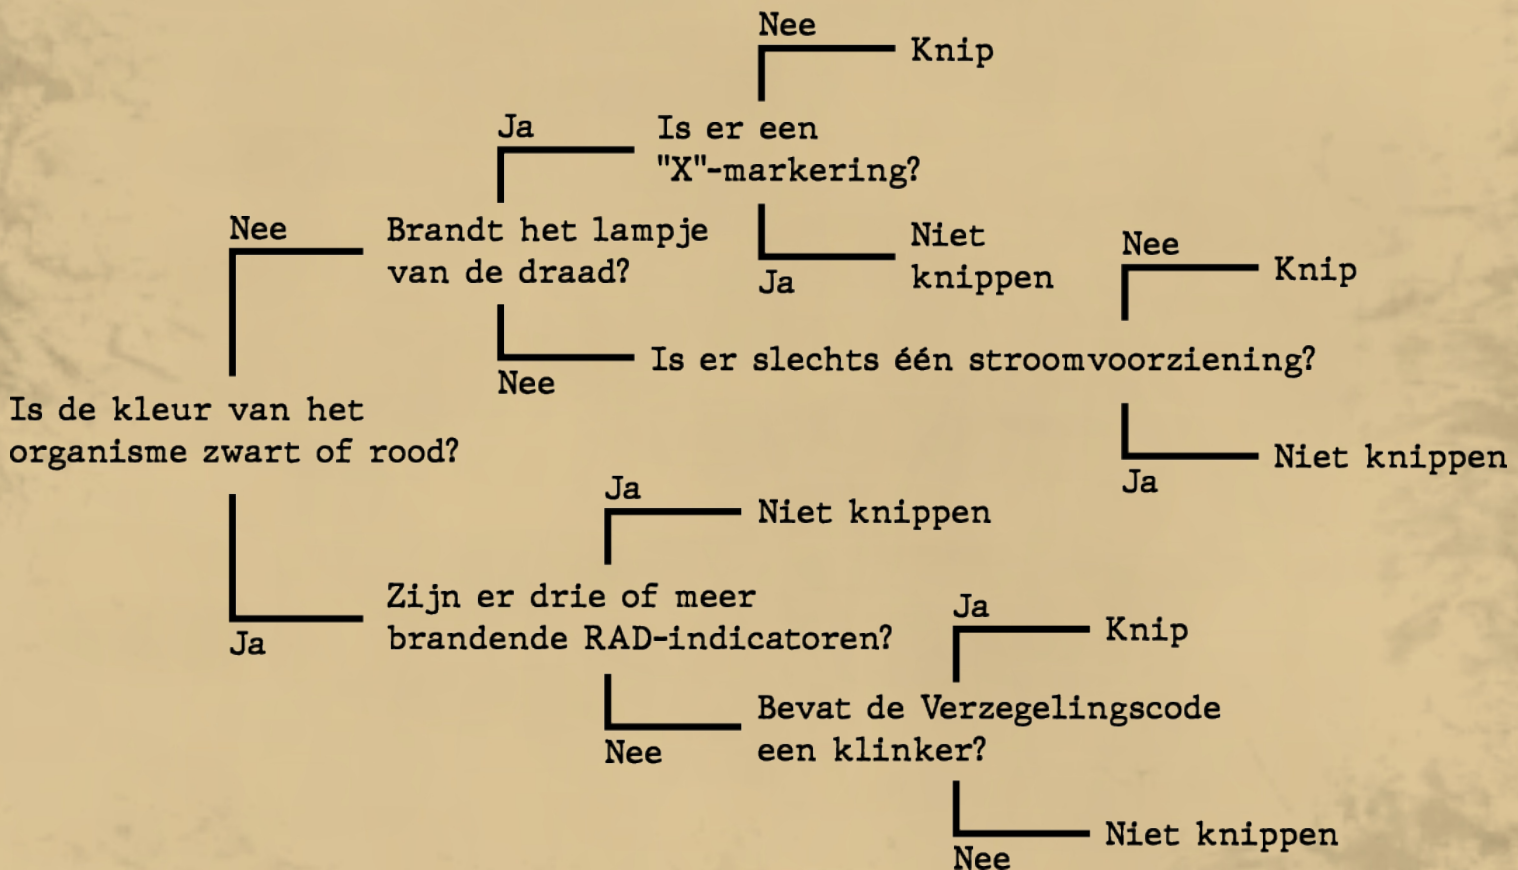

Instructies over de voorwaarden

- Gebruik de informatie van de druk- en temperatuurindicatoren op de module om de schuifregelaars naar de juiste posities te verplaatsen.
- Als een schuifregelaar helemaal boven of onder komt, ga dan verder met tellen vanaf de tegenovergestelde kant.
- Beweeg elke schuifregelaar voorzichtig, aangezien de druk en temperatuur veranderen en deze niet in een verkeerde positie mag worden losgelaten.

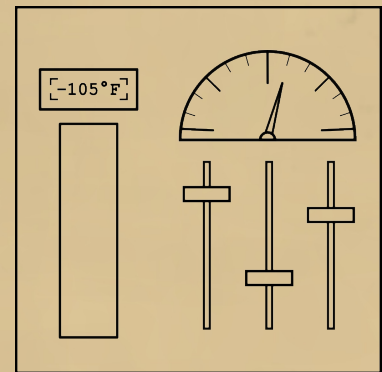

	Als de temperatuur tussen 150°F en 75°F ligt	Als de temperatuur tussen 75°F en 0°F ligt	Als de temperatuur tussen 0°F en -75°F ligt	Als de temperatuur tussen -75°F en -150°F ligt
Als de druk tussen 0 en 45 PSI ligt	Stel de 2e schuifregelaar in met +4 posities.	Stel de 1e schuifregelaar in met -3 posities.	Stel de 3e schuifregelaar in met +7 posities.	Stel de 2e schuifregelaar in met -9 posities.
Als de druk tussen 45 en 90 PSI ligt	Stel de 1e schuifregelaar in met +1 positie.	Stel de 3e schuifregelaar in met -5 posities.	Stel de 2e schuifregelaar in met +8 posities.	Stel de 1e schuifregelaar in met +6 posities.
Als de druk tussen 90 en 135 PSI ligt	Stel de 3e schuifregelaar in met -2 posities.	Stel de 2e schuifregelaar in met -1 positie.	Stel de 1e schuifregelaar in met -7 posities.	Stel de 3e schuifregelaar in met +9 posities.
Als de druk tussen 135 en 180 PSI ligt	Stel de 2e schuifregelaar in met +2 posities.	Stel de 1e schuifregelaar in met -9 posities.	Stel de 3e schuifregelaar in met +3 posities.	Stel de 2e schuifregelaar in met -6 posities.


Instructies over de DNA-sequentie

1. Selecteer de juiste tabel op basis van de kleur van het DNA.

2. Druk op de knop die overeenkomt met de base die op het scherm knippert.

3. Bij elke juiste druk verschijnt er een nieuwe base die achter de eerder ingevoerde base wordt toegevoegd en zo een sequentie vormt.

4. Elke keer dat er een nieuwe base wordt toegevoegd, moet de sequentie opnieuw vanaf het begin worden ingevoerd totdat de module is voltooid.

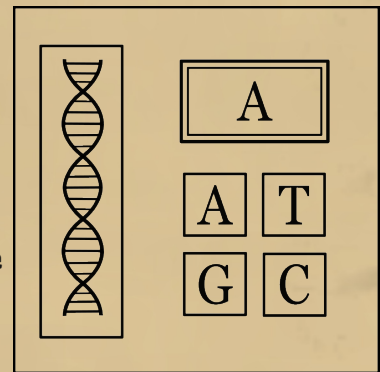

Rood DNA:

Als de verzegelingscode een klinker bevat:

Als de verzegelingscode geen klinker bevat:

Base A	Base G	Base T	Base C
G	A	C	T
C	G	A	T

Geel DNA:

Als de verzegelingscode een even getal bevat:

Als de verzegelingscode geen even getal bevat:

Base A	Base G	Base T	Base C
A	C	G	T
T	A	C	G

Blauw DNA:

Als de som van de cijfers in de verzegelingscode even is:

Als de som van de cijfers in de verzegelingscode oneven is:

Base A	Base G	Base T	Base C
A	G	T	C
G	A	T	C

Paars DNA:



Als de laatste letter van de verzegelingscode een klinker is:

Als de laatste letter van de verzegelingscode een medeklinker is:

Base A	Base G	Base T	Base C
T	C	G	A
C	T	A	G



Instructies voor het toetsenbord

- Koppel de verlichte knoppen aan de zwarte vakken om het juiste toetsenbord te vinden.
- Druk op de knoppen met een "X".
- Herhaal totdat de module is voltooid.

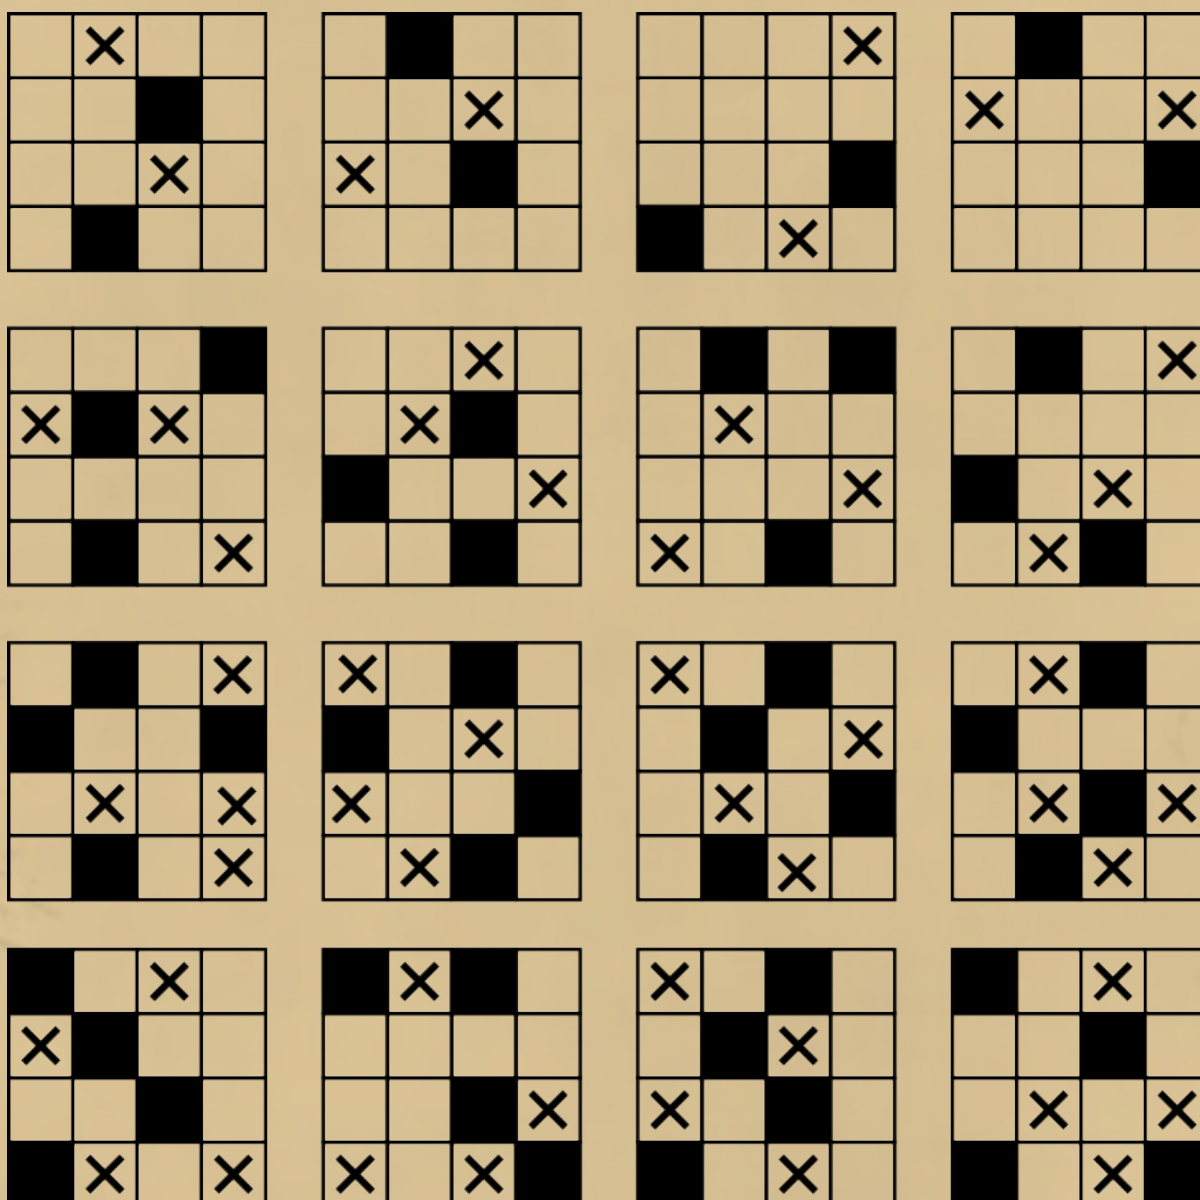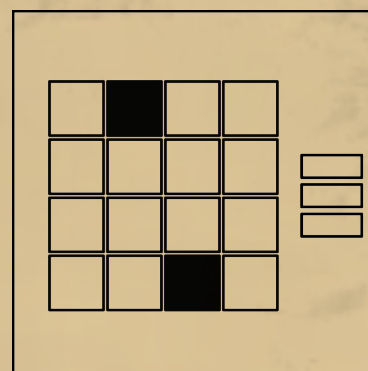


Instructies voor het kompas


- De positie van de lampjes rond het kompas geeft aan welke van de 4 schakelaars moet worden gedraaid.
- De posities van de lampjes worden bepaald door de richting waarin het kompas wijst.
- Wanneer alle schakelaars zijn gedraaid, is de module voltooid.
- Codering volgorde van de schakelaars

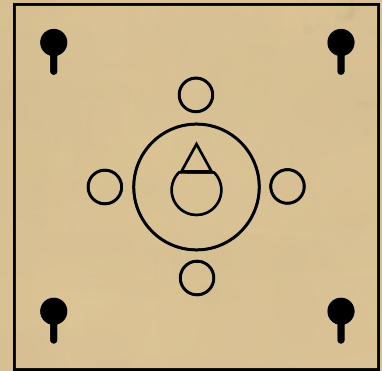


• Draai D

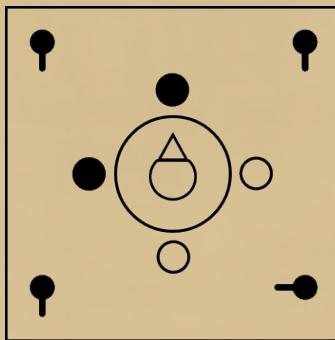


• Draai A

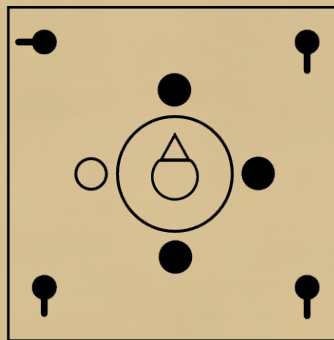


• Draai C

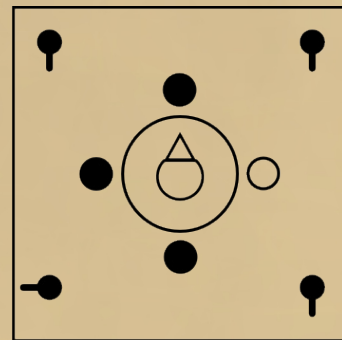


• Draai B

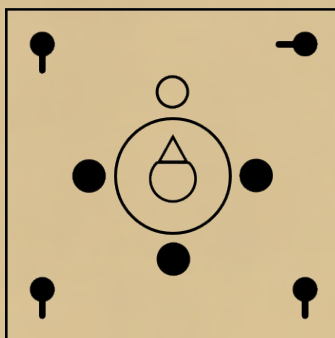


• Draai A

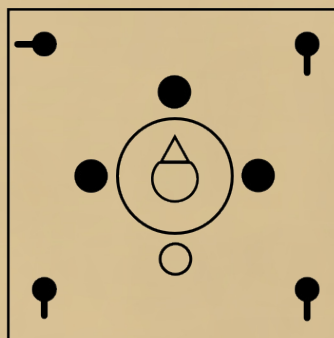


• Draai C

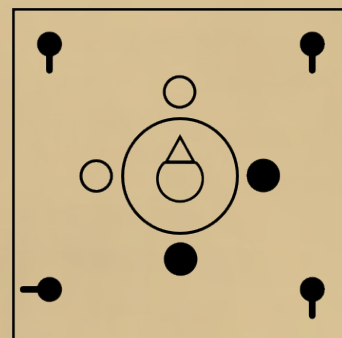

• Draai B

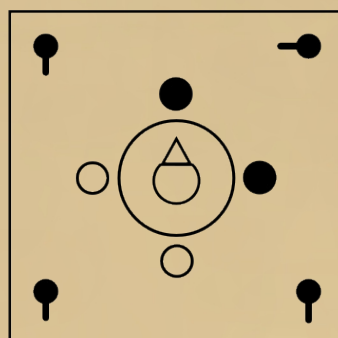


• Draai D

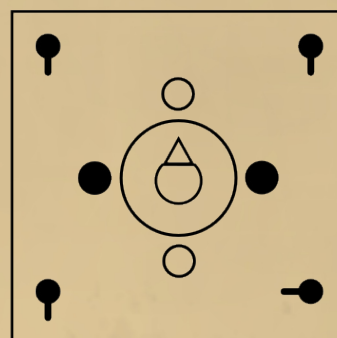

Instructies over golven

- De volgorde waarin de lampjes op de drie panelen op de module aangaan, bepaalt de volgorde waarin de panelen moeten worden opgelost.
- Selecteer voor het paneel dat moet worden opgelost de juiste sectie uit de onderstaande tabel op basis van het aantal chips onderaan het paneel en volg de instructies.

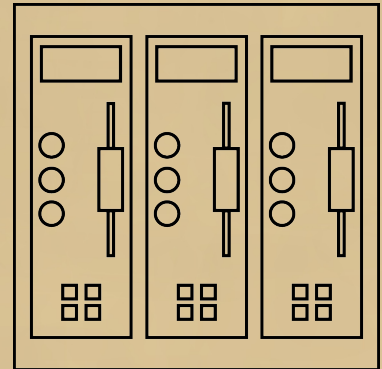

1 chip:

- Als de golflengte kort is, druk 1 keer op de onderste knop.
- Anders, als er minstens 2 energiebronnen zijn, druk 3 keer op de knop.
- Anders druk 2 keer op de bovenste knop.

2 chips:

- Als de amplitude hoog is, druk 1 keer op de middelste knop.
- Anders, als de code een even getal bevat, druk 1 keer op de bovenste knop.
- Anders, als de golflengte lang is, druk eerst op de bovenste knop en daarna meteen op de middelste knop.
- Anders druk 3 keer op de onderste knop.

3 chips:

- Als de prioriteit 1e is, druk 2 keer op de bovenste knop.
- Anders, als de golflengte kort is en de amplitude hoog, druk eerst op de bovenste knop en daarna meteen op de onderste knop.
- Anders, als de golflengte lang is of de amplitude laag, druk 2 keer op de bovenste knop en daarna 1 keer op de middelste knop.
- Anders druk alle knoppen van onder naar boven.

4 chips:

- Als de amplitude laag is, druk 1 keer op de middelste knop.
- Anders, als er geen golven zijn, druk 1 keer op de middelste knop en daarna 2 keer op de onderste knop.
- Anders, als de prioriteit 2e is, druk alle knoppen van boven naar beneden.
- Anders druk 3 keer op de onderste knop.


VERVORMINGEN

Wanneer bepaalde levensvormen in het laboratorium hun stabiliteit verliezen, veroorzaken ze vervormingen in de omringende omgeving.

De tegenmaatregelen voor de problemen die deze vervormingen in het laboratorium kunnen veroorzaken, staan hieronder vermeld.


Vervormingen

- Houd de knop ingedrukt totdat het drukniveau weer normaal is.

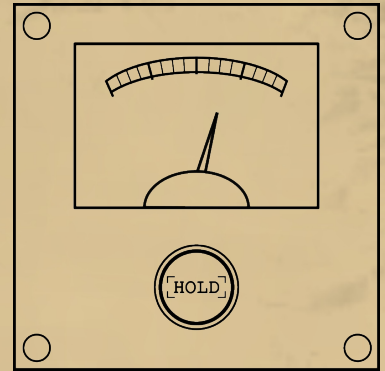


Vervormingen

- Druk alleen op de knipperende knop om de levensvorm te stabiliseren.

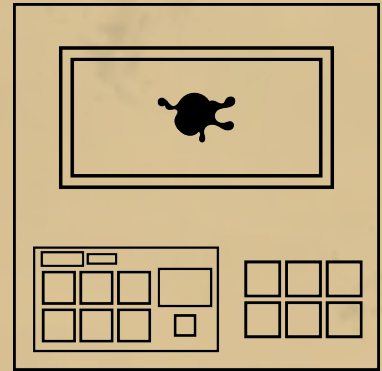


Vervormingen

- Schakel alleen de schakelaars op het paneel in waarvan de lampjes knipperen.

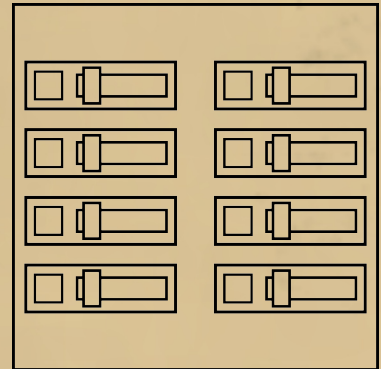


Vervormingen

- Plaats de uitgeworpen buizen terug in hun sleuven en laat vervolgens de hendel aan de zijkant zakken om ze vast te zetten.

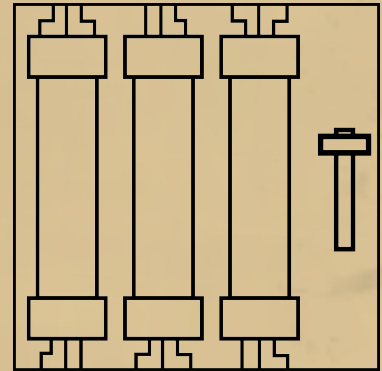

Vervormingen

- Schakel de schakelaars in en uit volgens de nummers erop om het niveau van de rechter meter gelijk te maken aan dat van de linker.

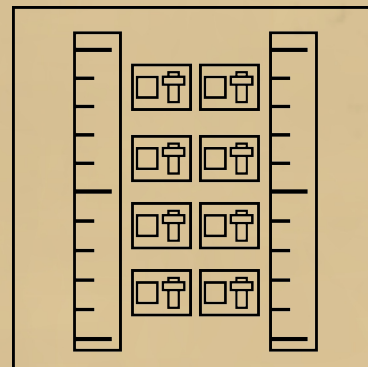

Informatie over indicatoren


RAD- en BIO-indicatoren bevinden zich op het bedieningspaneel en geven informatie over het subject en de omgeving waarin het wordt gehouden.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informatie over stroomvoorzieningen

Stroomvoorzieningen leveren energie aan het bedieningspaneel en hun aantal kan variëren afhankelijk van de insluitingsomstandigheden van het subject. Ze bevinden zich onderaan het bedieningspaneel.

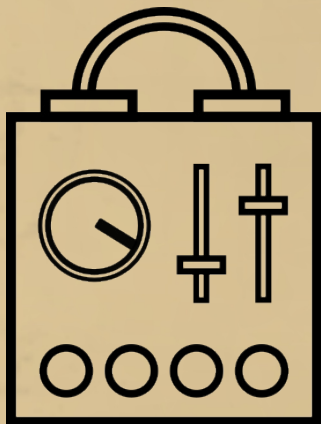

Informatie over de Verzegelingscode

De Verzegelingscode is een subjectspecifieke identificatie die aan elk subject wordt toegewezen en dient als unieke referentie die informatie over het subject verschaft. Deze bevindt zich bovenaan het observatievenster.

BZ3-D6X

Lijst van klinkers:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informatie over het zelfvernietigingsmechanisme

De zelfvernietigingsknop wordt gebruikt om zowel het subject als de observatiekamer te vernietigen om te voorkomen dat het subject ontsnapt. Deze mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt.

