

KEEP IT CONTAINED

PROTOKOLLHÅNDBOK

Denne protokollhåndboken følger med spillet Keep It Contained
og er nødvendig for korrekt drift.

KRITISKE BIOSIKKERHETSPROTOKOLLER

Denne veiledningen vil være din eneste støtte for å holde ukjente livsformer under kontroll når de forsøker å krysse karantenelinjen.

Du er operatøren; gjeldende protokoller for enhver situasjon du kan møte, finnes her.

GENERELL INFORMASJON OM MODULER

Modulene er plassert øverst på kontrollpanelet. Hovedmålene du må løse for å holde organismene innesperret, er modulene.

Modulene du møter kan variere på hvert nivå og er vanligvis tilfeldige.

Detaljert informasjon om modulene finnes på sidene 4-9.

GENERELL INFORMASJON OM MILJØET


Detaljene du ser i miljøet kan påvirke løsningen av modulene eller gjøre dem vanskeligere å løse.

Detaljert informasjon om miljøet finnes på sidene 10-13.


Det anbefales å lese dette på forhånd for å være forberedt.

Instruksjoner for tilkobling av ledninger

- Modulen inneholder fire ledninger og fire inngangsspor.
- Hvert inngangsspor er merket med et symbol.
- Symbolene er ordnet fra venstre mot høyre og må beskrives i denne rekkefølgen.
- Kolonnene nedenfor angir prioriteringsrekkefølgen for symbolene.
- Hvis det beskrevne symbolet er øverst i en kolonne, må det kobles til ledningen med fargen som er angitt i den kolonnen. Hvis en ledning allerede er koblet til et symbol, skal den kolonnen ignoreres.

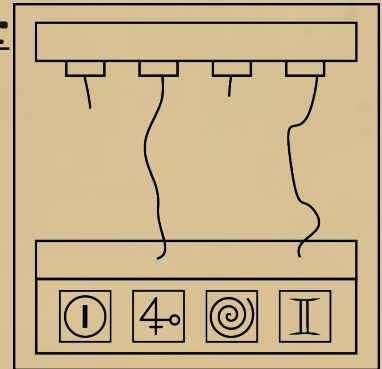


Grønn:

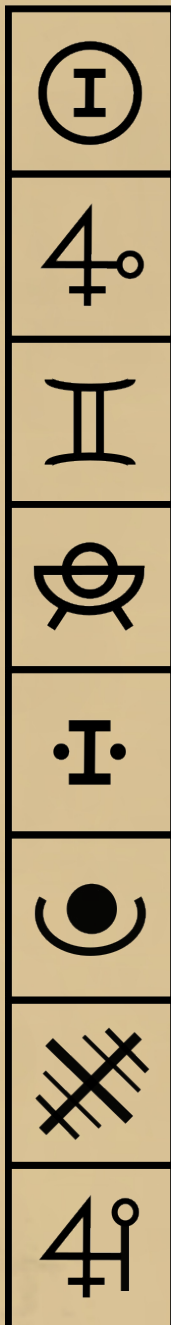


Gul:



Blå:

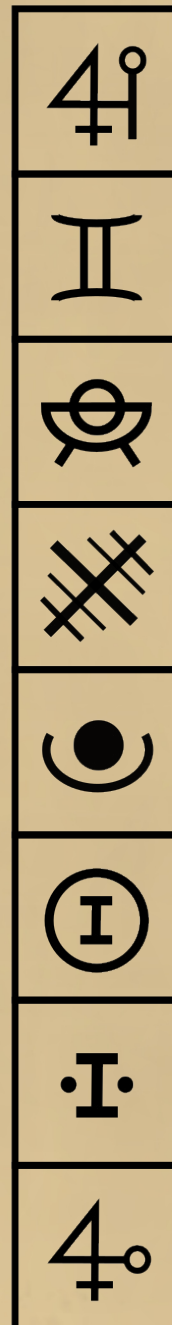


Rød:

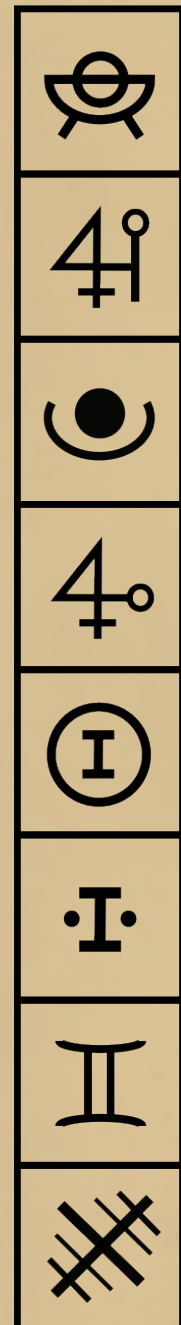

Instruksjoner for gassutslipp


- Modulen inneholder tre fargede gassbeholdere, hver styrt av en bryter.
- Skjermen øverst til venstre viser blodets farge. Skjermen øverst til høyre viser renhetsnivået.

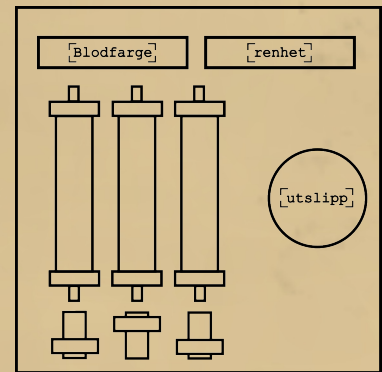

- For å velge hvilke gasser som skal slippes ut, må bryterne under hver gassbeholder senkes.
 - Trykk på den røde knappen for å slippe ut de valgte gassene.
 - Les reglene i rekkefølge og utfør den første gyldige instruksjonen.
1. Hvis blodfargen er grønn og renhetsnivået er middels, slipp ut venstre og midterste gass.
 2. Hvis kontrollpanelet drives av mer enn to strømforsyninger og renhetsnivået er rent, slipp ut alle gasser.
 3. Hvis blodfargen er rød og minst tre RAD-indikatorer lyser, slipp ikke ut noen gasser.
 4. Hvis det bare er én strømforsyning på panelet og ingen BIO-indikatorer lyser, slipp kun ut den midterste gassen.
 5. Hvis blodfargen er gul eller renhetsnivået er lavt, slipp ut venstre og høyre gass.
 6. Hvis renhetsnivået er null og bare to RAD-indikatorer lyser, slipp kun ut venstre gass.
 7. Hvis blodfargen er blå og renhetsnivået er høyt, slipp ut midterste og høyre gass.
 8. Hvis ingen av betingelsene ovenfor gjelder, slipp kun ut høyre gass.


Instruksjoner om anomalier

1. Se på symbolet som vises på skjermen og følg instruksjonene fra Trinn 1.
2. Bruk informasjonen du har samlet, og følg instruksjonene fra Trinn 2 for å avgjøre hvilken anomali det er.

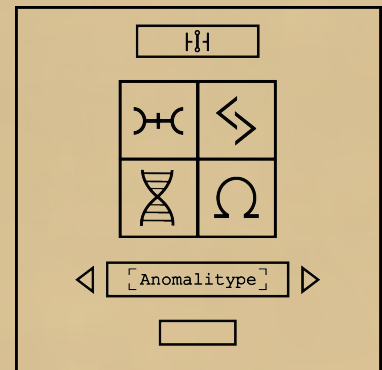

Trinn 1:

- Symbolet på skjermen representerer kolonnen det befinner seg i.
- Av de fire symbolene som vises til teknikeren, trykk på knappen med symbolet som ikke tilhører den kolonnen.
- Gjenta denne prosessen så mange ganger som nødvendig, og gå deretter videre til Trinn 2.

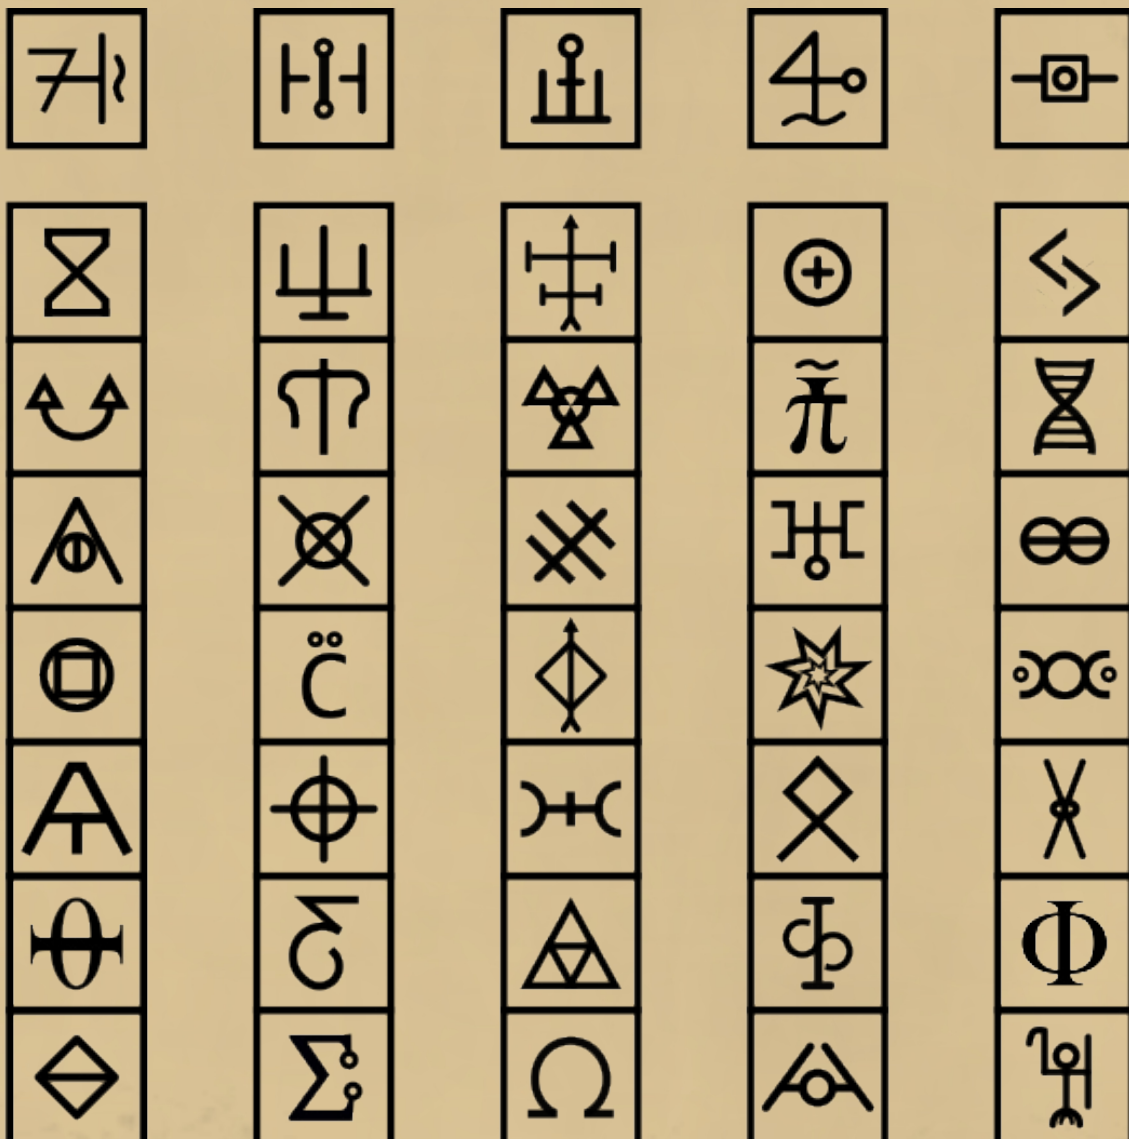

Trinn 2:

- Identifiser anomalien basert på gruppen som inneholder alle de tre trykkede symbolene, skriv den inn på modulens display og bekreft.

Anomalietyper


Leach



Mycrotide



Crack

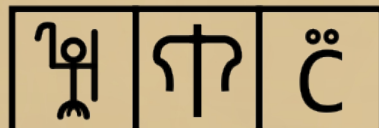

Loop



Phase



Skin



Breach



Worm



Stink




Glitch



Time




Unknown

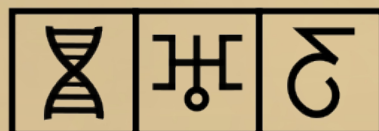


Instruksjoner om kraftfelt


- Følg instruksjonene nedenfor basert på kabelens farge.
- Hvis det ikke finnes noen kabel å kutte, kutt den nederste kabelen.

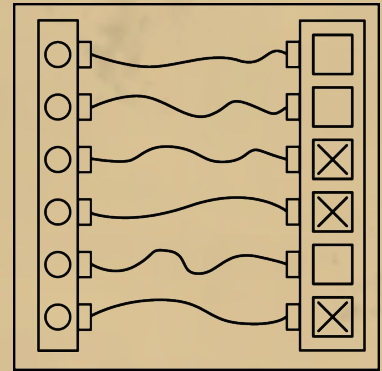


Rød kabel:

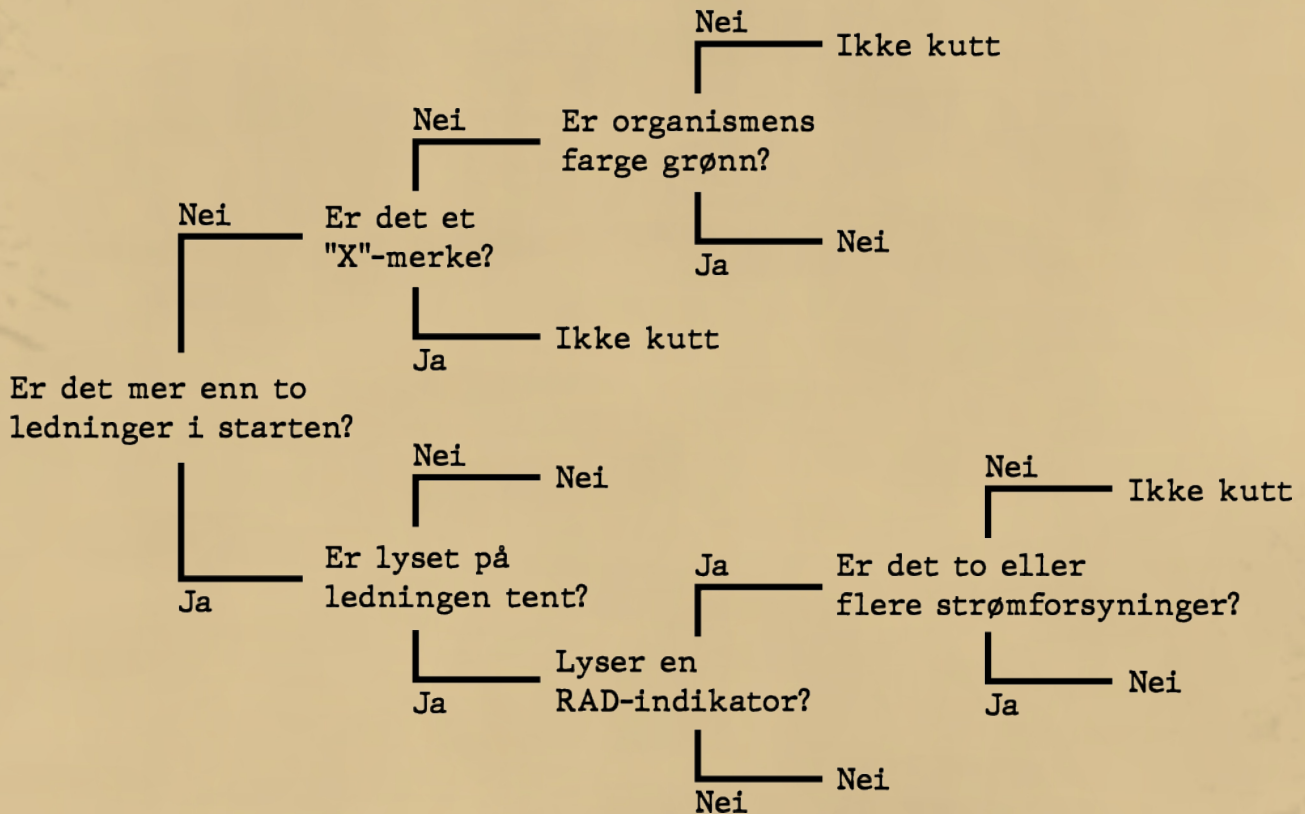

Blå kabel:

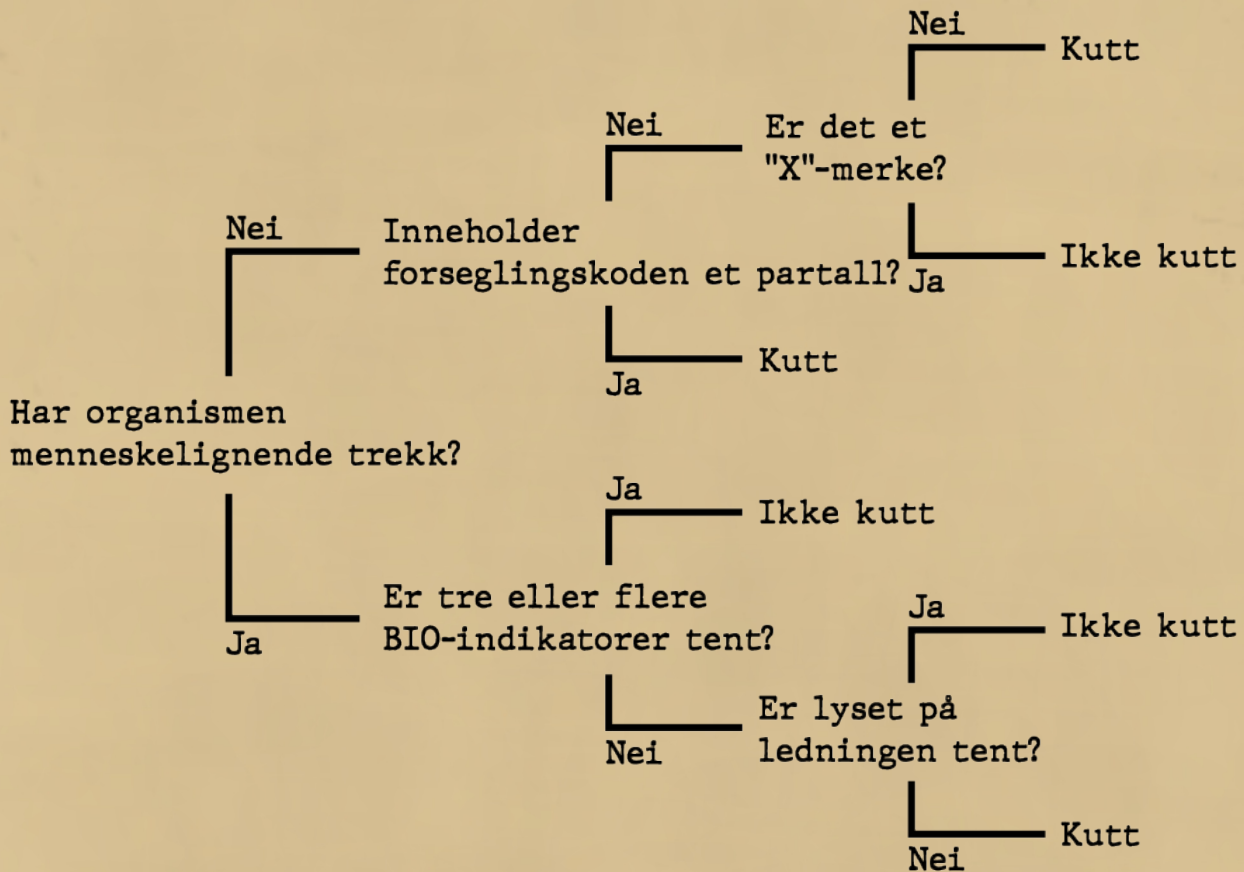


Gul kabel:

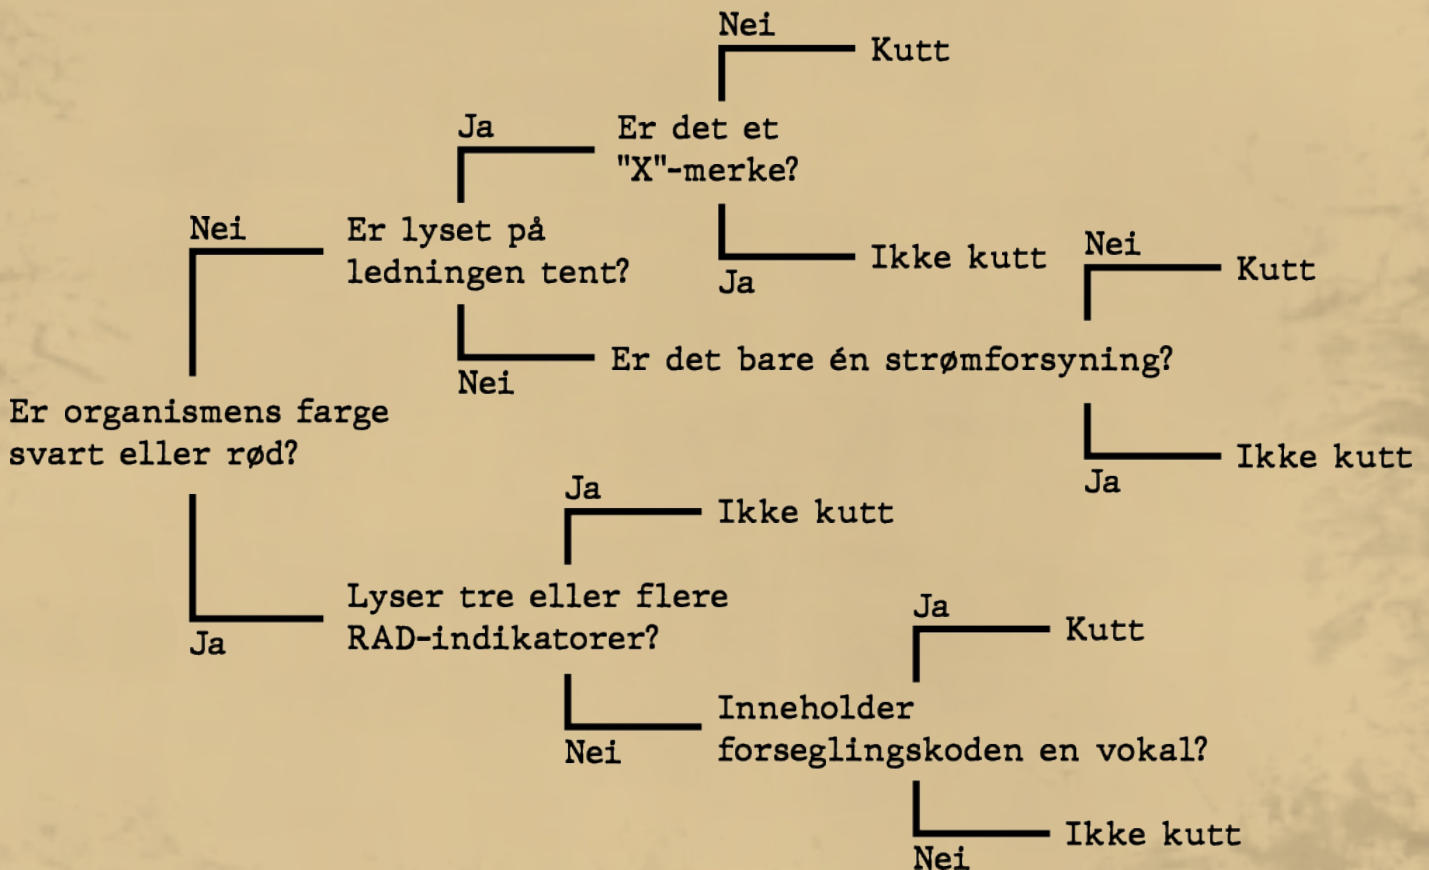

Instruksjoner om forholdene

- Bruk informasjonen fra trykk- og temperaturindikatorerne på modulen for å flytte skyvebryterne til riktige posisjoner.
- Hvis en skyvebryter når helt opp eller helt ned, fortsett å telle fra motsatt ende.

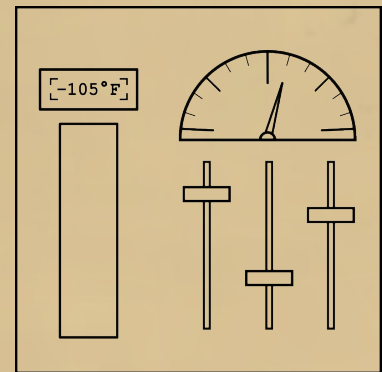


- Flytt hver skyvebryter forsiktig, siden trykket og temperaturen vil endre seg, og den må ikke slippes i feil posisjon.

	Hvis temperaturen er mellom 150°F og 75°F	Hvis temperaturen er mellom 75°F og 0°F	Hvis temperaturen er mellom 0°F og -75°F	Hvis temperaturen er mellom -75°F og -150°F
Hvis trykket er mellom 0 og 45 PSI	Juster den 2. glidebryteren med +4 posisjoner.	Juster den 1. glidebryteren med -3 posisjoner.	Juster den 3. glidebryteren med +7 posisjoner.	Juster den 2. glidebryteren med -9 posisjoner.
Hvis trykket er mellom 45 og 90 PSI	Juster den 1. glidebryteren med +1 posisjon.	Juster den 3. glidebryteren med -5 posisjoner.	Juster den 2. glidebryteren med +8 posisjoner.	Juster den 1. glidebryteren med +6 posisjoner.
Hvis trykket er mellom 90 og 135 PSI	Juster den 3. glidebryteren med -2 posisjoner.	Juster den 2. glidebryteren med -1 posisjon.	Juster den 1. glidebryteren med -7 posisjoner.	Juster den 3. glidebryteren med +9 posisjoner.
Hvis trykket er mellom 135 og 180 PSI	Juster den 2. glidebryteren med +2 posisjoner.	Juster den 1. glidebryteren med -9 posisjoner.	Juster den 3. glidebryteren med +3 posisjoner.	Juster den 2. glidebryteren med -6 posisjoner.

Instruksjoner om DNA-sekvensen

1. Velg riktig tabell basert på DNA-fargen.
2. Trykk på knappen som tilsvarer basen som blinker på skjermen.
3. For hvert riktige trykk vil en ny base vises og legges til etter den tidligere angitte basen, og danner en sekvens.
4. Hver gang en ny base legges til, må sekvensen legges inn på nytt fra begynnelsen til modulen er fullført.

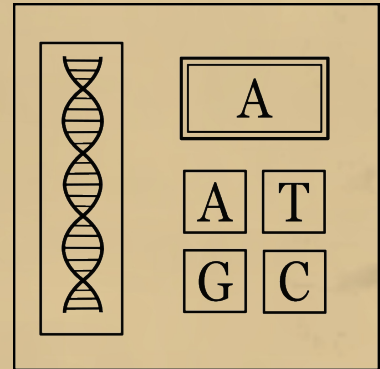

Rødt DNA:

Hvis forseglingsskoden inneholder en vokal:

Hvis forseglingsskoden ikke inneholder en vokal:

Base A	Base G	Base T	Base C
G	A	C	T
C	G	A	T

Gult DNA:

Hvis forseglingsskoden inneholder et partall:

Hvis forseglingsskoden ikke inneholder et partall:

Base A	Base G	Base T	Base C
A	C	G	T
T	A	C	G

Blått DNA:

Hvis summen av tallene i forseglingsskoden er et partall:

Hvis summen av tallene i forseglingsskoden er et oddetall:

Base A	Base G	Base T	Base C
A	G	T	C
G	A	T	C

Lilla DNA:



Hvis den siste bokstaven i forseglingsskoden er en vokal:

Hvis den siste bokstaven i forseglingsskoden er en konsonant:

Base A	Base G	Base T	Base C
T	C	G	A
C	T	A	G



Instruksjoner for tastaturet

- Match de lysende knappene med de svarte boksene for å finne riktig tastatur.
- Trykk på knappene merket med «X».
- Gjenta til modulen er fullført.

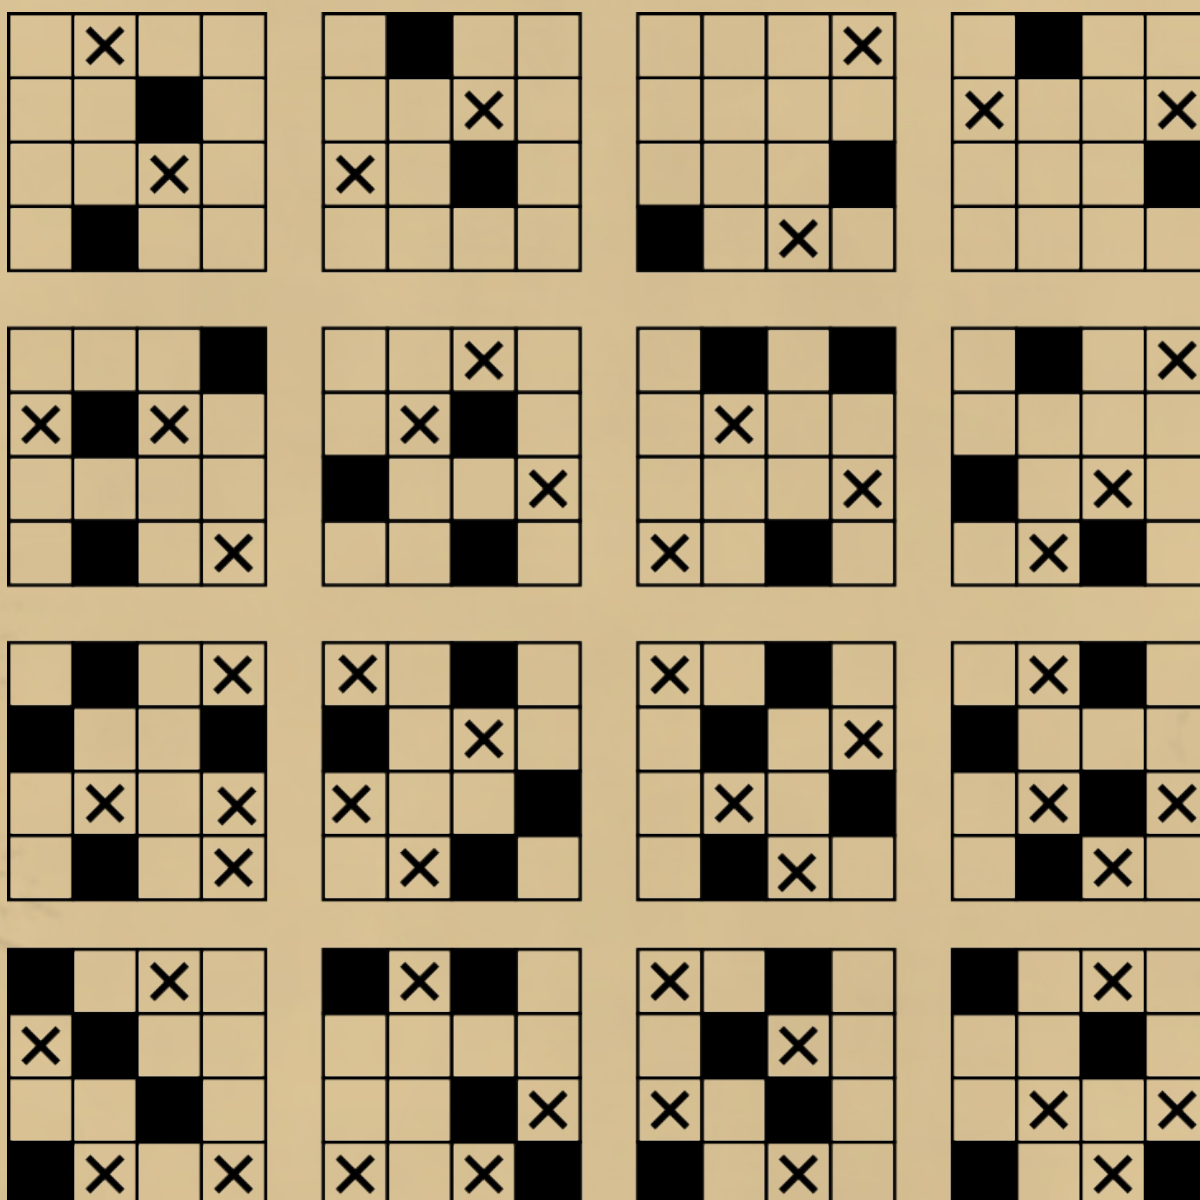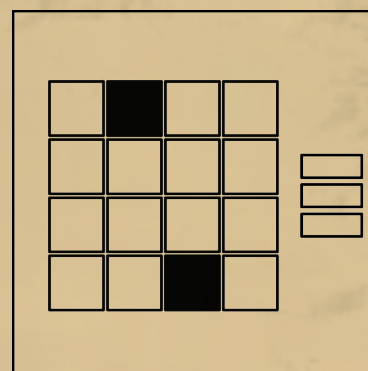


Instruksjoner for kompasset


- Posisjonen til lysene rundt kompasset viser hvilken av de 4 bryterne som skal dreies.
- Posisjonene til lysene bestemmes av retningen kompasset peker.
- Når alle bryterne er dreid, er modulen fullført.
- Kodingsrekkefølge for bryterne:

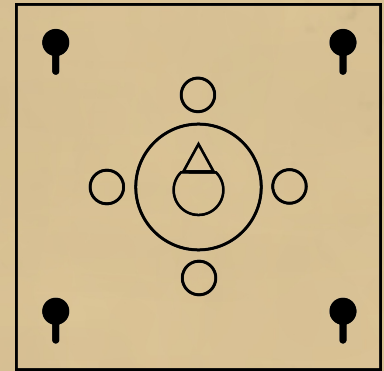


• Drei D

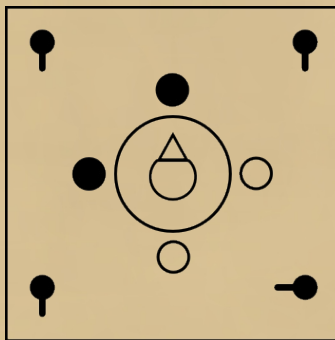


• Drei A

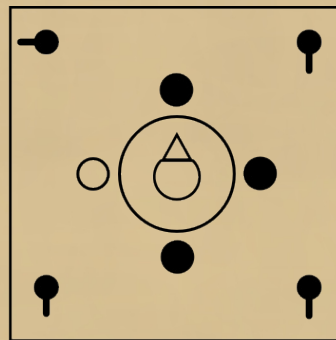


• Drei C

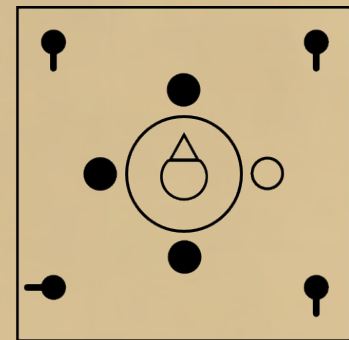


• Drei B

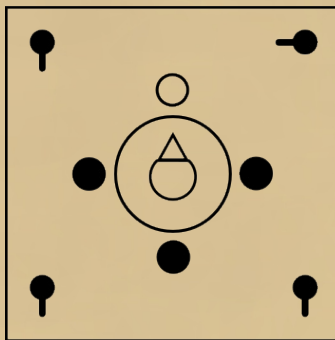


• Drei A

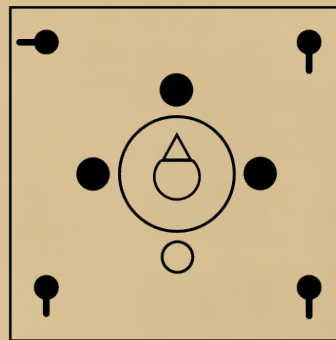


• Drei C

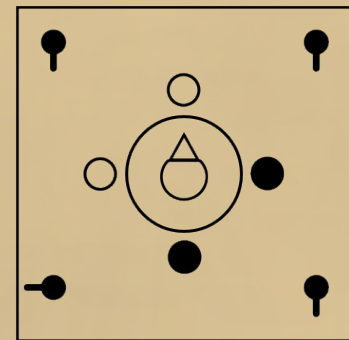

• Drei B

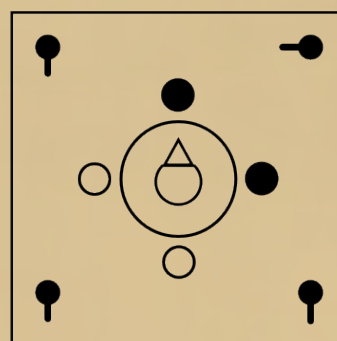


• Drei D

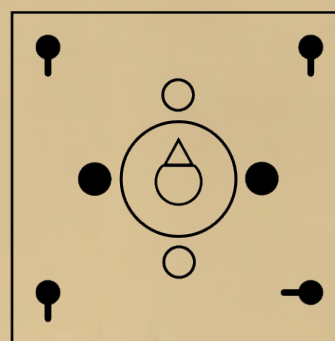

Instruksjoner om bølger

- Rekkefølgen som lysene på de tre panelene på modulen tennes i, bestemmer rekkefølgen panelene skal løses i.
- For panelet som skal løses, velg riktig seksjon fra tabellen nedenfor basert på antall brikker nederst på panelet og følg instruksjonene.

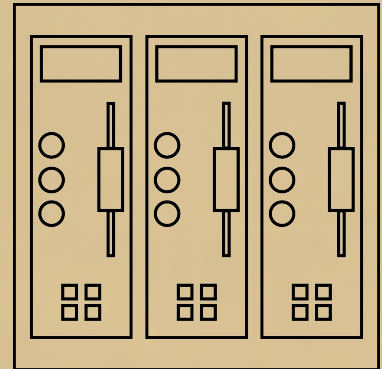

1 chip:

- Hvis bølgelengden er kort, trykk på den nederste knappen 1 gang.
- Ellers, hvis det er minst 2 strømkilder, trykk på midtknappen 3 ganger.
- Ellers, trykk på den øverste knappen 2 ganger.

2 chip:

- Hvis amplituden er høy, trykk på midtknappen 1 gang.
- Ellers, hvis koden inneholder et partall, trykk på den øverste knappen 1 gang.
- Ellers, hvis bølgelengden er lang, trykk først på den øverste knappen og deretter umiddelbart på midtknappen.
- Ellers, trykk på den nederste knappen 3 ganger.

3 chip:

- Hvis prioriteten er 1., trykk på den øverste knappen 2 ganger.
- Ellers, hvis bølgelengden er kort og amplituden er høy, trykk på den øverste knappen og deretter umiddelbart på den nederste.
- Ellers, hvis bølgelengden er lang eller amplituden er lav, trykk på den øverste knappen 2 ganger og deretter midtknappen 1 gang.
- Ellers, trykk på alle knappene fra nederst til øverst.

4 chip:

- Hvis amplituden er lav, trykk på midtknappen 1 gang.
- Ellers, hvis det ikke er noen bølger, trykk på midtknappen 1 gang og deretter den nederste knappen 2 ganger.
- Ellers, hvis prioriteten er 2., trykk på alle knappene fra øverst til nederst.
- Ellers, trykk på den nederste knappen 3 ganger.


FORVRIDNINGER

Når enkelte livsformer i laboratoriet mister stabilitet, utløser de forvridninger i det omkringliggende miljøet.

Mottiltakene for problemene som disse forvridningene kan skape i laboratoriet er listet nedenfor.


Forvridninger

- Hold knappen inne til trykknivået går tilbake til normalt.

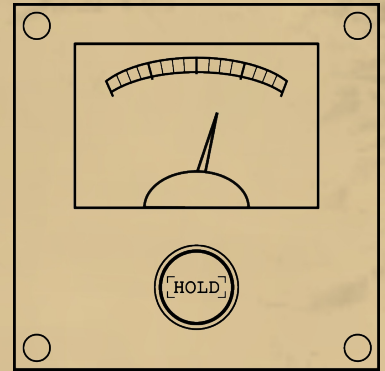


Forvridninger

- Trykk kun på den blinkende knappen for å stabilisere livsformen.

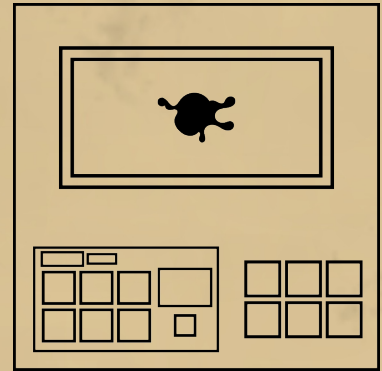


Forvridninger

- Slå kun på bryterne på panelet som har blinkende lys.

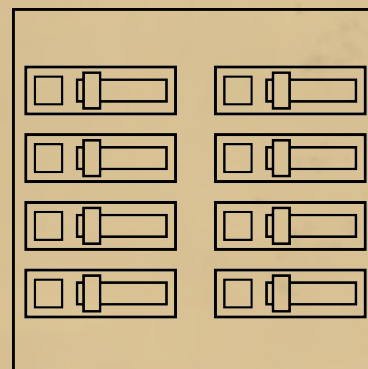


Forvridninger

- Sett de utløste rørene tilbake på plass, og senk deretter spaken på siden for å feste dem.

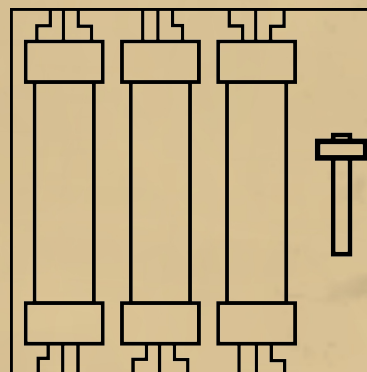

Forvridninger

- Slå bryterne av og på i henhold til tallene på dem for å justere nivået på den høyre måleren med den venstre.

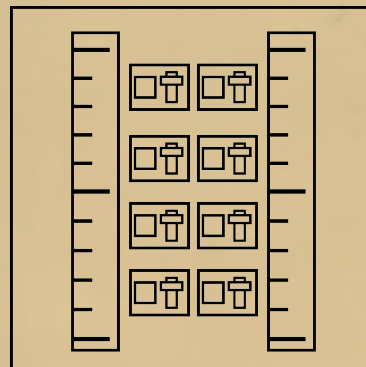

Informasjon om indikatorer


RAD- og BIO-indikatorer er plassert på kontrollpanelet og gir informasjon om subjektet og miljøet det holdes i.

RAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BIO	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Informasjon om strømforsyninger

Strømforsyninger leverer strøm til kontrollpanelet, og antallet kan variere avhængig av innesperringsforholdene. De er plassert nederst på kontrollpanelet.

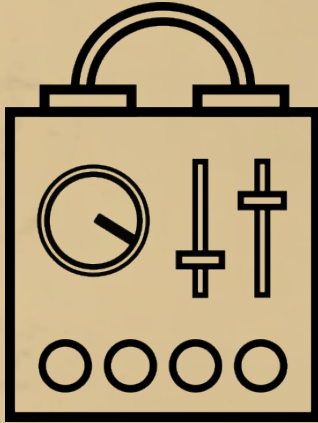

Informasjon om forseglingskoden

Forseglingskoden er en subjektspesifikk identifikator som tildeles hvert subjekt, og fungerer som en unik referanse som gir informasjon om dem. Den er plassert øverst i observasjonsvinduet.

BZ3-D6X

Liste over vokaler:

A	E	I	O	U
---	---	---	---	---

Informasjon om selvdestruksjonsmekanismen

Selvdestruksjonsknappen brukes til å ødelegge både subjektet og observasjonskammeret for å forhindre at subjektet rømmer. Den skal kun brukes som en siste utvei.

